


УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
 Руководитель (заместитель руководителя)
 Федеральной службы по аккредитации
 Д.А. МАКАРЕНКО

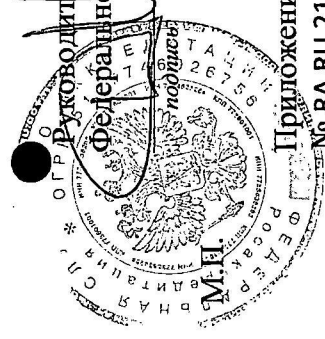

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение к аттестату аккредитации
 № RA.RU.21IM38 от «12» апреля 2016 г.
 на 5 листах, лист 1

РАСШИРЯЕМАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательного лабораторного центра
 федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии
 и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, 16, строение 1.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	MP 1.1.0120	Изделия парфюмерно- косметические, в том числе средства гигиены полости рта	20.41.31.112 20.41.31.113 20.41.31.119 20.41.31.130	3301 3303 3304	Общетокическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro	от -5 до 100000 импульс в сек.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. ГОСТ ISO 28888	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.11 20.42.11.110 20.42.11.120 20.42.11.130 20.42.12.110 20.42.12.120 20.42.13.000 20.42.14.110 20.42.14.120 20.42.14.140 20.42.15.131 20.42.15.132 20.42.15.133 20.42.15.141 20.42.15.142 20.42.15.143 20.42.15.149 20.42.15.150 20.42.16.110 20.42.17.120 20.42.18.110 20.42.18.111 20.42.18.112 20.42.18.190 20.42.19.110 20.42.19.120 20.53.10 20.53.10.110 20.53.10.120	3305 3306 3307 3401	Деминерализующее действие	от 0 до 13,0 положительный/ отрицательный
-------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.5	Стоматология. Материалы полимерные восстановительные	32.50.50.000	3006	Толщина пленки материалов для фиксации	25 – 50 мкм
4	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.6.				Рабочее время	60 – 90 с
5.	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.7.				Рабочее время	60 – 90 с
6	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.8				Время отверждения /твердения материалов	3 – 10 мин
7	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.9				Чувствительность к окружающему освещению материалов	-
8	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.10				Глубина отверждения материалов	1 – 6 мм
9	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.11				Прочность при изгибе	20 – 200 МПа
10	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.12				Водопоглощение	1– 60 мкг/мм ³
					Растворимость	1-60 мкг/мм ³
11	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049: 2009) п.7.13				Цветостойкость	1-10 ΔЕ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

12	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049:2009) п.7.15				Адгезионная прочность при сдвиге	2 – 40 МПа
13	ГОСТ Р 58165 (ISO/TR 28642:2016) п.7.1.1	Стоматология. Материалы и изделия для реставрации зубов и зубных рядов.	32.50.50.000	3006	Совместимость цвета стоматологического материала и тканей человека	1– 10ΔE
15	ГОСТ Р 58165 (ISO/TR 28642:2016) п.7.1.2				Совместимость цвета стоматологических материалов	1– 10ΔE
16	ГОСТ Р 58165 (ISO/TR 28642:2016) п.7.2.2				Цветостойкость после старения и окрашивания	1– 10ΔE
17	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.1.	Материал формовочный огнеупорный и материал для моделей			Консистенция материала и отсутствие загрязнений	-
19	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.2.				Текучесть	0,1 -120 мм
20	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.3.				Время схватывания и затвердевания	1 -60 мин
21	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.4.				Прочность при сжатии,	10 -100 МПа

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

22	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.5. ГОСТ ISO 7490-2011 п.7.4. ГОСТ ISO 9694-2011 п.8.4.				Линейное расширение при твердении	0,01-1,0 мм
23	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.6.				Линейное термическое изменение размеров	0,001-1,0 мм
24	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912-2016) п.7.7.				Соответствие расширения материала	0,001 – 20 мм
25	ГОСТ Р ИСО 14356 п.8.2	Материалы дубликационные	32.50.50.000	3006	Воспроизведение деталей	Визуально Прошел/не прошел
26	ГОСТ Р ИСО 14356 п.8.3.				Совместимость с огнеупорным материалом (гипсом) воспроизводить линию на испытательном блоке по всей длине между линиями d1и d2	Визуально Прошел/не прошел
27	ГОСТ Р ИСО 14356 п.8.4.				Упругое восстановление	0,01-6,0 мм
28	ГОСТ Р ИСО 14356 п.8.5.				Сопротивление раздиру	0,1 – 10. Н/мм

Директор
академик РАН

Руководитель
испытательного лабораторного центра

/А.А.Кулаков/

/Т.А.Соловьева/

на 5 листах, лист 5



Beed -

Мошкова М. В.

Heath

Тарасова Е. А.

ШАМАК

Peace