

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись
инициалы, фамилия
ЯНТВАК А.А.

23 07 19

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.517966

от «03» апреля 2017 г.
на 408 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Акционерного общества «Независимый институт испытаний медицинской техники»
наименование испытательной лаборатории (центра)

115419, Россия, город Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 42, этаж 1, пом. II, ком. 16,17

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
I.	ГОСТ Р 50444	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	20.59.11 22.19.71 28.14.12 23.42.10 23.52.20 23.49.12 23.91.11 28.99.39 20.59.52 20.20.14 21.20.24	3701 10 3702 10 4015 11 4014 10 8477 80 6909 90 6910 10 6910 90 3407 00 6909 11 6909 19	Идентификация: классификация Основные параметры: - электропитание	- От сети переменного тока частотой 50 или 400 Гц, напряжением 36; (220/127); 220; 380/220; 380 В Работоспособны/не работоспособны

1	2	3	4	5	6	7
			13.99.19	6909 90	- работоспособность при отклонении частоты	Работоспособны/не работоспособны
			21.20.24	8415 20	Технические требования:	
			21.20.24	8415 10	- максимально-допустимое время установления рабочего режима	1 с – 120 мин 4 – 24 ч
			32.50.11	8415 81	- масса переносных изделий, используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его	0 – 25 кг
			32.50.12	8415 90	- масса, приходящаяся на одну ручку для переноса	0 – 12,5 кг
			32.50.13	9027 80	- вибропрочность, виброустойчивость	Диапазон частот: 10 – 55 Гц Амплитуда перемещения: 0,15; 0,35 мм
			32.50.21	8419 89	- ударопрочность, удароустойчивость	Пиковое ударное ускорение: 100 м/с ² , длительность действия ударного ускорения: 16 мс
			32.50.22	9027 30	- номинальное значение температуры	минус 40°C – плюс 50°C
			32.50.23	9027 50	- номинальное значение относительной влажности	80 – 100%
			32.50.30	9027 80	- номинальное значение температуры для изделий, изготовленных в климатическом исполнении У и Т категории 6	32 – 42°C
			32.50.42	8419 40	- климатическая устойчивость при эксплуатации, хранении, транспортировании	Устойчивы/не устойчивы
			32.50.50	3821 00	- стойкость к резкому изменению температуры внешней среды	Устойчивы/не устойчивы
			14.12.30	3822 00	- устойчивость к дезинфекции, очистке, стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
			14.31.10	9032 10	Требования безопасности:	
			13.20.44	7502 20	- наличие блокировки и ограждения	Соответствует/ не соответствует
			17.12.14	9018 49	- уровень звуковой мощности	30 – 130 дБА
			21.20.10	9021 21	- температура наружных частей изделий	0 – 85 °C
			21.20.23	9021 29	Комплектность	-
			21.20.24	3006 10		
			26.20.16	3006 40		
			26.20.17	3006 70		
			26.51.66	2513 20		
			26.60.11	3808 94		
			26.60.12	3808 94		
			26.60.13	3808 99		
			26.60.14	3005 10		
			26.70.22	3005 90		
			26.70.23	3006 91		
			27.51.24	5601 21		
			27.51.23	5601 22		
			28.29.11	5601 29		
			29.10.30	3006 10		
			29.10.2	3306 10		
			29.10.59	3306 20		
			29.20.21	3306 90		
			26.51.70	5006 00		
			30.92.30	3909 39		
			31.01.12	3909 40		
			31.03.11	3909 50		
			31.09.13	3914 00		
			31.09.11	8471 90		
			31.03.12	9013 20		

9027 50
3822 00
2804 40
2811 21
8419 89
8419 90
9027 80
9032 10
9027 90
8421 19
8471 60
9027 80
3822 00
3821 00
9027 30
9027 80
8419 40
9027 80
9032 10
8421 19
8421 91
8419 40
9027 30
4811 90
8507 30
8539 22
8544 42
8504 50
8541 40
9002 20
9019 10
9019 20
7018 90
3307 90
3926 90
9021 39
3006 10
9021 31
9021 90
8422 20
7418 20
8419 20
8415 90

8421 39
3307 49
3307 90
9402 90
8415 20
8703 23
8705 90
8713 10
8713 90
8714 10
8714 20
9032 10
9402 10
9402 90
9403 10
9404 10
9404 21
9404 29
9404 90
9619 00
9022 19
9022 21
8511 50
9022 90
7013 99
8421 19
8421 21
8421 29
8421 91
8421 99
8422 20
8422 30
8422 40
8419 20
8419 39
8419 40
8419 89
8419 90
9405 10
9405 20
9405 40
9405 91
9405 92

				9405 99 9402 90 7017 90 7017 20 7010 10 7010 20 7010 90 3923 10 3923 29 3923 50 4821 10 4821 90 8309 10 8309 90 8609 00 3923 50 6210 10 6211 32			
2.	ГОСТ Р 50267.0	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 20.13.13 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23 29.10.30 29.10.2 29.10.59 32.50.30 27.51.14 32.50.11 32.50.12 27.11.41	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 49 9018 50 9018 90 9025 11 9025 19	Идентификация: классификация Маркировка и документация Установившиеся значения тока или потребляемой мощности Напряжение между штырями вилки и между любым штырем и корпусом изделия Остаточное напряжение Электрическая прочность изоляции Электрическое сопротивление Токи утечки Прочность корпуса Устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением Устойчивость Поверхности, углы и кромки Температура доступных частей Пути утечки и воздушные зазоры	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – 60 В 0 – 60 В Испытательное напряжение 0,5 – 5 кВ 0 – 0,2 Ом 0,01 – 10 мА Энергия удара (0,5±0,05) Дж Устойчивы/не устойчивы Угол наклона испытательной плоскости 5°, 10° Соответствует/не соответствует 0 – 180 °С 0,4 – 32 мм	

					8423 30 3006 30 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42 9019 10 9019 20 9021 29 9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99				
3.	ГОСТ Р МЭК 60601-1	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 20.13.13 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 8419 89	Идентификация: классификация	-			
					Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует			
					Потребляемая мощность	Не более 10% от величины, указанной на маркировке			
					Пиковое напряжение после разряда дефибриллятора	0 – 1 В			
					Сопротивление защитного заземления	0 – 200 МОм			
					Токи утечки	На пациента: 10 – 5000 мкА На доступную часть: 100 – 500 мкА			

27.51.23	9032 10	Электрическая прочность изоляции	На землю: 5 – 10 мА
29.10.30	9018 11	Механическая прочность и теплостойкость изоляции	Испытательное напряжение от 500 до 4000 В
29.10.2	9018 12	Диаметр отпечатка от испытательного шарика – до 2 мм	
29.10.59	9018 13	Пути утечки	0 – 21 мм
29.10.59	9018 14	Воздушные зазоры	0 – 12 мм
32.50.30	9018 19	Площадь поперечного сечения жил проводов шнура питания	0,75 – 10 мм ²
27.51.14	9018 19	Неустойчивость в положении транспортирования	Угол наклона испытательной плоскости: 10°
32.50.11	9018 20	Неустойчивость в других положениях, исключая положение транспортирования	Угол наклона испытательной плоскости: 5°, 10°
32.50.12	9018 41	Неустойчивость при действии горизонтальных и вертикальных сил	Прикладываемое горизонтальное усилие: до 220 Н Прикладываемое вертикальное усилие: до 800 Н
27.11.41	9025 11	Усилие перемещения	0 – 200 Н
	9025 19	Слышимая акустическая энергия	30 – 130 дБА
	8423 30	Среднеквадратическое значение ускорения вибраций, передаваемых на руки	Не более 2,5 м/с ²
	3006 30	Устойчивость к гидравлическому давлению	Испытательное давление от 50 кПа
	8504 50	Устойчивость к статическим усилиям и нагрузкам, создаваемых оператором или пациентом	Испытательная масса от 80 до 135 кг
	8541 40	Максимальная температура при нормальной эксплуатации	48 – 180°С
	9002 20	Жесткость корпуса	Испытательное усилие от пластины 240 – 260 Н
	8507 30		
	8539 22		
	8544 42		
	9019 10		
	9019 20		
	9021 29		
	9021 40		
	9021 50		
	9021 90		
	3926 90		
	9402 90		
	8415 20		
	8421 39		
	3307 49		
	8703 23		
	8705 90		
	8713 90		
	8714 20		
	9402 10		
	9402 90		
	9402 90		
	9405 10		
	9405 20		
	9405 40		

5.	GOST IEC 60601-1-6	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 28.99.39 20.13.13 28.99.39 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23 29.10.30 29.10.2 29.10.59 29.10.59 32.50.30 27.51.14 32.50.11 32.50.12 27.11.41	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90 9025 11 9025 11 9025 11 9025 19 8423 30 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42	Процесс проектирования эксплуатационной пригодности Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует

					9019 10 9019 10 9019 20 9021 29 9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 10 9402 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99					Идентификация: общие требования - процесс проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует	
6.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-6	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 28.99.39 28.99.39 20.13.13 28.99.39 32.50.13 32.50.21 32.50.50 26.70.22 26.70.23 27.51.24 27.51.23 29.10.30 29.10.2 29.10.59	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9027 30 9027 50 9027 80 9027 80 8419 89 9032 10 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14								

				29.10.59 32.50.30 27.51.14 32.50.11 32.50.12 27.11.41	9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90 9025 11 9025 11 9025 11 9025 19 8423 30 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8504 50 8541 40 9002 20 8507 30 8539 22 8544 42 9019 10 9019 10 9019 20 9021 29 9021 40 9021 50 9021 90 3926 90 9402 90 8415 20 8421 39 3307 49 8703 23 8705 90 8713 90 8714 20 9402 10 9402 10		
--	--	--	--	--	--	--	--

на 408 листах, лист 13						
				9402 90 9402 90 9405 10 9405 10 9405 20 9405 40 9405 91 9405 92 9405 99		
7.	ГОСТ IEC 60601-1-8	Изделия медицинские электрические. Системы сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.70.22 26.70.23 32.50.42 32.50.13 32.50.21 27.51.24 27.51.23	9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 31 9018 39 9018 41 9018 49 9018 50 9018 90 9019 20 9021 40 3006 30 3926 90 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9022 90 9025 11 9025 19 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9032 10 8419 40 8419 89 8419 90 8421 19	Звуковые сигналы: - интервал - амплитуда - частота - продолжительность Идентификация, маркировка и документация	0 – 30 сек 0 – 10 дБ до 1000 Гц 75 – 250 мс Соответствует/не соответствует

на 408 листах, лист 14									
					8421 91 8423 30 3821 00 3822 00 4811 90 8507 30 8539 22 8544 42 8504 50 9002 20				
8.	ГОСТ 30324.0.4	Изделия медицинские электрические. Программируемые медицинские электронные системы	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29		8471 80 9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 19 9018 20 9018 41 9018 49 9018 50 9018 50 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9018 90 9019 10 9019 10 9019 10 9019 10 9019 20 9021 40 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует		

на 400 листах, лист 13

				9025 11 9025 11 9025 11 9025 19 9027 30 9027 50 9027 80 9027 80 9027 80 9027 90 9032 10 3006 30 3822 00 2804 40 2811 21 4811 90 8507 30 8539 22 8544 42 8419 40 8419 89 8419 90 8421 19 8421 91 8423 30 3821 00 3822 00				
9.	ГОСТ ISO 11607-1	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Материалы, барьерные системы для стерилизации и упаковочным системам	-	-	Стерилизация	Соответствует/ не соответствует		
10.	ГОСТ ISO 11607-2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации	-	-	Стерилизация	Соответствует/ не соответствует		
11.	ГОСТ EN 556-1	Медицинские изделия, подлежащие финишной стерилизации	-	-	Документация производителя	Соответствует/не соответствует		
12.	ГОСТ 15150	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Климатические воздействия	Соответствует/ не соответствует		

13.	ГОСТ Р МЭК/ГО 60788	Изделия медицинские электрические	-	-	Словарь	Соответствует/не соответствует
14.	РД 50-707	Изделия медицинской техники	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ Р ИСО 15223-1	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации	32.50	-	Идентификация символов	Соответствует/не соответствует
16.	СТБ EN 1041 (EN 1041, IDT)	Информация, предоставляемая изготовителем	-	-	Требования к информации, предоставляемой изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Символы	Соответствует/не соответствует
					Цвета идентификации	Соответствует/не соответствует
17.	ГОСТ 30324.0	Изделия медицинские электрические	26.60.12 26.60.11 32.50.42 26.60.13 32.50.21	9018 11 9018 12 9018 13 9018 14 9018 19 9018 20 9018 41 9018 50 9018 90	Классификация Идентификация, маркировка и документация Потребляемая мощность Транспортирование и хранение Условия эксплуатации Напряжение между штырями вилки и между любым штырем и корпусом изделия Отсутствие остаточного напряжения, превышающее 60 В Токи утечки Полное электрическое сопротивление Электрическая прочность изоляции Прочность и жесткость корпусов Нагрузка на опорные детали изделия Прочность ручных частей изделия Воздействие, вызванное грубым обращением Поверхности, углы и кромки Устойчивость при нормальной эксплуатации	- - Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 60 В Соответствует/не соответствует 0,01 – 10 мА Не более 0,2 Ом Испытательное напряжение 500 – 4000 В Соответствует/не соответствует 135 кг Испытание падением с высоты 1 м на твердую поверхность Высота падения 2 – 5 см Соответствует/не соответствует Не должно опрокидываться при угле наклона 5° и 10°

18.	ГОСТ Р МЭК 62366	Изделия медицинские	32.50	-	Допустимые максимальные температуры	Не более 180°C
					Температуры поверхностей рабочих частей, не предназначенных для передачи тепла	Не более 41°C
					Перелив, распыскивание, утечка	Соответствует/не соответствует
					Проникание жидкостей	Соответствует/не соответствует
					Очистка, стерилизация и дезинфекция	Выдерживают/не выдерживают
					Органы управления	Вращающий момент 1,0 – 5,0 Нм
					Механическая прочность ножных органов управления	Испытание силой 1350 Н в течение 1 мин
					Сечение жил шнуров питания	0,75 – 10 мм²
					Идентификация: Общие требования:	
					- процессы проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- остаточный риск	Соответствует/не соответствует
					- информация, касающаяся безопасности	Соответствует/не соответствует
					- файл проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					- изменение объема проектирования с учетом эксплуатационной пригодности	Соответствует/не соответствует
					Процесс проектирования с учетом эксплуатационной пригодности:	Соответствует/не соответствует
					- спецификация применения	Соответствует/не соответствует
					- часто используемые функции	Соответствует/не соответствует
					- идентификация опасностей и опасных ситуаций, связанных с эксплуатационной пригодностью	Соответствует/не соответствует

					- основная рабочая функция - спецификация эксплуатационной пригодности - план валидации эксплуатационной пригодности - разработка и внедрение пользовательского интерфейса - верификация эксплуатационной пригодности - валидация эксплуатационной пригодности - эксплуатационный документ	- Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует
19.	ГОСТ 14254	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	-	-	- Обозначение - Степени защиты - Маркировка - Защита от доступа к опасным частям оборудования, обозначаемой первой характеристической цифрой - Защита от попадания внешних предметов, обозначаемой первой характеристической цифрой - Защита от воды, обозначаемой второй характеристической цифрой - Защита от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой - Идентификация: термины и определения	- Соответствует/не соответствует - - Соответствует/не соответствует - - - - -
20.	ГОСТ 25375	Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения	-	-		-
21.	ГОСТ Р 52238	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые	22.19.60	4015 11	- Идентификация: классификация - Материалы - Размеры: - размер - ширина W - длина l	- Соответствует/не соответствует 5 - 9,5 63 - 127 мм - Не менее 250 - 280 мм

					- толщина в местах измерения 0,10 — для гладких участков; 0,13 — для текстурированных участков - герметичность Соответствует/не соответствует Прочностные характеристики: - усилие при разрыве до ускоренного старения Не менее 9 – 12,5 Н - удлинение при разрыве до ускоренного старения Не менее 600 – 700 % - усилие, необходимое для достижения удлинения на 300 % до ускоренного старения 2 – 3 Н - усилие при разрыве после ускоренного старения Не менее 9,0 – 9,5 Н - удлинение при разрыве после ускоренного старения Не менее 550% - стерильность Перчатки должны быть стерильными Упаковка Соответствует/не соответствует Маркировка Соответствует Ширина по пятому пястнофаланговому суставу 8 – 117 мм Ширина запястья 65 – 97 мм Длина среднего пальца 62 – 90 мм Толщина 0,10 – 0,27 мм Условная прочность при растяжении Не менее 20 – 25 МПа Относительное удлинение при разрыве Не менее 600% - 750% Относительное остаточное удлинение после разрыва Не более 18% - 20% Герметичность Соответствует/ не соответствует Маркировка Соответствует/не соответствует Упаковка Соответствует/не соответствует Классификация Соответствует/ не соответствует - материалы Соответствует Размеры: - размер Ниже 6 – выше 9 - ширина W Менее 80 – более 110 мм
22.	ГОСТ 3	Перчатки хирургические резиновые	22.19.60	4015 11	
23.	ГОСТ Р 52239	Перчатки медицинские диагностические одноразовые	22.19.60	4015 11	

24.	ГОСТ Р 57396	Перчатки хирургические резиновые	22.19.60	4015 11	- длина I - толщина в местах измерения	Не менее 220 – 230 мм Не менее 0,8 мм для гладких участков, не менее 0,11 мм для текстурированных участков; Не более 2 мм для гладких участков (приблизительно в центре ладони), не более 2,03 мм для текстурированных участков (приблизительно в центре ладони)
					- герметичность	Соответствует/ не соответствует
					Прочностные характеристики:	
					- усилие при разрыве до ускоренного старения	Не менее 7 Н
					- удлинение при разрыве до ускоренного старения	Не менее 500 – 650 %
					- усилие при разрыве после ускоренного старения	Не менее 6,0 – 7,0 Н
					- удлинение при разрыве после ускоренного старения	Не менее 400 – 500 %
					- стерильность	Соответствует/ не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	соответствует
					Классификация	I тип / II тип
					Материалы и изготовление	Соответствует/ не соответствует
					Стерильность	
					Герметичность	
					Размеры:	
					- длина	245-265 мм
					- ширина	70-114 мм
					- толщина в точках измерения пальца, ладони, манжеты	0,10 мм
					Физико-механические свойства:	
					- прочность при растяжении	До ускоренного старения: Не менее 24 МПа / 17 МПа После ускоренного старения: Не менее 18 МПа / 12 МПа
					- удлинение при разрыве	До ускоренного старения: Не менее 750% / 650% После ускоренного старения:

25.	ГОСТ Р 57397	Перчатки медицинские диагностические резиновые	22.19.60	4015 11	- напряжение при 500 %-ном удлинении	Не менее 560% / 490%
					- масса остаточного опудривающего вещества для неопудренных перчаток	До ускоренного старения: Не более 5,5 МПа / 7,0 МПа Не более 2,0 мг
					- масса опудривающего вещества для опудренных перчаток	Не более 15 мг
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	I тип / II тип
					Материалы и изготовление	Соответствует/ не соответствует
					Стерильность	соответствует
					Герметичность	
					Размеры:	
					- длина	220-230 мм
					- ширина	75-114 мм
					- ширина по маркировке	70-111 мм
					- толщина в точках измерения пальца, ладони	0,08 мм
					Физико-механические свойства:	
					- прочность при растяжении	До ускоренного старения: Не менее 18 МПа / 14 МПа После ускоренного старения: Не менее 14 МПа / 14 МПа
					- удлинение при разрыве	До ускоренного старения: Не менее 650% / 650% После ускоренного старения: Не менее 500% / 500%
					- напряжение при 500 %-ном удлинении	До ускоренного старения: Не более 5,5 МПа / 2,8 МПа
					- масса остаточного опудривающего вещества для неопудренных перчаток	Не более 2,0 мг
					- масса опудривающего вещества для опудренных перчаток	Не более 10 мг/дм ²
					Упаковка	Соответствует/не соответствует

					Маркировка	Соответствует/не соответствует
26.	ГОСТ EN 455-1	Перчатки медицинские одноразовые	22.19.60	4015 11	Герметичность	Изделие должно быть герметичным
27.	ГОСТ EN 455-2	Перчатки медицинские одноразовые	22.19.60	4015 11	Длина Ширина Прочность	Не менее 250 – 280 мм 63 – 127 мм Не менее 3,6 – 9,0 Н
28.	ГОСТ ISO 10282	Перчатки хирургические резиновые стерильные одноразовые	22.19.60	4015 11	Классификация Материалы Размеры: - ширина W - длина l - толщина	Соответствует/ не соответствует 63 – 127 мм Не менее 250-280 мм Гладкая поверхность не менее 0,10 мм / Текстурированная поверхность не менее 0,13 мм
					- герметичность Прочностные свойства: - усилие при разрыве до ускоренного старения - относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения - усилие при 300 %-ном удлинении до ускоренного старения	Соответствует/ не соответствует Не менее 12,5 Н / 9,0 Н Не менее 700% / 600% Не более 2,0 Н / 3,0 Н
					- усилие при разрыве после ускоренного старения - относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	Не менее 9,5 Н / 9,0 Н Не менее 550% / 500%
					Стерильность	Изделия должны быть стерильными
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
29.	ГОСТ Р 57402	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Срок годности	Соответствует/ не соответствует
30.	ГОСТ Р 57403	Перчатки медицинские из поливинилхлорида	22.19.60 22.29.10	4015 11 3926 20	Материалы Стерильность Герметичность Размеры: - ширина по размеру - ширина по маркировке - длина	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует 69 – 114 мм 80 – 120 мм 230 мм

					- толщина в точках измерения пальца - толщина в точках измерения ладони	0,05 мм 0,08 мм	
					Физико-механические свойства: - прочность при растяжении - относительное удлинение при разрыве - масса остаточного опудривающего вещества для неопудренных перчаток - масса опудривающего вещества для опудренных перчаток	Не менее 11 МПа Не менее 300% 0 – 2,0 мг 0 – 10 мг/дм ²	
31.	ГОСТ 33070	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Упаковка и маркировка упаковочного вещества	Соответствует/не соответствует	
32.	ГОСТ 33076	Перчатки медицинские	22.19.60	4015 11	Герметичность	Соответствует/ не соответствует	
33.	ГОСТ ISO 25518	Перчатки резиновые одноразовые общего назначения	22.19.60	4015 11	Материалы	Соответствует/ не соответствует	
					Размеры:		
					- ширина W	Менее 80 мм – более 110 мм	
					- длина l	Не менее 220 – 230 мм	
					- герметичность	Соответствует/ не соответствует	
					Прочностные свойства при растяжении:		
					- усилие при разрыве до ускоренного старения	Не менее 7,0 Н	
					- относительное удлинение при разрыве до ускоренного старения	Не менее 500%	
					- усилие при разрыве после ускоренного старения	Не менее 6,0 Н	
					- относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения	Не менее 400%	
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	
34.	ГОСТ 12.4.264 (EN 421)	Перчатки для защиты от ионизирующего излучения и радиоактивных веществ	32.99.11	6203 22 6203 23	Свинцовый эквивалент	Соответствует/ не соответствует	
					Равномерность распределения свинца	Соответствует/не соответствует	
					Герметичность	Соответствует/не соответствует	
					Электрическое сопротивление	Соответствует/не соответствует	
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	
					Упаковка	Соответствует/не соответствует	
					Информация изготовителя	Соответствует/не соответствует	

35.	ГОСТ 32337	Перчатки медицинские диагностические нитрильные	22.19.60	4015 11	Безопасность Материалы Технические требования: - стерильность - отверстие Размеры: - ширина по размеру - ширина по маркировке - длина - толщина - масса опудряваемого вещества - содержание опудрявающего вещества Упаковка и маркировка упаковки Упругопрочностные свойства при растяжении Ускоренное старение Классификация и основные размеры: - диаметр сосковой части - диаметр баллончика - внутренний диаметр венчика - длина соски - толщина стенки баллончика соски Технические требования: - условная прочность при растяжении - относительное удлинение при разрыве - относительное остаточное удлинение после разрыва Маркировка Упаковка Транспортирование и хранение Длина Ширина Толщина Венчик Масса	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Отсутствие/наличие (75 – 114) ±6 мм (70 – 120) ±10 мм Не менее 220 – 230 мм Не менее 0,05 мм Не более 2,0 мг 0 – 10 мг/дм² Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует 13 – 18 мм 24 – 28 мм 8 – 18 мм 31 – 64 мм 0,8 – 2 мм Не менее 21 (210) МПа (кгс/см²) Не менее 800% 0 – 20% Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Не менее 176 мм 54±2 мм 0,05 – 0,3 мм 1,5±0,3 мм (1,4±0,3) г
36.	ГОСТ 270	Резина	22.19.71	4014 90		Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует
37.	ГОСТ ISO 188	Резина и термозластопласты	22.19.71	4014 90		Соответствует/ не соответствует
38.	ГОСТ Р 51068	Соски латексные детские	22.19.71	4014 90		
39.	ГОСТ 4645	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10		

					Физико-механические показатели:	
					- условная прочность при растяжении	Не менее 17 – 20 (170 – 200) МПа (кгс/см ²)
					- относительное удлинение при разрыве	Не менее (600 – 700) %
					- отсутствие отверстий и видимых дефектов	Не должно быть отверстий и видимых дефектов
40.	ГОСТ 29102.1	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Длина	Соответствует/ не соответствует
41.	ГОСТ 29102.2	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Ширина	Соответствует/ не соответствует
42.	ГОСТ 29147	Презервативы резиновые	22.19.71	4014 10	Масса	Соответствует/ не соответствует
43.	ГОСТ ISO 8009	Механические противозачаточные средства. Диафрагмы многоразовые резиновые и силиконовые	22.19.71	4014 10	Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Материалы	
					Конструкция	
					Размеры:	
					- диаметр	55 – 100 мм
					- толщина куполообразного колпачка	Не менее 0,20 мм
					Физико-механические свойства куполообразного колпачка:	
					- условная прочность при растяжении до теплового старения	Не менее 15 МПа / 7 МПа
					- условная прочность при растяжении после теплового старения	Не менее 11 МПа / 7 МПа
					- относительное удлинение при разрыве до теплового старения	Не менее 650% / 350%
					- относительное удлинение при разрыве после теплового старения	Не менее 500% / 350%
					Физико-механические свойства ободка и пружины:	
					- сопротивление сжатию	Степень скручивания после 1000-го цикла сжатия не более 20°
					- скручивание при сжатии	Степень скручивания диафрагмы не более 20°
					- отсутствие видимых дефектов	На поверхности не должно быть видимых дефектов
					Упаковка, маркировка и хранение	Соответствует/не соответствует

44.	ГОСТ ISO 16037	Презервативы резиновые для клинических испытаний	4014 10	22.19.71	4014 10	Длина	Не менее 176 мм
						Ширина	54±2 мм
						Толщина	0,05 – 0,3 мм
						Венчик	1,5±0,3 мм
						Разрывной объем и давление	Соответствует/ не соответствует
						Физико-механические свойства при растяжении:	Соответствует/ не соответствует
						- модуль упругости	1 – 10 МПа
						- усилие при разрыве	0 – 100 Н
						- удлинение при разрыве	0 – 600%
						- масса смазки	0 – 10 г
45.	ГОСТ ISO 23409	Презервативы мужские из синтетических материалов	4014 10	22.19.71	4014 10	- отсутствие отверстий и видимых дефектов	Не должно быть отверстий и видимых дефектов
						Масса смазки	Соответствует/ не соответствует
						Длина	Не менее 160 мм
						Ширина	Соответствует/ не соответствует
						Толщина	Соответствует/ не соответствует
						Разрывной объем и давление	Соответствует/ не соответствует
						Герметичность	Изделия должны быть герметичны
						Срок годности	Не более 5 лет
						Видимые дефекты	Соответствует/не соответствует
						Целостность индивидуальной упаковки	Соответствует/ не соответствует
46.	ГОСТ ИСО 4074-5	Презервативы резиновые	4014 10	22.19.71	4014 10	Упаковка и маркировка	Соответствует/не соответствует
						Техническое описание	Соответствует/не соответствует
						Отсутствие отверстий	Не должно быть отверстий
						Растягивающая нагрузка	Соответствует/ не соответствует
						Удлинение	Соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Маркировка	Соответствует
						Назначение	В соответствии с технической документацией производителя
						Диаметр	(150-200) ±10 мм
						Толщина стенки	1,5 ±0,5 мм
47.	ГОСТ ИСО 4074-9	Презервативы резиновые	4014 10	22.19.71	4014 10	Форма и размеры пузырей специального назначения	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Типы и основные размеры	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
48.	ГОСТ ИСО 4074-10	Презервативы резиновые	4014 10	22.19.71	4014 10	Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
49.	ГОСТ 3302	Пузыри резиновые для льда	4014 90	22.19.71	4014 90	Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
50.	ГОСТ 3303	Грелки резиновые	4014 90	22.19.71	4014 90	Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией
						Технические требования:	В соответствии с нормативно-технической документацией

						- условная прочность при растяжении - относительное удлинение - относительная остаточная деформация после разрыва	Не менее 6,5 МПа Не менее 500% Не более 35%
51.	ГОСТ 3399	Трубки медицинские резиновые	22.19.71	4014 90		- Внешний вид - Внутренний диаметр - Толщина стенки - Условная прочность при растяжении - Относительное удлинение при разрыве	Соответствует/не соответствует 3,4 – 25,5 мм 1,2 – 10,5 мм Не менее 5,0 – 20,0 (50 – 200) МПа (кгс/см²) Не менее (300 – 800) %
52.	ГОСТ Р 51854	Линзы очковые солнцезащитные	32.50.42.190	9004 10 100 0 9004 10 910 0 9004 10 990 0		- Классификация - Требования к коэффициенту пропускания: - диапазон значений светового коэффициента пропускания τ_v - значение коэффициента пропускания - Требования к основным параметрам и размерам линз: - относительное изменение светового коэффициента пропускания после экспозиции 50000 лк в течение 15 мин	В соответствии с нормативно-технической документацией 0,03 – свыше 0,8 отн. ед. 0,1 τ_{v0} $\square$ τ_v
53.	ГОСТ Р 55038	Эндотампоны глазные	32.50.22	9021 39		- Маркировка и упаковка - Идентификация: информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует -
54.	ГОСТ Р 53950	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50		- Классификация - Технические требования: - рефракция поверхности на втором главном меридиане - предельное отклонение на первом главном меридиане - предельное отклонение абсолютного значения астигматической разности (цилиндра) - предельное отклонение оси цилиндра - призматическое действие	- - 0,00 – более 20,00 дптр $\pm (0,09 - 0,37)$ дптр $\pm (0,09 - 0,37)$ дптр $\pm (2 - 7)^\circ$ 0 – более 10 пдптр

55.	ГОСТ 30808	Линзы очковые	32.50.41	9001 40 9001 50	- требования к геометрическим параметрам очковых линз	Соответствует/ не соответствует
					- требования к материалам очковых линз	
					- требования к светопропусканию очковых линз	Световой коэффициент пропускания не менее 3%
					- устойчивость к механическим воздействиям	Соответствует/ не соответствует
					Требования надежности:	
					- средний срок хранения	Не менее 5 лет / 15 лет
					Требования устойчивости к механическим воздействиям	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	-
					Основные параметры и размеры:	
56.	ГОСТ Р 55039	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые неацетирированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50	- абсолютное номинальное значение задней вершинной рефракции	До 3,0 – свыше 20,0 дптр
					- допустимое значение астигматизма	0,06 – 0,12 дптр
					Технические требования	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация очковых линз по светопропусканию	Соответствует/ не соответствует
					Световой коэффициент пропускания	3 – 100 %
					Стойкость к истиранию	Испытуемая поверхность не должна иметь видимых следов истирания
					Технические требования к фильтрам солнцезащитных очков:	
					- классификация	В соответствии с нормативно-технической документацией
					- световой коэффициент пропускания τ_v	0,03 – свыше 0,8 отн. ед.
57.	ГОСТ Р 56094	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые неацетирированные готовые	32.50.41	9001 40 9001 50	- наибольшее значение спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$	0,1 $\tau_v - \tau_v$
					- оптическая сила	$\pm (0,09 - 0,12)$ дптр
					- призматическое действие	0,2 дптр
58.	ГОСТ Р 51831	Очки солнцезащитные	32.50.42	9004 10 9004 90	- требования к фильтрам солнцезащитных очков:	
					- классификация	В соответствии с нормативно-технической документацией
					- световой коэффициент пропускания τ_v	0,03 – свыше 0,8 отн. ед.
					- наибольшее значение спектрального коэффициента пропускания $\tau(\lambda)$	0,1 $\tau_v - \tau_v$
					- оптическая сила	$\pm (0,09 - 0,12)$ дптр
					- призматическое действие	0,2 дптр

				Требования к готовым солнцезащитным очкам:	Соответствует/ не соответствует
				- конструкция	
				- материалы	
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Конструкция	Соответствует/ не соответствует
				Размеры	
59.	ГОСТ 31589	Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков	32.50.43	9004 90	
60.	ГОСТ ISO 9801	Наборы пробных очковых линз	32.50.41	9001 40 9001 50	
					Требования к оптическим элементам:
					- значение рефракции
					0 – свыше 12,00 дптр
					- призматическое действие
					До 6 – свыше 6 пдптр
					- оптическая сила
					01,12 – свыше 12,00 дптр
					Размеры:
					- наружный диаметр пробной очковой линзы в оправе
					38 мм
					- максимальная толщина линзы, включая толщину оправы
					0 – 2,8 мм
					- апертура линз
					0 – 18 мм
					Соответствует/ не соответствует
61.	ГОСТ Р ИСО 10341 п.6	Офтальмологические приборы. Форопторы	32.50.13	9018 50	
62.	ГОСТ Р 56169	Микроскопы операционные	26.60.12	9018 50	
					Проверка сопроводительной документации
					Соответствует/ не соответствует
					Требования к оптико- механическим характеристикам
					Соответствует/ не соответствует
					Допуск на полное увеличение
					±7,5%
					Разность увеличений правой и левой оптических систем
					Не более 1,5%
					Расхождение осей правой и левой оптических систем по вертикали
					Не более 15'
					Расхождение осей правой и левой оптических систем по горизонтали
					Сходимость не более 45' Расходимость не более 10'
					При максимальном увеличении разрешающая способность в центре поля
					Не более 1800NA пар линий/мм
					Разность поворота изображений в правой и левой оптических системах
					≤2°

					Разновысотность выходных зрачков правой и левой оптических систем окуляра	Не более 1,5 мм при 0 дптр по диоптрийной шкале
					Погрешность калибровки диоптрийной шкалы окуляра	$\pm 0,25$ дптр при 0 дптр по диоптрийной шкале
					Минимальный интервал окуляра межзрачковых расстояний	55 – 75 мм
					Минимальный интервал регулировки: - общий - по вершине глаза	От +5 до -5 дптр включ. От +2 до -4 дптр включ.
					Требования устойчивости к внешним факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
63.	ГОСТ Р ИСО 9211-1	Оптические покрытия	26.60.12	9018 50	Термины и определения	-
64.	ГОСТ Р ИСО 9211-2	Оптические покрытия. Оптические свойства	26.60.12	9018 50	Оптические свойства и характеристики	Соответствует/ не соответствует
65.	ГОСТ Р ИСО 9211-4	Оптические покрытия. Оптические свойства	26.60.12	9018 50	Числовое описание и графическое представление спектральных характеристик	Соответствует/ не соответствует
					Сопровождение истиранию: - число циклов	20 – 100
					- усилие	4 – 11 Н
					Адгезия: - скорость отрыва ленты	2 – 3 с на 25 мм (медленная) 1 с на 25 мм (быстрая) Быстрее чем 1 с на 25 мм (рывком)
66.	ГОСТ Р 53939	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые полуготовые	32.50.41	9001 40 9001 50	Оптические требования к обработанной поверхности полуготовых линз: - рефракция поверхности на втором главном меридиане - астигматизм поверхности - дополнительная рефракция для близости - требования к геометрическим характеристикам полуготовых линз - требования к оценке качества поверхностей и материала Транспортирование и хранение	От 0,00 свыше 20,00 дптр 0,25 – 6,00 дптр До 4,00 свыше 4,00 дптр Соответствует/ не соответствует

	ГОСТ Р 51193				Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
67.		Оптика офтальмологическая. Очки корректирующие	32.50.42	9004 10 9004 90	Классификация Технические требования: - абсолютная величина задней вершинной рефракции на горизонтальном меридиане ($A_x = 0$) астигматических линз F_{vh} - предельные отклонения расстояний - абсолютная величина задней вершинной рефракции на вертикальном меридиане ($A_x = 90^\circ$) астигматических линз F_w - предельные отклонения расстояний - абсолютная величина разности высот оптических центров линз при разных знаках отклонений высот от номинальных значений - астигматическая разность рефракций - абсолютная величина разности высот оптических центров линз при разных знаках отклонений высот от номинальных значений, мм - призматическое действие - предельное отклонение положения основания призмы - допустимое предельное отклонение H_s от измеренного в выбранной оправе - абсолютное значение разности высот сегментов	Соответствует Соответствует/ не соответствует 0,00 – 1,50 дптр 1,75 – 2,25 дптр 2,50 – 3,75 дптр 4,00 – 10,00 дптр ±4 мм ±3 мм ±2 мм ±1 мм 0,00 – 0,50 дптр 0,75 – 1,00 дптр Свыше 1,00 дптр ±3 мм ±2 мм ±1 мм 6 мм 3 мм 1 мм 0,00 – 0,50 дптр 0,75 – 1,50 дптр Свыше 1,50 дптр ±7,0° ±3,0° ±2,0° До 2,00 пдптр От 2,0 до 5,0 пдптр Свыше 5 пдптр ±10,0° ±5,0° ±2,0° ± 1,0 мм 0 – 1,0 мм

									- рефракция поверхности на втором главном меридиане - предельное отклонение на первом главном меридиане - предельное отклонение оси цилиндра - специальные требования к средствам индивидуальной защиты глаз - дополнительные требования к средствам индивидуальной защиты глаз, покровным и очковым стеклам с покрытием-фильтром Маркировка Упаковка Информация, предоставляемая изготовителем	0 – более 20,00 дптр ±(0,09 – 0,37) дптр ±(2° – 7°) Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует	на 408 листах, лист 53
70.	ГОСТ Р ИСО 9342-2	Оптика и оптические приборы. Контрольные линзы для настройки и поверки диоптриметров. Контрольные линзы для диоптриметров, используемых для измерений параметров контактных линз	32.50.13 32.50.41	9018 50 9001 30				Номинальное значение задней вершинной рефракции Световой диаметр сферических контрольных линз Номинальный радиус кривизны задней поверхности Диапазон значений толщины по центру линзы Термины и определения	От минус 20 до плюс 20 м ⁻¹ (дптр) Не менее 8 мм 8±0,1 мм 0,5 – 2 мм -	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует	
71.	ГОСТ Р ИСО 8600-6	Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские	32.50.13	9018 90						Соответствует/не соответствует	
72.	ГОСТ Р ИСО 14534	Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за контактными линзами	32.50.41	9001 30				Безопасность и эксплуатационные свойства - конструкция - материалы - технология Упаковка Срок предпродажного хранения и дата утилизации Этикетирование и информация, предоставляемая изготовителем Термины и определения	Соответствует/ не соответствует -	Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/не соответствует	
73.	ГОСТ Р ИСО 13666	Оптика офтальмологическая. Линзы очковые	32.50.41	9018 50 900 0						Соответствует/не соответствует	

74.	ГОСТ 8778	Заготовки очковых линз	32.50.41.120	9001 40 9001 50 9018 50	Типы	Соответствует/не соответствует
					Основные размеры: - номинальные значения диаметров	44 – 76 мм
					Технические требования: - коэффициент дисперсии стекла - показатель ослабления стекла	Не менее 58 Не более 0,0130 см ⁻¹
					- удельная разность хода Упаковка, транспортирование и хранение	Не более 50 нм/см Соответствует/не соответствует
					Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
75.	ГОСТ ISO 10342 п.6	Рефрактометры офтальмологические	32.50.13	9018 50	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
76.	ГОСТ ISO 10343 п.6	Офтальмометры	32.50.13	9018 50	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Фоновая яркость	От +25% до -20% нормированного значения
77.	ГОСТ Р ИСО 12866	Периметры офтальмологические	32.50.13	9018 50	Контраст	От +25% до -20% нормированного значения
					Положение светового стимула	± 0,5° от заданных координат для световых стимулов, находящихся в пределах угла 10° от центра экрана периметра; ± 1,0° от заданных координат для световых стимулов, находящихся в пределах диапозона 10° ± 30° от центра экрана периметра; ± 2,0° от заданных координат для световых стимулов, находящихся за пределами угла 30° от центра экрана периметра
					Размер светового стимула	От +20 % до -15 % нормированного значения, переведенного в телесный угол
					Длительность светового стимула	± 20 % нормированного значения длительности светового стимула

					Размер фоновой поверхности периметра	Не менее 2,0° от края наиболее удаленного от центра светового стимула
					Минимальный допустимый эксцентриситет для наборов световых стимулов	25° – 70°
					Минимальное допустимое число позиций возможного предъявления световых стимулов	15 – 105
					Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
78.	ГОСТ 31590.1	Приборы офтальмологические	32.50.13	9018 50	Требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
					Требования к характеристикам	Соответствует/ не соответствует
					Требования к взаимодействию с различными приборами	Соответствует/ не соответствует
					Требования к шкалам и индикаторам	Соответствует/ не соответствует
					Требования термической безопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования механической безопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования к климатическим факторам при эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
					Требования к условиям хранения	Соответствует/ не соответствует
					Требования электробезопасности	Соответствует/ не соответствует
					Требования механической прочности	Соответствует/ не соответствует
					Требования безопасности оптического излучения	Соответствует/ не соответствует
					Требования к сопроводительным документам	Соответствует/не соответствует
79.	ГОСТ Р 56092	Приборы офтальмологические	32.50.13	9018 50	Требования к маркировке	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/ не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
80.	ГОСТ Р 53466	Оптика и оптические приборы. Тепловизоры медицинские	32.50.13	9018 50	Общие требования	Соответствует/ не соответствует
					Требования назначения	Соответствует/ не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	Соответствует/ не соответствует
					Требования эргономики и технической эстетики	Соответствует/ не соответствует

					Требования технического обслуживания и ремонта	Соответствует/ не соответствует
					Требования к транспортированию, упаковке, хранению и маркировке	Соответствует/ не соответствует
81.	ГОСТ Р ИСО 19980 п.6	Офтальмологические приборы. Топографы роговицы глаза	32.50.13	9018 50	Сопроводительные документы	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
82.	ГОСТ Р 56673 п.6	Приборы офтальмологические. Фундус-камеры	32.50.13	9018 50	Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/ не соответствует
83.	ГОСТ Р ИСО 8612	Приборы офтальмологические. Тонометры	32.50.13	9018 50	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Безопасность	Соответствует/ не соответствует
84.	ГОСТ Р 50606	Оптика и оптические приборы. Диоптриметры	32.50.13	9018 50	Функциональные характеристики	Соответствует/ не соответствует
					Диапазон измерений вершинной рефракции	Не менее от минус 20 до плюс 20 дптр
					Призматическое действие	Не менее от 0 до 5Δ
					Направление оси	0° - 360°
					Диоптриметры с аналоговым отсчетом:	
					- цена деления	Не более 0,25 дптр
					- цена деления шкалы направления оси	Не более 5°
					Диоптриметры с цифровым отсчетом:	
					- дискретность отсчета в интервале от минус 10 до плюс 10 дптр	Не более 0,125 дптр
					- дискретность отсчета в интервале за пределами ±10 дптр	Не более 0,25 дптр
					- дискретность отсчета для направления оси	1°
					- дискретность отсчета призматического действия	Не более 0,25Δ
					Конструкция	Должна обеспечивать измерение линз диаметром не менее 80 мм и толщиной не менее 20 мм
85.	ГОСТ Р ИСО 7944	Оптика и оптические приборы	32.50.13	9018 50	Точностные требования	Соответствует/ не соответствует
86.	ГОСТ 31586	Линзы контактные мягкие	32.50.41	9001 30	Эталонные длины волн	Соответствует/ не соответствует
					Классификация	-
					Основные параметры и размеры:	
					- основные размеры	Соответствует/ не соответствует
					- задняя вершинная рефракция	От минус 20 до плюс 20 дптр

87.	ГОСТ 31587	Линзы контактные мягкие окрашенные	32.50.41	9001 30	- требования к комплектности технической документации	Соответствует/не соответствует
					Требования к исполнению	УХЛ 4.2
					Требования к качеству обработки поверхностей	Класс чистоты РIII
					Требования к воздействию климатических факторов	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
					Классификация	-
					Основные параметры и размеры:	
					Номинальный диаметр зоны, маскирующей радужную оболочку глаза	Не должен отличаться от общего диаметра более чем на 2 мм
88.	ГОСТ 31588.3	Оптика офтальмологическая. Линзы контактные	32.50.41	9001 30	Диаметр зоны зрачка	Не менее 3 мм и не более 5 мм
					Световой коэффициент пропускания	10 – 80 %
					Требования к материалу	Соответствует/ не соответствует
					Требования надежности	
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
					Радиус кривизны	8,3 – 8,8 мм
					Задняя вершинная рефракция	Минус 20,00 дптр – плюс 20,00 дптр
					Общий диаметр	13,0 – 15,0 мм
89.	ГОСТ 23496	Эндоскопы медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Включения и поверхностные дефекты	Соответствует/ не соответствует
					Классификация	-
					Технические требования	Соответствует/ не соответствует
					Присоединительные размеры	Соответствует/ не соответствует
					Безотказная наработка	От 320 до 4000 циклов
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
					Общие положения	Соответствует/ не соответствует
					Требования к поверхности и краям	Соответствует/ не соответствует
					Требования к максимальной ширине рабочей части	Соответствует/ не соответствует
90.	ГОСТ Р 53469	Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90		

					Требования к минимальной ширине инструментального канала	Соответствует/ не соответствует
					Отклонение поля зрения	Не более 15%
					Отклонение направления наблюдения жесткого эндоскопа	Не более 10°
					Требования к соединителям и подключению	Соответствует/не соответствует
					Требования к маркировке	Соответствует/не соответствует
					Требования к инструкции по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Требования к упаковке, транспортированию и хранению	Соответствует/ не соответствует
91.	ГОСТ 26332	Эндоскопы медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование	Соответствует/ не соответствует
					Хранение	Соответствует/не соответствует
92.	ГОСТ Р 55037	Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские	26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 50 9018 90	Размеры	Соответствует/ не соответствует
					Частные технические требования	Соответствует/не соответствует
					Термины и определения	-
					Безопасность	Соответствует/ не соответствует
94.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-18	Эндоскопическая аппаратура	26.60.13 26.60.12 26.70.22 26.70.23 32.50.13	9018 20 9018 49 9018 90	Функциональные характеристики	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные документы	Соответствует/ не соответствует
					Технические требования	Размеры белья не менее/Абсорбционная способность: 400х600 мм/ 400-500 мл 600х600 мм/ 800-1200 мл 600х900 мм/ 1200-1900 мл
95.	ГОСТ Р 57762	Белье абсорбирующее для инвалидов	32.50.50	3006 10	Комплектность	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует

96.	ГОСТ Р ИСО 15621	Средства для впитывания мочи	21.20.23	9619 00	Факторы, относящиеся к пользователям	Соответствует/ не соответствует
97.	ГОСТ Р 57889	Средства для впитывания мочи, носимые на теле человека	21.20.23	9619 00	Классификация Конструкция Исполнение Внешний вид Показатели качества: - абсорбционная способность до момента протекания (ABL), с применением манекена - сорбционная способность после центрифугирования (влагодерживающая способность) - распределение суперабсорбента в структуре абсорбирующего слоя (секционное центрифугирование) - обратная сорбция (повторное увлажнение) - время впитывания	Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Соответствует/ не соответствует Менее 300 г – более 900 г 0 – 1500 г
98.	ГОСТ Р ИСО 17190-5	Средства мочепоглощения при недержании. Абсорбиционные материалы на полимерной основе	21.20.23	9619 00	Маркировка Упаковка Способность к свободному набуханию в солевом растворе	Соответствует/не соответствует Соответствует/ не соответствует
99.	ГОСТ Р ИСО 17190-6	Средства мочепоглощения при недержании. Абсорбиционные материалы на полимерной основе	21.20.23	9619 00	Способность задерживать жидкость в солевом растворе после центрифугирования	Соответствует/ не соответствует
100.	ГОСТ Р ИСО 17190-7	Средства мочепоглощения при недержании. Абсорбиционные материалы на полимерной основе	21.20.23	9619 00	Поглощение под давлением	Соответствует/ не соответствует
101.	ГОСТ Р ИСО 17190-8	Средства мочепоглощения при недержании. Абсорбиционные материалы на полимерной основе	21.20.23	9619 00	Скорость растекания	Соответствует/ не соответствует
102.	ГОСТ Р ИСО 17190-9	Средства мочепоглощения при недержании. Абсорбиционные материалы на полимерной основе	21.20.23	9619 00	Плотность	Соответствует/ не соответствует
103.	ГОСТ Р 52557	Подгузники детские бумажные	17.22.12	9619 00	Классификация Технические требования:	Соответствует/ не соответствует

					- конструкция - техническое исполнение - декоративное исполнение - внешний вид - полное влагопоглощение - обратная сорбция - время впитывания - Маркировка - Упаковка - Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует В виде раскроя трусов с застёжками - "липучками" или в виде готовых трусов Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 120 – 280 г Не более 0,4 – 16 г Не более 3 с Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
104.	ГОСТ Р 55082	Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых	17.22.12	9619 00	- Классификация - Технические требования: - конструкция - техническое исполнение - декоративное исполнение - внешний вид - полное влагопоглощение - сорбиционная способность после центрифугирования - обратная сорбция - скорость впитывания - Маркировка - Упаковка - Транспортирование и хранение - Абсорбиционная способность	Соответствует/не соответствует В виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами, или прокладок-вкладышей Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 1000 – 2800 г Не менее 120 – 560 г Не более 4,4 г Не менее 2,3 см³/с Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
105.	ГОСТ Р 55370	Подгузники бумажные для взрослых	17.22.12	9619 00		
106.	ГОСТ Р 52483	Прокладки (пакеты) женские гигиенические	13.99.19 17.22.12	9619 00	- Классификация - Технические требования: - конструкция - техническое исполнение - декоративное исполнение - внешний вид - полное влагопоглощение - время впитывания - промокаемость верхнего покровного слоя	- Соответствует/не соответствует Не менее 4,0 – 70,0 г Не более 6,0 – 7,0 с Не более 9 капель

107.	ГОСТ 31620	Материалы хирургические шовные	21.20.24	3006 10	- pH водной вытяжки Классификация Требования к хирургическим шовным материалам: - стерилизация - метрические размеры - диаметр - разрывная нагрузка в простом узле шовных материалов - длина шовных материалов	6,0 – 7,5 - Соответствует/не соответствует 0,01 – 12 0,001 – 1,299 мм Не менее 0,01 – 220 Н Фактическая длина шовного материала должна быть не менее 98% номинальной длины, установленной в нормативных документах на шовный материал конкретного вида Не менее 0,07 – 75,0 Н
108.	ГОСТ 396	Нитки хирургические шелковые крученые нестерильные	13.10.40	5004 00 5006 00	- усилие отрыва шовного материала от иглы Условный номер нитки Длина нитки в бестарной бабине Масса конической бабины Результатирующая линейная плотность нитки Коэффициент вариации линейной плотности Разрывная нагрузка нитки Разрывное удлинение Разрывная нагрузка при испытании в узле Разрывное удлинение при испытании нитки в узле Отклонение от номинальной крутки Коэффициент вариации крутки Нормированная влажность хирургических ниток Количество узлов Упаковка, маркировка	Не менее 0,07 – 75,0 Н 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 45 – 1020 м 100 – 450 г Не более 12,0 – 350 текс Не более 3,0 – 7,0 % Не менее 0,36 – 10,10 (0,37 – 10,30) даН (кгс) 15 – 30 % Не менее 0,15 – 5,78 (0,15 – 5,90) даН (кгс) 5 – 20 % ± (20 – 60) кр./м Не более 3,2 – 5,0 % Соответствует/не соответствует В конической бабине не более 10 в бестарной бабине не более 4 Соответствует/не соответствует

					Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
109.	ГОСТ Р 53498	Средства перевязочные пластырного типа	21.20.24	3005 10	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Линейные размеры	Соответствует
					Отклонение от размеров, указанных на этикетке не более 10%	Соответствует
					Сопротивление отслаиванию липкого слоя	Не менее 25 Н/м не более 200 Н/м
					Сорбционная емкость функциональной подушечки	Не менее 1 капли/см ²
					Время смачивания функциональной подушечки	Не более 5 – 10 с
					Паропроницаемость фиксирующего слоя	Не менее 1,5 мм/см ² /ч
					Содержание лекарственных препаратов в функциональной подушечке или клеевой композиции	Соответствует/не соответствует
					Водоупорность фиксирующего слоя	Не менее 300 мм.вод.ст.
					Степень адгезии к модели раневой поверхности	Не более 30 % к марле медицинской
					Стерильность	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует
110.	ГОСТ 938.17	Кожа	15.11.4	4105 30	Паропроницаемость	Соответствует/не соответствует
111.	ГОСТ 3816	Плотная текстильные	13.20 13.99.19	5208 11	Влажность	0 – 50%
					Гигроскопичность	0 – 50%
					Влагоотдача	0 – 50 %
112.	ГОСТ 1172	Бинты марлевые медицинские	21.20.24	3005 90 3006 10	Длина	1,9 – 10,4 м
					Ширина	4,5 – 17,0 см
					Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50x200 мм	Не менее 59 - 88 Н
					Толщина	Не более 15 – 40 мм
					Характеристики	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует
113.	ГОСТ 9412	Марля медицинская	13.20.44 21.20.24	3005 90	Ширина	(72 – 90) ± 1,5 см. Допускается выработать марлю шириной более 90 см

114.	ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10		Длина марли в куске	Не менее 100 – 200. Допускается длина отбеленной марли в куске не менее 20 м
						Длина марли в рулоне	800 – 8000 м
						Разрывная нагрузка:	
						- по основе	78,0 – 83,0 (8,0 – 8,5) Н (кгс)
						- по утку	34,0 – 44,0 (3,5 – 4,5) Н (кгс)
						- поверхностная плотность	Не менее 36 – 39 г/м ²
						Физико-химические показатели	Соответствует/не соответствует
						- смачиваемость	Не более 6 – 10 с
						- капиллярность	Н менее 10 см/ч
						- влажность	5 – 8,5 %
115.	ГОСТ 16427	Салфетки и отрез марлевые медицинские	21.20.24	3006 10		- зольность	Не более 0,3%
						- белизна	Не менее 80%
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует
						Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
						Плотность нитей	Соответствует/не соответствует
						Плотность пучков ворса	Соответствует
						Длина:	
						- салфетки	15 – 71,5 см
						- отрез	1000 ± 10 см
						Ширина:	
						- салфетки	7 – 69,5 см
						- отрез	(84 – 90) ± 1,5 см
						- количество изделий в комплекте	3 – 200 шт
						- характеристики	Соответствует/не соответствует
						- упаковка	Соответствует/не соответствует
						Размеры упакованных изделий:	
						- длина	7,5 – 32,0 см
						- ширина	4,5 – 23,0 см
						- толщина	3,0 – 12,0 см
						Маркировка	Соответствует/не соответствует

					Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
116.	ГОСТ 3813	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Размеры элементарной пробы:	Соответствует/не соответствует
					- ширина	30 – 60 мм
					- длина	200 – 350 мм
					- рабочая ширина	25 – 50 мм
					- рабочая зажимная длина	50 – 200 мм
117.	ГОСТ 22380	Повязки фиксирующие контурные	21.20.24	3005 10 3005 90	Предварительное напряжение	(0,98 – 49,00) Н ((0,10 – 5,00) кгс)
					Разрывная нагрузка	Соответствует/не соответствует
					Удлинение при разрыве	Соответствует/не соответствует
					Раздирающая нагрузка	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- общая длина L	(1350 – 1650)±40 мм
					- длина нижней части повязки l ₁	(350 – 650)±20 мм
					- длина верхней части повязки l ₂	(250 – 500)±20 мм
					- общая высота H	(550 – 800)±20 мм
118.	ГОСТ 18054	Материалы текстильные	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	- высота между двумя верхними тесемками h ₁	(250 – 325)±10 мм
					- высота между двумя нижними тесемками h ₂	300±10 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Белизна	Соответствует/не соответствует
119.	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая	13.99.19	3005 90 5601 21	Технические требования:	
					- массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков	Не более 1,5 – 5,0 %
					- массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли	Не более 0,10 – 0,20 %
					- засоренность	Не более 0,10 – 0,70 %
					- отсутствие посторонних примесей: иголок, щепочек и др.	Соответствует/не соответствует

						- зольность Физико-механические показатели: - влажность - поглотительная способность - капиллярность - степень белизны - отсутствие запаха	Не более 0,20 – 0,40 % Соответствует/не соответствует Не более 8,0 – 9,2 % Не менее 19 – 21 % Не менее 67 – 77 мм Не менее 51 – 76 % Соответствует/не соответствует
120.	ГОСТ 1207	Повязки медицинские стерильные		21.20.24	3005 10 3005 90	- Ватно-марлевая подушечка: - длина - ширина Марлевый бинт: - длина - ширина Марлевые тесемки: - длина - ширина - масса ваты - конструкция Размеры повязки: - длина - ширина - толщина Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Внешний вид Условная вязкость Массовая доля сухого остатка Сопротивление расслаиванию Маркировка Упаковка Требования безопасности и охраны окружающей среды	(56,0 – 65,0) ±2,0 см 28,0 – 44,5 см 7,0 ±0,3 м 14,0 ±1,0 см 70,0 ±2,0 см 10,0 ±0,5 см 33,0 – 119,0 г Соответствует/не соответствует (16,0 – 18,0) ±0,5 см (7,0 – 9,0) ±0,5 см (4,5 – 5,0) ±0,5 см Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 55 с 15,0 – 19,0 % Не менее 900 Н/м Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
121.	ГОСТ 12172	Клеи фенолополивинилацетальные		21.20.24	3005 10 3005 90 3006 10	Классификация Растяжимость Рабочая растяжимость Поверхностная плотность	В соответствии с нормативно- технической документацией Не менее 30% - не более 1000% Не менее 30% - не более 900% Не менее 40 – 550 г/м²
122.	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные		21.20.24 32.50.22 14.31.10	3005 90 3006 10 6115 10		

123.	ГОСТ Р 58236	Изделия медицинские эластичные компрессионные	21.20.24 32.50.22 14.31.10	3005 90 3006 10 6115 10	Разрывная нагрузка	Не менее 49,0 – 294,0 (5 – 30) Н (кгс)
						Соответствует/не соответствует
					Класс компрессии	В соответствии с нормативно- технической документацией
					Назначение	Соответствует/не соответствует
					Классификация	В соответствии с нормативно- технической документацией
					Растяжимость	Не менее 30% - не более 1000%
124.	ГОСТ 1179	Пакеты перевязочные медицинские	21.20.24	3005 90	Рабочая растяжимость	Не менее 30% - не более 900%
					Поверхностная плотность	Не менее 40 – 550 г/м ²
					Разрывная нагрузка	Не менее 49,0 – 294,0 (5 – 30) Н (кгс)
					Идентификация: характеристики	-
					Масса ваты в каждой подушечке	(4 – 10) ±1,5 г
					Длина подушечки	12,0 – 33,5 см
					Ширина подушечки	10,0 – 18,5 см
					Длина марлевого бинта	4,0 – 7,3 м
					Ширина марлевого бинта	6,5 – 10,5 см
					Длина пакета в наружной оболочке	(10,0 – 10,4) ±0,5 см
					Ширина пакета в наружной оболочке	(5,0 – 6,5) ±0,5 см
					Толщина пакета в наружной оболочке	(2,0 – 4,0) ±0,5 см
125.	ГОСТ 22379	Изделия ватно-марлевые медицинские	21.20.24 13.99.19 13.20.44 32.50.22 32.50.13 14.31.10	3005 10 3005 90 5601 21 5601 21 5601 22 5601 22	Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Технические требования:	
					Длина подушечки	6,5 – 33,0 см
					Длина ленты	200,0 ±5,0 см
					Ширина подушечки	6,5 – 30,0 см
					Ширина ленты	29,0 ±2,0 см
					Масса ваты в подушечке	0,75 – 39,0 г
					Масса ваты в ленте	232,0 ±20,0 г
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Характеристики	-
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Поверхностная плотность гипсовых бинтов	300 – 700 г/м ²
					Осыпаемость гипсовой композиции	0 – 10%
126.	ГОСТ 31626	Бинты гипсовые медицинские	21.20.24	3005 90	Поверхностная плотность гипсовых бинтов	300 – 700 г/м ²
					Осыпаемость гипсовой композиции	0 – 10%

				Время смачивания гипсовых бинтов	0 – 20 с	
				Уровень вымывания гипсовой композиции	0 – 10%	
				Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки	2 – 10 мм	
				Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии	0 – 2 мм	
				Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии	Не менее 9,8 (1,0) – 13,7 (1,4) Н (кгс)	
				Линейные размеры:		
				- длина	3,0 ±0,20 м	
				- ширина	48 – 210 мм	
				Длина	2,38 – 3,6 м	
				Ширина	48 – 125 мм	
				Растяжимость	50% – 170%	
				- разрывная нагрузка полоски размером 50×50 или 50×200	Не менее 15 – 20 кгс	
				- удлинение при разрыве по основе полоски размером 50×50	Не менее 60% – 200%	
				- число нитей основы по всей ширине	25 – 182	
				- число нитей утка на 10 мм	9 – 24	
				- линейная плотность (толщина) нитей основы	0,3 мм / (18,5×2 – 25×2) текс	
				- линейная плотность (толщина) нитей утка	(18,5×2×2 – 36×2) текс	
				- линейная плотность	10 – 65 г/м	
				Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует	
				Информация, предоставляемая изготовителем или обработчиком	Соответствует/не соответствует	
127.	ГОСТ 16977	Бинт эластичный медицинский	21.20.24	3005 90 3006 10		
128.	ГОСТ EN 13795-1	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования	14.12.30 14.12.11 14.12.30 14.12.12 26.60.11 21.20.24 21.20.10	6210 10 6211 32 6211 33 6211 42 6211 43		

на 408 листах, лист 48

			32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 14.31.10						
129.	ГОСТ EN 13795-2	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования	14.12.11 14.12.12 14.12.30 26.60.11 21.20.24 21.20.10 32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 14.31.10	6210 10 6211 32 6211 33 6211 42 6211 43	Чистота в части инородных частиц Пылевосоотделение Водоупорность Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии Прочность на растяжение в сухом и влажном состоянии Впитываемость	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует			
130.	ГОСТ 23134	Уборы головные медицинские	14.19.42	6505 00 6506 10	Типы Основные размеры Технические требования: - идентификация: материалы - внешний вид Маркировка, упаковка	5,0 – 132 мм - Соответствует/не соответствует			
131.	ГОСТ 24760	Халаты медицинские женские	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа Ширина спинки в самом узком месте Длина от угла плечевого шва и горловины до низа Ширина между швами втачивания рукавов в самом узком месте Ширина халата на уровне глубины проймы Ширина халата внизу Длина рукава от высшей точки отката до низа Ширина рукава под проймой Идентификация: материалы	(101,0 – 117,0) ±1,0 см (22,0 – 45,6) ±0,1 см (106,5 – 124,5) ±1,0 см (21,4 – 44,5) ±0,5 см (55,0 – 69,0) ±1,0 см (69,0 – 81,4) ±1,0 см (53,6 – 64,4) ±1,0 см (17,5 – 22,2) ±0,5 см -			

на 408 листах, лист 49

						Внешний вид	Соответствует/не соответствует
						Маркировка, упаковка	соответствует
132.	ГОСТ 25194	Халаты медицинские мужские	14.12.30		6211 32 6211 33 6211 39	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	(99,0 – 120,0) ±1,0 см
						Ширина спинки в самом узком месте	(24,5 – 50,0) ±0,5 см
						Длина от угла плечевого шва и горловины до низа	(99,0 – 118,0) ±1,0 см
						Ширина между швами втачивания рукавов в самом узком месте	(22,7 – 49,4) ±0,5 см
						Ширина халата на уровне глубины проймы	(59,0 – 73,0) ±1,0 см
						Ширина халата внизу	(62,0 – 78,0) ±1,0 см
						Длина рукава от высшей точки оката до низа	(60,4 – 72,2) ±1,0 см
						Ширина рукава под проймой	(19,0 – 24,5) ±0,5 см
						Идентификация: материалы	-
						Внешний вид	Соответствует/не соответствует
						Маркировка, упаковка	-
133.	ГОСТ Р 54408	Одежда специальная для инвалидов	14.12.30		6211 32 6211 33 6211 39	Идентификация: характеристики, материалы	-
						Размеры	Соответствует/не соответствует
						Технические требования	Соответствует/не соответствует
						Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
						Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
134.	ГОСТ Р ИСО 6942	Одежда для защиты от тепла и огня	14.12.30 32.99.11		6211 42	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
						Плотность пропущенного теплового потока	Соответствует/не соответствует
135.	ГОСТ EN 13795-3	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования	14.12.11 14.12.30 14.12.12 26.60.11 21.20.24		6210 10 6211 32 6211 33 6211 42 6211 43	Водоупорность	Не менее 10 – 100 см H ₂ O
						Прочность на разрыв в сухом состоянии	Не менее 40 кПа
						Прочность на разрыв во влажном состоянии	Не менее 40 кПа

			21.20.10 32.50.22 21.20.23 32.50.13 21.20.23 17.22.1 32.50.22 21.20.24 14.31.10			Прочность на растяжение в сухом состоянии Прочность на растяжение во влажном состоянии	Не менее 15 – 20 Н Не менее 15 – 20 Н
136.	ГОСТ Р 52538	Одежда технологическая	14.12.30	6211 32 6211 33 6211 39		Классификация Барьерные свойства, удержание частиц с размерами $\geq 0,3$ мкм Воздухопроницаемость Паропроницаемость Удельное поверхностное электрическое сопротивление Усадка при обработке (по основе и утку) Сохранение технологических свойств	- 98% до первой обработки, 97% после 50 обработок 0 – 30 см ³ /(см ² ·с) 0 – 60 г/(м ² ·ч) 10 ³ – 10 ⁸ Ом Не более 5% Не менее 50 циклов обработки
137.	ГОСТ 8541	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96		Идентификация: виды, размеры, характеристики, материалы Технические требования Линейные размеры Маркировка и упаковка	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует
138.	ГОСТ 11595	Изделия чулочно-носочные	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96 6115 99		Устойчивость к истиранию, количество оборотов прибора: - первая группа устойчивости к истиранию - вторая группа устойчивости к истиранию - третья группа устойчивости к истиранию - четвертая группа устойчивости к истиранию	401 и более 201 – 400 101 – 200 50 – 100
139.	ГОСТ 16825	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах	14.31.10	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29		Технические требования Внешний вид	Соответствует/не соответствует Соответствует Соответствует/не соответствует

				6115 30 6115 94 6115 95 6115 96	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
140.	ГОСТ 26559	Изделия чулочно-носочные	14.31.10 21.20.24	6115 10 6115 21 6115 22 6115 29 6115 30 6115 94 6115 95 6115 96	Устойчивость к мокрой обработке	Устойчивы/не устойчивы
141.	ГОСТ 15902.2	Плотная нетканые	21.20.24 13.99.19 26.60.11 32.50.22 32.50.13 14.31.10 13.20.44	3005 10 3005 90 5601 21 5601 22	Внешний вид	Соответствует/не соответствует
142.	ГОСТ 3811	Материалы текстильные. Ткани, нетканые плотные и штучные изделия	13.20 13.20.20 13.99.19 21.20.24	5208 11 5208 21 3006 10	Длина Ширина Линейная плотность Поверхностная плотность	Соответствует/не соответствует
143.	ГОСТ 5982	Целлюлоза сульфитная вискозная	21.20.24 13.20.31 17.11.13 17.11.14	5601 22 5601 29	Динамическая вязкость Влажность Упаковка, маркировка	20 – 26,5 (200 – 265) мПа·с (мПа) (6 – 10) % Соответствует/не соответствует
144.	ГОСТ 10546	Волокно вискозное	17.12.20 17.22.12	5601 22 5601 29 5604 90 5408 10	Номинальная линейная плотность Номинальная длина нарезанного волокна Удельная разрывная нагрузка Удлинение при разрыве Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной Отклонение фактической длины от номинальной Массовая доля волокна Степень извитости Массовая доля замасливателя Белизна отбеленного волокна	0,13; 0,15; 0,17; 0,22; 0,31; 0,44; 0,56 текс 34, 36, 38, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 120 мм Не менее (162 – 216) мН/текс (19,0 – 26,0)% В пределах ±10% В пределах ±6,0% Не более (0,4 – 3,6) % Не менее (9,0 – 13,0) % (0,2 – 0,4)% Не менее 70%

145.	ГОСТ 31071	Материалы стоматологические для пломбирования корневых каналов зубов	20.59.52	3006 40 3407 00		Безопасность	Соответствует/не соответствует
						Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует
146.	ГОСТ 31570	Заготовки из сплавов на основе никеля для ортопедической стоматологии	32.50.50	7502 20 9018 49		Идентификация: классификация	-
						Текучесть	Получение диска диаметром не менее 20 мм
						Рабочее время	Не менее 30 мин
						Время твердения	В пределах $\pm 10\%$ времени твердения, указанного в инструкции изготовителя
						Толщина пленки	0 – 50 мкм
						Рентгеноконтрастность	Непрозрачность материалов для излучения должна быть эквивалентна слою алюминия толщиной не менее 3 мм
						Растворимость	Не более 3% массы материалов
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Маркировка	Соответствует
						Твердость HV ₁₀	Не менее 150 Н/мм ²
147.	ГОСТ 31571	Керамика стоматологическая	32.50.50	7502 20 9018 49		Предел текучести $\sigma_{0.2}$	Не менее 250 Н/мм ²
						Относительное удлинение δ	Не менее 3%
						Отклонение показателя плотности	Не более 2%
						Литейные свойства сплавов	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Сопrotивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе	0
						Пористость, число пор	Не более 16 диаметром более 30 мкм на поверхности 1 мм
						Коэффициент термического расширения (температурный коэффициент линейного расширения)	Соответствует/не соответствует
						Прочность при изгибе	≥ 50 МПа
						Технологичность	Соответствует/не соответствует
						Линейная усадка при обжиге	$\leq 16\%$

148.	ГОСТ 31572	Материалы полимерные для базисов зубных протезов	20.59.52	3407 00	Химическая растворимость Идентификация: классификация Неотвержденный материал: - компоненты базисного материала Отвержденный материал: - поверхностные свойства - цвет - цветостойкость - полупрозрачность - отсутствие пористости - прочность при изгибе - модуль упругости - показатель трещиностойкости - соединение с искусственными пластмассовыми зубами - водопоглощение - растворимость Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе Пористость, число пор Коэффициент термического расширения (температурный	≤ 0,5% - Компонент базисного материала в виде жидкости при Соответствует/не соответствует оценке не должен содержать геля или осадка. Жидкость не должна загустевать в течение всего срока хранения, гарантированного изготовителем Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 60 МПа / Не менее 65 МПа Не менее 1500 МПа / Не менее 2000 МПа Менее 1,0 МН/м ^{1,5} Соответствует/не соответствует Не более 32 мкг/мм ³ Не более 8,0 мкг/мм ³ / Не более 1,6 мкг/мм ³ 0 Не более 16 диаметром более 30 мкм на поверхности 1 мм Соответствует/не соответствует
149.	ГОСТ 31575	Металлокерамика стоматологическая для зубного протезирования	20.59.52	3407 00 7502 20 9018 49	Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе Пористость, число пор Коэффициент термического расширения (температурный	Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе Пористость, число пор Коэффициент термического расширения (температурный

				коэффициент линейного расширения)	≥ 50 МПа	на 408 листах, лист 54
				Прочность при изгибе	Соответствует/не соответствует	
				Технологичность	≤ 16%	
				Линейная усадка при обжиге	≤ 0,5%	
				Химическая растворимость	± 0,5 г/см³	
				Плотность	± 25 °С	
				Температурный интервал плавления	Не менее 250 МПа	
				Предел текучести	Не менее 3%	
				Относительное удлинение	Не менее 25 МПа	
				Прочность связи керамики со сплавом	-	
				Идентификация: классификация	Соответствует/не соответствует	
				Цвет компонентов	Соответствует/не соответствует	
				Время смешивания (вручную, шпателем или разминанием)	Соответствует/не соответствует	
				Рабочее время	Соответствует	
				Совместимость с гипсом	Не менее 50 МПа	
				Прочность при изгибе	Не более прочности при изгибе, МПа	
				Величина N, характеризующая упругость при изгибе		
				Диаметральная прочность или прочность при диаметрально разрыве:		
				- композитные материалы	Не менее 34 МПа	
				- материалы, содержащие менее 50% (по массе) наполнителя	Не менее 25 МПа	
				- водопоглощение	Не более 32 мкг/мм³ / Не более 50 мкг/мм³	
				- водорастворимость	Не более 5 мкг/мм³	
				- рабочее время	Не менее 1,5 – 2 мин	
				- время отверждения	Не более 5 мин	
				- чувствительность к окружающему освещению	60 с	
				- глубина отверждения	Не менее 2 мм	
				- полное отклонение цветовых характеристик в координатах цвета CIELAB	2,5	
				- коэффициент прозрачности	10 – 60 %	

						- адгезионная прочность в соединении с твердыми тканями зуба	Не менее 7 МПа
						- адгезионная прочность в соединении с металлом для каркаса несъемного зубного протеза	Не менее 5 МПа
152.	ГОСТ ISO 7491			20.59.52	3407 00 3006 40	Цветостойкость	Соответствует/не соответствует
153.	ГОСТ Р 54966			20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	-
						Время эластичного восстановления после деформации	Тип А: ≤ 5 мин / Тип В: > 5 мин
						Глубина пенетрации	Класс 1: ≥ 1,5 мм / Класс 2 < 1,5 мм
						Маркировка, упаковка и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
154.	ГОСТ Р 55745			20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация	-
						Рабочее время для материалов класса 1	Не менее 40 с
						Время отверждения для материалов класса 1	Не более 5 мин
						Глубина отверждения для материалов класса 2	Не менее 1,5 мм
						Прочность адгезионного соединения с эмалью зуба для материалов 1 и 2 классов	Не менее 7 МПа
						Маркировка, упаковка и инструкции изготовителя по применению	Соответствует/не соответствует
155.	ГОСТ ISO 1563			20.59.52	3407 00	Внешний вид порошка	Соответствует/не соответствует
						Внешний вид смешанного материала	Соответствует/не соответствует
						Время смешивания	Не более 60 с
						Совместимость с гипсом и точность воспроизведения	Соответствует/не соответствует
						Восстановление после деформации	Не менее 95 %
						Деформация сжатия	Не менее 5 % и не более 20 %
						Прочность при сжатии	Не менее 0,35 МПа
						Упаковка, маркировка и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует

156.	ГОСТ 31566	Воск зуботехнический базисный	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация Внешний вид Цвет Внешний вид после нагревания над пламенем Пластичность Остаток воска Окрашивающие компоненты Текучесть Температура плавления Адгезия в условиях хранения	- Соответствует/не соответствует Соответствие при 40 °С, при сгибании на 180° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0,2 % - 90 % 57,0 ± 5,0 °С Пластины воска не должны слипаться друг с другом или с разделительной бумагой
						-
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
157.	ГОСТ 31567	Воск зуботехнический моделировочный	20.59.52	3407 00	Идентификация: классификация Внешний вид Цвет Размягчение Обрезка Текучесть	- Соответствует/не соответствует Соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 1 % - 90 %
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
158.	ГОСТ 31577	Протезы зубные металлические с защитными покрытиями	32.50.22	9021 21	Основные параметры Требования к основе протезов: Ширина швов паяных соединений Толщина сварных швов Шероховатость наружной поверхности основного металла протезов Ra Толщина стенок коронок Требования к покрытиям: Общая толщина покрытия Разность электрических потенциалов между протезами с покрытиями Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует Не более 0,5 мм Не более 1 мм ≤ 0,2 мкм Не менее 0,15 мм От 2 до 5 мкм Не более 400 мВ Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
159.	ГОСТ ISO 1562		32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация	-

160.	ГОСТ ISO 8891	Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 2,5 % до 75 %	32.50.22	7502 20 9021 21	Механические свойства: Минимальный предел текучести при остаточной деформации $\sigma_{0,2}$ Минимальное относительное удлинение при разрыве Отклонение плотности Электрохимия Информация и инструкции Маркировка	80 – 360 МПа 3 % – 18 % Не более 0,5 г/см³ указанных значений Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует -
						Не менее 80 – 450 МПа 3 % – 18 % Не более 0,5 г/см³ указанных значений
						Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
161.	ГОСТ 6835	Золото и сплавы на его основе	32.50.22	7502 20 9021 21	Идентификация: марки Технические требования	- Соответствует/не соответствует
162.	ГОСТ ISO 9333	Стоматология. Припои твердые	32.50.22	9021 29	Коррозионная стойкость Механическая прочность твердоспаянного соединения (прочность на растяжение) Информация и инструкции Маркировка и этикетка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
163.	ГОСТ Р ИСО 22674	Стоматология. Металлические материалы для несъемных и съемных протезов и конструкций	32.50.22	9021 21	Идентификация: классификация Механические свойства: Предел текучести	- Не менее 80 – 500 МПа

164.	ГОСТ 31627	Заготовки из коррозионно-стойких сплавов на основе кобальта для ортопедической стоматологии	32.50.22	9021 21	Относительное удлинение	Не менее 2% - 18 %
					Модуль Юнга	Не менее 150 ГПа
					Отклонение плотности	Не более 0,5 г/см ³ указанных значений
					Коррозионная стойкость материала	Соответствует/не соответствует
					Температурный коэффициент линейного расширения	Соответствие более чем на 0,5 · 10 ⁶ К ⁻¹
					Информация, инструкции и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация:	-
					классификация, комплектность	-
					Масса	5 – 30 г с предельным отклонением по массе ±10 %
					Максимальный линейный размер	Не более 20 мм
165.	ГОСТ 31569	Заготовки из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей для литых протезов ортопедической стоматологии	32.50.22	9021 21	Твердость	260 – 450 HV ₁₀
					Механические свойства:	-
					- предел текучести	Не менее 500 Н/мм ²
					- относительное удлинение	Не менее 3 %
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация:	-
					классификация, комплектность	-
					Масса	10 – 30 г с предельным отклонением по массе ±10 %
					Максимальный линейный размер	Не более 20 мм
166.	ГОСТ ISO 22112	Заготовки из коррозионно-стойких сплавов на основе кобальта для ортопедической стоматологии	32.50.22	9021 21	Твердость	Не менее 160 HV ₁₀
					Механические свойства:	-
					- предел текучести	Не менее 250 Н/мм ²
					- относительное удлинение	Не менее 15 %
					- упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация:	-
					классификация, комплектность	-
					Масса	10 – 30 г с предельным отклонением по массе ±10 %
					Максимальный линейный размер	Не более 20 мм

168.	ГОСТ Р ИСО 10139-2	Стоматология. Материалы для эластичных подкладок к съемным зубным протезам. Материалы для постоянных подкладок	32.50.22	3006 10 3006 40 3006 70 9021 21		Число пор на поверхности 1 мм ²	30 – 40 мкм – не более 16 40 – 150 мкм – не более 6 150 мкм – не допустимы
						Термостойкость	Отсутствие/наличие трещин
						Проницаемость отверстий для крепления зубов	Соответствует/не соответствует
						Химическая растворимость	≤ 0,5 %
						Предельные размеры:	
						- медиально-дистальный	5,0 – 14,5 мм
						- от режущего края цементноэмалевой границы	6,3 – 16,4 мм
						- от вестибулярной поверхности до оральной	4,8 – 10,7 мм
						- от жевательных бугров до цементноэмалевой границы	5,2 – 11,1 мм
						От щечной поверхности до язычной	6,2 – 14,3 мм
169.	ГОСТ 31568	Гипсы стоматологические	20.59.52	3407 00		Идентификация: классификация	-
						Твердость по Шору А через 24 ч	Тип А: 25 < ед. Шора А ≤ 50 Тип В: ед. Шора А ≤ 25
						Твердость по Шору А через 28 сут	Тип А: ≤ 55 Тип В: ≤ 35
						Прочность соединения	Тип А: не менее 0,1 МПа Тип В: не менее 0,5 МПа
						Водопоглощение	Не более 20 мкг/мм ³
						Водорастворимость	Не более 3 мкг/мм ³
						Требования к упаковке, маркировке и инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
						Идентификация: классификация	-
						Текучесть во время заливки	Тип 1: ≥ 70 мм
						Время схватывания и затвердевания	Тип 1: 2,5 – 5,0 мин Время схватывания не менее 3 мин Время затвердевания не более 30 мин
						Линейное расширение при затвердевании	0,15 % – 0,3 %
						Излом	Соответствует/не соответствует
						Предел прочности при сжатии	4 – 35 МПа

					Воспроизведение деталей	Соответствует/не соответствует	
						Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
170.	ГОСТ ISO 9694	Материал стоматологический формовочный на фосфатном связующем	20.59.52	3006 10 3006 40 3407 00	Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
					Герметичность тары	Герметична/ не герметична	Герметична/ не герметична
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация	-	-
					Текущая во время заливки	Диаметр основания затвердевшего формованного материала типа 1 должен быть не менее 90 мм, типа 2 – не менее 70 мм	Диаметр основания затвердевшего формованного материала типа 1 должен быть не менее 90 мм, типа 2 – не менее 70 мм
					Время схватывания и затвердевания	Тип 1 и 2: время схватывания не ранее чем через 3 – 5 мин, а затвердевания не позднее чем через 30 мин	Тип 1 и 2: время схватывания не ранее чем через 3 – 5 мин, а затвердевания не позднее чем через 30 мин
					Линейное расширение при твердении	Не более чем на 30 %	Не более чем на 30 %
					Линейное расширение при нагревании	Не более чем на 15 %	Не более чем на 15 %
					Предел прочности при сжатии	Не менее 2,5 – 3,0 МПа	Не менее 2,5 – 3,0 МПа
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
					Герметичность тары	Герметична/ не герметична	Герметична/ не герметична
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
171.	ГОСТ ISO 7490	Материал формовочный стоматологический на гипсовом связующем	20.59.52	3006 10 3006 40 3006 70 3407 00	Идентификация: классификация	-	-
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Текущая во время заливки	Диаметр основания затвердевшего формованного материала типа 1 должен быть не менее 60 мм, типа 2 – не менее 40 мм	Диаметр основания затвердевшего формованного материала типа 1 должен быть не менее 60 мм, типа 2 – не менее 40 мм
					Время схватывания и затвердевания	Не более 20 %	Не более 20 %

					Линейное расширение при твердении	Не более 20 %
					Линейное расширение при нагревании	Не более 20 %
					Предел прочности при сжатии	Тип 1: не менее 2,3 МПа Тип 2: не менее 2,6 МПа
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация	-
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Текучесть	Диаметр распыла не более 100 мм
					Время твердения	Не более 30% значения, указанного изготовителем
					Предел прочности при сжатии	2,0 – 100 МПа
					Линейное термическое расширение	Не более 15 % значения, указанного изготовителем
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	Соответствует/ не соответствует
					Идентификация: классификация	-
					Материал	Соответствует/ не соответствует
					Компоненты	Соответствует/ не соответствует
					Время твердения	4 – 10 мин
					Прочность при сжатии через 24 ч	5 – 35 МПа
					Дезинтеграция через 24 ч	Не более 1,5 % - 2,5 %
					Толщина пленки	Не более 25 мкм
					Упаковка и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Жидкий компонент:	
172.	ГОСТ ISO 11244	Смесь огнеупорная стоматологическая для пайки твердым припоём	32.50.22	9021 29		
173.	ГОСТ Р ИСО 10271	Стоматология. Металлические материалы	32.50.22	9021 21		
174.	ГОСТ 31609	Материалы стоматологические цементные на основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола	32.50.22	3006 40 9021 21		
175.	ГОСТ ISO 5833		32.50.22	3006 40		

176.	ГОСТ 31578	Цементы стоматологические на водной основе	32.50.22	3006 40	9021 21	Имплантаты для хирургии. Акрилцементы	- внешний вид - стабильность - погрешность определения Порошковый компонент: - внешний вид - погрешность определения содержимого Жидкостно-порошковые смеси: - время перемешивания - время отвердевания - максимальная температура - средняя сила сжатия - изгибающий момент (модуль изгиба) - сила изгиба - интрузия - упаковка - маркировка	Соответствует/не соответствует Время текучести жидкого компонента не должно увеличиваться более чем на 10 %. Не более $\pm 0,1$ мл Соответствует/не соответствует Не более $\pm 0,1$ г ≤ 5 с 3 – 15 с 90 ± 5 °C ≥ 70 МПа ≥ 1800 МПа ≥ 50 МПа Не менее 2 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Цементы стоматологические на водной основе	Идентификация: классификация Материалы Компоненты Консистенция неотвержденного цемента Чувствительность к окружающему освещению (только для светоотверждаемых цемента) Начальное время твердения для светоотверждаемых цемента Время твердения Глубина отверждения Рентгеноконтрастность	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 60 мин Не менее 1 мм Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует

					Цвет и цветостойкость	Соответствует/не соответствует	
						Эксплуатационные (функциональные) требования:	Соответствует/не соответствует
177.	ГОСТ Р ИСО 14356	Материалы дубликационные	32.50.50 20.59.52	3407 00	- максимальная толщина пленки	25 мкм	
					- чистое время твердения	2 – 8 мин	
					- максимальная прочность при сжатии	70 – 1700 МПа	
					- непрозрачность	0,32 – 0,90	
					- минимальная прочность при изгибе	10 – 20 МПа	
					Упругое восстановление	Не менее 96,50%	
178.	ГОСТ Р 56924 (ИСО 4049)	Материалы полимерные восстановительные	32.50.50 20.59.52	3407 00 3006 40	Сопротивление раздиру	0,3–1,0 Н/мм	
					Упаковка	Соответствует/не соответствует	
					Этикетка	Соответствует/не соответствует	
					Инструкция по применению	Соответствует/не соответствует	
					Толщина пленки материалов для фиксации	Не более 50 мкм	
					Прочность при изгибе	50 – 100 МПа	
179.	ГОСТ Р 57620 (ИСО 15912)	Материал формовочный огнеупорный и материал для моделей	20.59.52 32.50.50 23.91.11 32.50.11 32.50.13	3407 00 3006 91 2513 20 9018 41 9018 49	Цвет восстановительных материалов	Соответствует/не соответствует	
					Цветостойкость после облучения и водопоглащения	Соответствует/не соответствует	
					Рентгеноконтрастность	Соответствует/не соответствует	
					Идентификация консистенция материал и отсутствие загрязнений	-	
					Текучесть	Не более 30%	
					Время схватывания и затвердевания	Не более 30%	
180.	ГОСТ Р 50349	Стоматологические вращающиеся инструменты	23.91.11	2513 20	Прочность при сжатии	Не менее 2 МПа	
					Линейное расширение при твердении	До 15% значений	
					Линейное термическое изменение размеров	Не более 20% значений	
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	
					Упаковка	Соответствует/не соответствует	
					Номинальный диаметр	0,5 – 30 мм	
181.	ГОСТ 26634	Инструменты стоматологические вращающиеся. Хвостовики	23.91.11 32.50.13	9018 49 2513 20	Обозначение	Соответствует/не соответствует	
					Классификация	Соответствует/не соответствует	

182.	ГОСТ Р ИСО 7786	Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты лабораторные абразивные	23.91.11 32.50.11	2513 20 9018 49		Идентификация: материал	-
						Условные обозначения	Соответствует/не соответствует
						Размеры:	
						- диаметр	1,6 мм / 2,35 мм
						- длина хвостовика l ₁	9 – 30 мм
						Шероховатость поверхности	0,5 мкм / 1 мкм
						Твердость	Не менее 250 HV5
						Идентификация: материалы, формы	-
						Размеры:	
						- диаметр рабочей части, диаметр головки d	- 10, 5 мм
183.	ГОСТ Р ИСО 6360-1	Стоматология. Система цифрового кодирования вращающихся инструментов	32.50.11	9018 49		- длина рабочей части l ₁	1,95 – 11,5 мм
						- общая длина l ₂	39 – 56 мм
						- угол рабочей части α	6° - 90°
						- биение	0 – 0,3 мм
						Инструкции изготовителя	Соответствует/не соответствует
						Маркировка абразивных инструментов	Соответствует/не соответствует
						Ярлык/ этикетка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Цифровой код	Соответствует/не соответствует
						Кодовые номера общих характеристик	Соответствует/не соответствует
184.	ГОСТ Р ИСО 6360-2	Система цифрового кодирования вращающихся инструментов	32.50.13 32.50.11	9018 49 9018 49		Кодовые номера для форм	Соответствует/не соответствует
						Формы и конструкция	Соответствует/не соответствует
185.	ГОСТ Р ИСО 6360-3	Боры и фрезы	32.50.13 32.50.11	9018 49		Специальные характеристики	Соответствует/не соответствует
						Кодовые номера для конкретных характеристик	Соответствует/не соответствует
186.	ГОСТ Р ИСО 6360-4	Боры и фрезы	32.50.13 32.50.11	9018 49		Специальные характеристики	Соответствует/не соответствует
						Кодовые номера для конкретных характеристик	Соответствует/не соответствует

187.	ГОСТ Р ИСО 6360-5	Инструменты для корня и канала зуба	32.50.13 32.50.11	9018 49	Система цифрового кодирования инструментов для корневого канала: - группы - идентификация Кодовые номера конкретных характеристик Идентификация конструкция Усилие извлечения наконечника Крутящий момент Усилие вставления наконечника Работоспособность: - частота - амплитуда - усилие потери скорости колебаний Уровень шума Устойчивость к коррозии Устойчивость к стерилизации	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует - Не менее 20 Н 200 Н·мм Не более 50 Н и 700 Н·мм 4000 – 40000 Гц 200 мкм Не более 10 Н 30 – 80 дБА Соответствует/не соответствует Не менее 250 циклов
188.	ГОСТ ISO 15606	Пневматические инструменты для снятия зубных отложений и наконечники к ним	23.91.11 32.50.11	2513 20 9018 49	Напряжение для подачи света Инструкции по применению Маркировка Упаковка	Не более 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
189.	ГОСТ Р ИСО 15841	Проволока ортодонтическая	32.50.50 32.50.11	3006 91 9018 49	Идентификация конструкция Упаковка и маркировка	- Соответствует/не соответствует
190.	ГОСТ Р ИСО 22374	Инструменты стоматологические электрические для удаления зубного камня и наконечники для них	32.50.11	9018 49 9018 49	Частота инструмента для удаления зубного камня при работе на заданных параметрах, рекомендованных изготовителем	От 18000 до 60000 Гц
191.	ГОСТ Р ИСО 13295	Дискодержатели	32.50.13 32.50.11	9018 41	Твердость по Виккерсу Маркировка Упаковка	Не менее 250 Н/мм ² Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
192.	ГОСТ Р ИСО 50351.1	Корневые напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы	32.50.11	9018 49	Размеры цветовое обозначение, идентификация Сопротивление излому при кручении и угловое отклонение Сопротивление изгибу Упаковка	- 320 МПа 50 Н Соответствует/не соответствует

193.	ГОСТ Р 50351.2	Каналорасширители	32.50.13 32.50.11	9018 49	Маркировка Идентификация: обозначение	Соответствует/не соответствует
194.	ГОСТ ISO 7785-1	Высокоскоростные пневматические турбинные наконечники	32.50.11	9018 49	Упаковка и маркировка Идентификация: конструкция Патрон (цанга): - усилие для вставления и извлечения испытательного мандрена - крутящий момент зажатого в патроне испытательного мандрена - биение Работоспособность: - скорость - крутящий момент ротора Подача воды и воздушной эмульсии: - скорость потока воды в наконечнике - расход воздуха, обеспечиваемый наконечником - присоединительные размеры - максимальное давление воздуха - уровень звука Устойчивость к воздействию коррозии Устойчивость к процедуре стерилизации Напряжение для подачи света Инструкция по использованию, технической эксплуатации и техническому обслуживанию Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует - 22 – 45 Н Не менее 1,6 Н·см без проскальзывания 0 – 0,03 мм 160000 мин ⁻¹ (об/мин) 0,05 Н·см Не менее 50 см ³ /мин при давлении 200 кПа (2,0 бар) Не более 1,5 дм ³ /мин при давлении 200 кПа (2,0 бар) Соответствует/не соответствует 50% выше рекомендованного рабочего давления 30 – 80 дБА Соответствует/не соответствует Не менее 250 циклов Не более 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
195.	ГОСТ ISO 7785-2	Прямые и угловые наконечники	32.50.11	9018 49	Идентификация: конструкция Размеры головки и носовой части и их наименования	Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует

196.	ГОСТ ISO 13397-1	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы	32.50.11	9018 49	Зажимное устройство:	22 - 45 Н / не менее 22 Н / не менее 45 Н
					- усилие для вставления и извлечения контрольных оправок	Не менее 1,6 Н·см без проскальзывания / не менее 4 Н·см / не менее 2 Н·см
					- крутящий момент	0,08 мм
					- биение	Не менее 50 мл/мин при давлении 200 кПа (2 бар)
					Подача воды и воздуха:	Не менее 1,5 л/мин при давлении 200 кПа (2 бар)
					- скорость подачи воды	Соответствует/не соответствует
					- скорость подачи воздуха	Не менее 250 циклов
					- соединение наконечника	Не более 20°C по сравнению с температурой окружающей среды
					- устойчивость к стерилизации	Соответствует/не соответствует
					- повышение температуры	Не более 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока
					Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
					Напряжение для подачи света	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации, уходу и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
197.	ГОСТ ISO 13397-2	Периодонтальные кюретки типа Gr	32.50.11	9018 49	Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация, материал	Соответствует/не соответствует
					Обработка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Твердость рабочей части инструментов по Виккерсу	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к тепловому воздействию	Устойчивы/ не устойчивы
					Соединение рабочей части и рукоятки инструмента	Соответствует/не соответствует
					Конструкция и размеры	Соответствует/не соответствует
					Ширина клинка	0,85±0,15 мм
					Толщина клинка	0,6±0,1 мм

198.	ГОСТ ISO 13397-3	Инструменты для снятия зубных отложений типа Н	32.50.11	9018 49	Высота клинка	(2,2 – 3,5) ± 0,3 мм
					Высота хвостовика	(3,0 – 8,6) ± 0,5 мм
					Длина до первого сгиба	(8,6 – 14,3) ± 0,7 мм
					Угол резания	70 ± 3°
					Угол смещения	(0 – 44) ± 3°
					Общая длина	≤ 178 мм
					Ширина клинка	(0,7 – 2) ± 0,15 мм
					Толщина клинка	(0,4 – 1) ± 0,1 мм
					Длина клинка	3,2 ± 0,3 мм / не менее 7 мм / не менее 12 мм
					Высота клинка	(2,8 – 3,8) ± 0,3 мм
199.	ГОСТ ISO 13397-4	Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы. Стоматологические экскаваторы - дисковидный тип	32.50.11	9018 49	Высота хвостовика	(1,2 – 5,5) ± 0,5 мм
					Длина до первого сгиба	(5,7 – 10,7) ± 0,7 мм
					Радиус клинка	5 мм
					Угол клинка	(50 – 120) ± 3°
					Угол отклонения	17 ± 3°
					Общая длина	≤ 178 мм
					Идентификация: классификация форм	-
					Ширина лопатки	0,7 – 2,6 мм
					Толщина лопатки	0,4 – 1,0 мм
					Длина лопатки	2,5 ± 0,1 мм
200.	ГОСТ ИСО 8170	Ручные режущие инструменты для восстановительной стоматологии	32.50.11	9018 49	Толщина шейки	0,5 – 1,3 мм
					Высота лопатки	1,3 – 6,7 мм
					Высота хвостовика	1,5 – 4,0 мм
					Угол лопатки	30° – 45°
					Угол поворота рабочего конца относительно оси	25° – 80°
					Максимальная общая длина	178 мм
					Крутящий момент	Соединение рабочей части с ручкой стоматологических экскаваторов должно выдерживать нагрузку 200 Н·см продолжительностью не менее 5 с
					Обозначение и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Ширина лезвия	(0,7 – 2) ± 0,15 мм
					Угол лезвия	(50 – 120) ± 3°
201.	ГОСТ Р ИСО 9173-1	Стоматология. Щипцы зубоврачебные	32.50.11	9018 49	Материалы	Соответствует/не соответствует
					Максимальная общая длина	Не более 178 мм
					Твердость	42 – 52 HRC

					Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Рисунок щепок шипцов	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к автоклавированию	Устойчиво/не устойчиво	Устойчиво/не устойчиво
					Устойчивость к коррозии и тепловому воздействию	Устойчиво/не устойчиво	Устойчиво/не устойчиво
					Усилие раскрытия/закрытия в месте соединения	0,20 – 0,68 Нм	
					Боковой люфт в закрытом и открытом положениях ручек	0 – 50 мм	
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	
202.	ГОСТ Р 50348.1	Стальные фрезы	32.50.11	9018 49	Идентификация: материал		
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм	
					Длина рабочей части, длина головки	(3,7 – 14) ± 0,25 мм	
					Минимальное число режущих кромок	8 – 30	
203.	ГОСТ 22090.1	Боры стальные и твердосплавные	32.50.11	9018 49	Радиальное биение	Не более 0,12 мм	
					Идентификация: материал	-	
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	0,52 – 5,1 мм	
					Диаметр шейки	0,48 – 2,32 мм	
					Длина рабочей части, длина головки	0,19 – 6,6 мм	
					Общая длина	14 – 71 мм	
					Число лезвий	6 – 12	
					Радиальное биение	Не более 0,05 – 0,08 мм	
					Прочность шейки:		
					- испытательная нагрузка	6,37 – 73,28 Н	
					- остаточная деформация	Не более 0,05 – 0,08 мм	
204.	ГОСТ 22090.2	Боры стальные и твердосплавные для окончательной обработки (финиры)	32.50.11	9018 49	Идентификация: материал	-	
					Диаметр рабочей части, диаметр головки	0,72 – 3,18 мм	
					Диаметр шейки	0,64 – 2,32 мм	
					Длина рабочей части, длина головки	0,58 – 8,5 мм	
					Общая длина	16 – 71 мм	
					Число лезвий	8 – 36	
					Радиальное биение	Не более 0,05 – 0,08 мм	
					Прочность шейки:		
					Остаточная деформация	Не более 0,05 – 0,08 мм	

205.	ГОСТ 30214	Стоматологические вращающиеся инструменты	32.50.11	9018 49	Номинальный диаметр рабочих частей	0,5 – 30 мм
206.	ГОСТ 30394.1	Стальные фрезы	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм
					Длина рабочей части, длина головки	(3,7 – 14) ± 0,25 мм
					Минимальное число режущих кромки	8 – 30
					Радиальное биение	Не более 0,12 мм
					Материал	Стержень (хвостовик) и рабочие части должны быть изготовлены из стали
207.	ГОСТ 30395.1	Корневые напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части, диаметр головки	3,75 – 16,15 мм
					Длина рабочей части, длина головки	(2,5 – 14) ± 0,25 мм
					Минимальное число режущих кромки	8 – 30
					Радиальное биение	Не более 0,12 мм
					Материал	Стержень (хвостовик) и рабочие части должны быть изготовлены из стали
208.	ГОСТ 30395.2	Каналорасширители	32.50.11	9018 49	Диаметр рабочей части	(0,5 – 1,9) ± 0,05 мм
					Диаметр шейки	0,6 – 1,45 мм
					Диаметр шейки на конце рабочей части	0,38 – 0,87 мм
					Диаметр шейки на конце оперативной части	0,36 – 0,83 мм
					Начальный диаметр направляющего конуса рабочей части	0,3 – 0,44 мм
					Длина рабочей части	2,5 – 15 мм
					Длина оперативной части	13 – 26 мм
					Длина оперативной части с шейкой	19 мм
					Общая длина	31,5 – 61,5 мм
					Расстояние от направляющего конуса рабочей части до сечения А-А	1,5 – 7,5 мм
					Количество режущих кромок	Не менее 3
					Обозначение и маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка и маркировка	Соответствует

					Диаметр шейки инструментов Длина рабочей части Конусность Радиальное биение Прочность шейки	
209.	ГОСТ 27875	Наконечники стоматологические пневмоторбинные и муфты плантов	32.50.11	9018 49	Наружный диаметр d, D Внутренний диаметр d ₁ , D ₁ Средний диаметр d ₂ , D ₂ Шаг резьбы P _н =P	13,932 – 14,379 мм 13,157 – 13,767 мм 13,530 – 13,980 мм 0,706 (36 витков на 1") / 0,635 (40 витков на 1")
210.	ГОСТ Р ИСО 7711-1	Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные	32.50.11	9018 49	Материал Размеры: - номинальный диаметр d ₁ - диаметр d ₂ - длина головки l ₁ - длина l ₂ - угол α - максимальный размер частиц - максимальное биение Коррозионная стойкость Прочность шейки	Соответствует/не соответствует 0,62 – 5,1 мм Не более 0,50 – 2,35 мм 0,5 – 10,3 мм 16,0 – 46 мм 2° – 60° 14 – 250 мкм 0,07 – 0,14 мм Соответствует/не соответствует Инструмент не должен ломаться или принимать усадку свыше 0,05 мм при испытательной нагрузке F (7,21 – 129,01) Н
211.	ГОСТ Р ИСО 7711-2	Диски	32.50.11	9018 49	Номинальный размер Диаметр отверстий Диаметр d ₁ Диаметр d ₂ Длина l ₁ Длина l ₂ Предел текучести Радиальное биение Присоединительная длина l ₃ Обозначение Цветовое кодирование Диапазон размеров крупниц Средний размер зерна Форма рабочей части Диаметр рабочей части Диаметр шейки	140 – 250 мм 1,6 ₀ ^{+0,05} или 1,8 ₀ ^{+0,05} мм / 16 ₀ ^{+0,05} или 18 ₀ ^{+0,05} мм 14 – 25 мм 10 – 21 мм 0,55±0,05 мм 0,3±0,02 мм Не менее 800-1000 Н/мм ² 0,15 мм (10 – 15) ±1 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует От 4 до 213 мкм 8 – 181 мкм Соответствует/не соответствует
212.	ГОСТ Р ИСО 7711-3	Инструменты стоматологические вращающиеся. Инструменты алмазные	32.50.11	9018 49		
213.	ГОСТ Р ИСО 8325	Инструменты стоматологические вращающиеся	32.50.11	9018 49		

						Общая длина										
						Угол конуса рабочей части										
						Биение рабочей части										
						Прочность шейки										
						Шероховатость поверхности										
214.	ГОСТ 24261	Стоматологическая техника. Знаки		32.50.11	9018 49	Размеры знаков										3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80 мм
						Условные обозначения										Соответствует/не соответствует
						Технические требования:										
						- толщина линий знаков										До 4 мм
						- зазор между линиями										Не менее 1,5-кратной толщины линии
						- угол стрелок										60°
215.	ГОСТ ISO 9873	Инструменты стоматологические ручные. Зеркала и ручки к ним многоразового использования		32.50.11	9018 49	Размеры:										
						- общая длина										Не более 178 мм
						- размеры соединений между стержнями и ручкой										Соответствует/не соответствует
						- номинальный диаметр d ₁										16 – 30 мм
						- диаметр d ₂										d ₁ минус не более 2,5 – 3,0 мм
						Положение головки зеркала относительно стержня										Соответствует/не соответствует
						Идентификация: материалы										-
						Корпус головки зеркала										Соответствует/не соответствует
						Отражающие поверхности										Соответствует/не соответствует
						Номинальное увеличение										2,8 – 3,3
						Искажения										Соответствует/не соответствует
						Прочность соединения корпуса со стержнем										Соответствует/не соответствует
						Ручки зеркала										Соответствует/не соответствует
						Маркировка										Соответствует/не соответствует
216.	ГОСТ Р ИСО 7787-2	Инструменты стоматологические вращающиеся. Фрезы. Карбидные лабораторные фрезы		32.50.11	9018 49	Идентификация: классификация, материалы Формы										- Соответствует/не соответствует
						Размеры и число режущих кромки										Соответствует/не соответствует

					Длина хвостовика 38 ±2 мм	
					Длина головки 3,25 – 14,5 мм	
					Диаметр головки 3,7 – 7,3 мм	
					Угол рабочей части 8° – 28°	
					Зубья Соответствует/не соответствует	
					Биеение Не более 0,08 мм	
					Маркировка на инструменте Соответствует/не соответствует	
					Ярлык на упаковке Соответствует/не соответствует	
					Упаковка Соответствует/не соответствует	
217.	ГОСТ ISO 13402	Инструменты хирургические и стоматологические ручные	32.50.11	9018 49	Устойчивость к автоклавированию Устойчивость к коррозии Устойчивость к тепловому воздействию	Устойчивы/ не устойчивы
218.	ГОСТ ISO 7492	Зонды стоматологические	32.50.11	9018 49	Материал Обработка поверхности Твердость Прочность на разрыв Устойчивость к коррозии Устойчивость к тепловому воздействию	Соответствует/не соответствует Визуальн Не менее 480 HVI Не менее 1700 МН·мм² Устойчивы/ не устойчивы Устойчивы/ не устойчивы
219.	ГОСТ 25982	Наконечники стоматологические к микроприводу	32.50.11	9018 49	Соединение рабочей части и рукоятки Маркировка Максимальная общая длина Размеры зондов: - радиус рабочей кромки - длина рабочей кромки - угол рабочей кромки - высота рабочей кромки - высота рабочей части - угол уклона Классификация	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 178 мм 2 – 11 мм 1,5 – 2,5 мм 20° – 130° 1,0 – 12,5 мм 2,5 – 9,5 мм 33° – 43° Соответствует/не соответствует

Работоспособность в интервалах рабочих температур и относительной влажности	Работоспособны/не работоспособны
Работоспособность при номинальной частоте вращения микропривода	Работоспособны/не работоспособны
Присоединительные размеры прямых наконечников	25 – 32 мм
Присоединительные размеры угловых наконечников	0,400 – 2,356 мм
Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
Шероховатость	0 – 0,63 мкм
Масса	0 – 60 г
Температура нагрева наружных поверхностей наконечников в рабочем состоянии	Не более 45°C
Устойчивость к стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
Взаимозаменяемость поворотных головок	Соответствует/не соответствует
Крепление головки наконечника	Соответствует/не соответствует
Усилие, необходимое для извлечения инструмента, зажатого в наконечнике	Не менее 30 Н
Усилие, прилагаемое к зажимному устройству наконечника, при зажатии или освобождении инструмента	Не более 30 Н
Момент силы, прилагаемый при зажатии или освобождении инструмента	Не более 0,4 Нм
Усилие вставления и извлечения режущего инструмента при освобожденном зажимном устройстве	Не более 3,0 Н
Допускаемое осевое усилие на инструмент	Не более 30 Н
Радиальное биение закрепленного в наконечнике инструмента	Не более 0,08 мм

				Вращающий момент, передаваемый наконечником режущему инструменту	Не менее $6,0 \cdot 10^{-2}$ Нм	
				Корректированный уровень звуковой мощности наконечника	30 – 61 дБА	
				Безотказная наработка	Не менее 150 ч	
				Полный установленный ресурс	Не менее 300 ч	
				Комплектность	Соответствует/не соответствует	
				Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует	
220.	ГОСТ Р ИСО 6360-6	Специальные характеристики абразивных инструментов	9018 49	Кодовые номера для конкретных характеристик	Соответствует/не соответствует	
221.	ГОСТ 19126	Инструменты медицинские металлические	9018 19 9018 31 9018 32 9018 39 9018 49 9018 50 9018 90	Идентификация: классификация, комплектность Внешний вид	-	
				Твердость по Роквеллу	Соответствует/не соответствует	
				Выступление головки и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью	28 – 66 HRC	
				Усилие свободного хода	0 – 0,5 мм	
				Не более $\pm 5\%$ предельно допустимого значения усилия свободного хода при движении бранша на один градус хода		
				Радиусы притупления рабочих частей:		
				- колющих	0 – 0,03 мм	
				- зондирующих (кроме стержневых стоматологических и отщепляющих)	Не менее 0,3 мм	
				- зажимных (с зубчатой рабочей частью)	0 – 0,1 мм	
				Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы	
				Устойчивость к воздействию температуры и влажности	Устойчивы/ не устойчивы	
				Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует	

222.	ГОСТ 21239	Инструменты хирургические. Ножницы	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы	-
					Твёрдость по Роквеллу и Виккерсу	40 – 65 HRC (10 – 670 HV)
					Шероховатость поверхности	Соответствует/не соответствует
					Точка соприкосновения режущих кромок, отсутствие/наличие зазора	Соответствует/не соответствует
					Разнодлинность концов лезвий ножиц в сомкнутом положении	0 – 0,2 мм
					Перекрытие концов режущих кромок	Не менее 0,8 мм
					Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует
					Режущие свойства	Соответствует/не соответствует
223.	ГОСТ 21240	Скальпели и ножи медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация, материалы	-
					Основные размеры	100 – 320 мм
					Твёрдость рабочих частей	42 – 62 HRC
					Толщина защитно-декоративного покрытия	Не менее 3 мм
					Прочность соединения составных частей	Соответствует/не соответствует
					Острота режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Ширина режущей кромки	0 – 3 мкм
					Острота концов остроконечных изделий	Усилие прокола конденсаторной бумаги не более 0,055 Н
					Герметичность полых ручек	Соответствует/не соответствует
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует

					Шероховатость поверхности режущих кромок, лезвий и шеек Устойчивость к коррозии Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	0,05 – 1,25 мкм Устойчивы/ не устойчивы Устойчивы/ не устойчивы
224.	ГОСТ Р 50331	Инструменты хирургические. Скальпели со съёмными лезвиями	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Присоединительные размеры лезвий и ручек с малой присоединительной характеристикой: - угол α - длина с - длина d - ширина e - ширина f - длина l Присоединительные размеры лезвий и ручек с большой присоединительной характеристикой: - угол α - длина с - длина d - ширина e - ширина f - длина l Толщина лезвия Ширина паза ручки Идентификация: материалы Твёрдость рабочих частей HV Внешний вид поверхности Шероховатость поверхностей Внешний вид режущих кромок Острота режущих кромок Устойчивость к коррозии Устойчивость к стерилизации	30° ±30' 4,40 – 4,65 мм 17,73 – 17,90 мм 2,31 – 2,48 мм 1,12 – 1,23 мм Не менее 9 мм 35° ±30' 7,40 – 7,65 мм 24,10 – 24,27 мм 3,60 – 3,77 мм 1,88 – 2,00 мм Не менее 13 мм 0,37 мм; 0,42 мм 0,45 мм; 0,50 мм - 502 – 900 Н/мм ² Соответствует/не соответствует Не более 0,63 мкм Соответствует/не соответствует Лезвие долота не должно выкрашиваться и притупляться Устойчивы/ не устойчивы Устойчивы/ не устойчивы
225.	ГОСТ 31519	Долота медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 39 9018 49 9018 90		

					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
226.	ГОСТ 31520	Кусачки костные	32.50.13 32.50.21	9018 39 9018 49 9018 90	Идентификация: материалы	-
					Твердость рабочих частей браншей кусачек	500 – 630 HV
					Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
					Острота режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхностей	0 – 1,25 мкм
					Смыкание браншей	Соответствует/не соответствует
					Свободное раскрытие браншей	Соответствует/не соответствует
					Легкость хода в замке	Соответствует/не соответствует
					Плавность хода в замке	Изменение усилия свободного хода не должно превышать $\pm 10\%$ предельно допустимого значения усилия свободного хода при движении бранша
					Самопроизвольное отвинчивание винтов или осей замкового соединения во время работы	Соответствует/не соответствует
227.	ГОСТ 28518	Долота медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 39 9018 49 9018 90	Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
					Идентификация: материалы	-
					Твердость рабочих частей	502 – 900 Н/мм ² HV
					Внешний вид поверхности	(46 – 64 HRC)
					Шероховатость поверхностей	Соответствует/не соответствует
					Толщина гальванического покрытия	Не более 0,63 мкм
					Внешний вид режущих кромок	Не менее 6 мм
					Острота режущих кромок	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к коррозии	Соответствует/не соответствует

				Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
				Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
228.	ГОСТ 28519	Пилы медицинские	32.50.13 32.50.21	Идентификация: материалы	-
				Твердость рабочих частей	423 – 800 HV (42 – 63 HRC)
				Внешний вид поверхности	Соответствует/не соответствует
				Эластичность проволоочной пилы	Соответствует/не соответствует
				Равномерность нарезки зубьев	Соответствует/не соответствует
				Шероховатость поверхностей	0,10 – 2,5 мкм
				Толщина композитного покрытия	Не менее 9 мкм
				Острота зубьев пилы	Соответствует/не соответствует
				Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
				Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
229.	ГОСТ 28684	Фрезы хирургические	32.50.13 32.50.21	Идентификация: материалы	-
				Твердость фрез	50 – 55 HRC
				Твердость рабочей части фрез	58 – 62 HRC
				Внешний вид режущих кромок	Соответствует/не соответствует
				Наличие гальванического покрытия	Соответствует/не соответствует
				Шероховатость фрез	0,63 – 1,25 мкм
				Состояние наружных поверхностей фрез	Соответствует/не соответствует
				Прочность	Наличие/отсутствие дефектов и биение
				Радиальное биение рабочей части относительно цилиндрической части хвостовика	0,10 – 0,30 мм

230.	ГОСТ 2034	Сверла спиральные	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90		Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
						Стойкость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
						Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/ не устойчивы
						Идентификация: размеры, класс точности, материалы	-
						Состояние зоны сварки	Соответствует/не соответствует
						Твердость рабочей части	61 – 68 HRC
						Твердость лапок сверл с коническим хвостовиком	30 – 46 HRC
						Твердость поводков сверл с цилиндрическим хвостовиком	Не менее 27 HRC
						Состояние поверхностей	Соответствует/не соответствует
						Шероховатость поверхностей	Не более 20 мкм
						Поля допусков диаметров режущей части сверл в начале рабочей части	h8, h9
						Предельное отклонение длин сверл	Не более 3 _j 16
						Обратная конусность	0,02 – 0,08 мм на 100 мм длины
						Допуск симметричности сердцевин в радиусном выражении относительно оси рабочей части сверла	0,03 – 0,15 мм
						Допуск симметричности поводка сверл с цилиндрическим хвостовиком в радиусном выражении относительно оси хвостовика	0,050 – 0,090 мм
						Допуск прямолинейности главных режущих кромок	0,06 – 0,20 мм
						Допуск радиального биения по ленточкам на всей длине рабочей части сверла	0,05 – 0,30 мм
						Допуск прямолинейности	0,03 – 0,06 мм
						Разность половин угла при вершине	Не более 1°30'

231.	ГОСТ Р 53519	Инструменты хирургические. Зажимы кровоостанавливающие	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Допуск симметричности поперечной кромки относительно оси рабочей части сверл	0,04 – 0,12 мм
					Маркировка на сверлах	Соответствует/не соответствует
					Маркировка транспортной и потребительской тары и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: материалы	-
					Твердость браншей	40 – 48 HRC
					Твердость браншей зажимов	390 – 485 HV
					Качество изготовления	Соответствует/не соответствует
					Поверхность инструментов	Соответствует/не соответствует
					Отделка поверхности	Соответствует/не соответствует
					Упругость	Отсутствие/наличие разрушений, трещин и других остаточных деформаций
232.	ГОСТ 21238	Инструменты хирургические. Нережущие шарнирные инструменты	32.50.13 32.50.21	9018 39 9018 49 9018 50 9018 90	Устойчивость к коррозии	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: материалы	-
					Твердость термообработанных браншей	40 – 48 HRC (390 – 485 HV)
					Твердость пластин твердого сплава из карбида вольфрама	Не менее 1000 HV
					Шероховатость поверхности	Не более 1,60 мкм
					Коррозионная стойкость	Устойчивы/ не устойчивы
					Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/ не устойчивы
					Качество изготовления	Соответствует/не соответствует
					Состояние поверхности	Соответствует/не соответствует

					Упругость	Соответствует/не соответствует
					Функциональные свойства иглодержателей	Соответствует/не соответствует
					Маркировка на инструменте	Соответствует/не соответствует
233.	ГОСТ Р ИСО 15098-1	Пинцеты стоматологические	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы Максимальная общая длина Твердость рабочей части Состояние поверхности Устойчивость против коррозии Маркировка на инструменте	- Не более 178 мм 390 – 550 HV Соответствует/не соответствует Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует
234.	ГОСТ 21241	Пинцеты медицинские	32.50.13 32.50.21	9018 49 9018 90	Идентификация: материалы Твердость бранш Твердость упроченной части Твердость штифтов Состояние поверхности Шероховатость поверхностей Боковое смещение прилегающих рабочих частей Смыкание рабочих частей пинцетов Упругость браншей Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации	- 41 – 48 HRC Не менее 86 HRA 28 – 36 HRC Соответствует/не соответствует Не более 1,25 мкм Не более 0,15 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчивы/ не устойчивы
235.	ГОСТ 30393	Скальпели со съёмными лезвиями	32.50.13.190	9018 49	Коррозионная стойкость Угловые размеры Размеры съёмного лезвия Размер ручки скальпеля	Устойчивы/ не устойчивы 30° - 35° 1,18 – 24,27 мм 1,12 – 24,18 мм
236.	ГОСТ Р ИСО 16061	Инструменты, используемые совместно с неактивными хирургическими имплантатами	32.50.13.190	9021 90	Показатели назначения Конструкция Материалы Стерилизация Упаковка Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует

237.	ГОСТ 30208 (ИСО 7153-1)/ГОСТ Р 50328.1 (ИСО 7153-1)	Нержавеющая сталь	32.50.13	9018 49	Подбор марок сталей	Испытания проводятся методом сравнения эксплуатационной и технической документации с представленными образцами
238.	ГОСТ 4.307	Инструменты однолезвийные.	32.50.13.190	9018 49	Применимость показателей качества однолезвийных инструментов	Ширина режущей кромки; твердость; срок сохранения стерильности, апиrogenности и нетоксичности для скальпелей однократного применения; полный установленный срок службы; полный установленный ресурс.
239.	ГОСТ 31998.1	Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения	27.40.14	8539 41 8539 49	Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Защита от случайного проникновения в резьбовых патронах	Соответствует/не соответствует
					Повышение температуры цоколя	Не более 65 – 175 °С
					Сопротивление крутящему моменту	0,3 – 3,0 Н·м
					Сопротивление изоляции	Не менее 2 МОм
					Части, случайно оказавшиеся под напряжением	Соответствует/не соответствует
					Пути утечки	Не менее 0,8 мм
					Безопасность в конце продолжительности горения	Безопасны/ не безопасны
					Взаимозаменяемость	Соответствует/не соответствует
240.	ГОСТ IEC 60432-2	Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения	27.40.14	8539 41 8539 49	Наличие плавкого предохранителя	Присутствует/ отсутствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Защита от случайного проникновения в резьбовых патронах	Соответствует/не соответствует
					Повышение температуры цоколя	Не более 65 – 175 °С
					Стойкость к крутящему моменту	0,3 – 3,0 Н·м
					Сопротивление изоляции	Не менее 2 МОм

на 408 листах, лист 83

						Детали, случайно оказавшиеся под напряжением	Соответствует/не соответствует
						Пути утечки	Не менее 0,8 мм
						Безопасность в конце продолжительности горения	Безопасны/ не безопасны
						Взаимозаменяемость	Соответствует/не соответствует
						Ультрафиолетовое излучение	Не более 0,35 мВт/кВт, а для рефлекторной лампы 0,35 мВт·м ⁻² ·клк ⁻¹
241.	ГОСТ Р 51125	Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха	28.99.39	8415 20 8415 10 8415 81 8415 90		Электробезопасность Корректированный уровень звуковой мощности	Соответствует/не соответствует
242.	ГОСТ Р 51873	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Активность радионуклида на тампоне методом мазка	Не более 0,2 кБк
243.	ГОСТ 26307	Источники гамма-излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
244.	ГОСТ Р 52125	Источники рентгеновского излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
245.	ГОСТ 23649	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Маркировка Конструкция	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
246.	ГОСТ 25926	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Классы прочности источника	1 – 5
247.	ГОСТ Р 50830	Источники закрытые радиоактивные	20.13.13	2844 40		Активность радионуклида на тампоне методом мазка	Не более 0,2 кБк
248.	ГОСТ Р 51919	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	20.13.13	2844 40		Активность радионуклида на тампоне методом мазка	Не более 0,2 кБк
249.	ГОСТ 16327	Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ.	29.10.59	8705 90		Показатели назначения	Соответствует/не соответствует
						Конструкция	Соответствует/не соответствует
						Материалы	Соответствует/не соответствует
250.	СанПиН 2.6.1.1281-03	Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при	-	-		Мощность поглощенной дозы гамма-излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч

		транспортировании радиоактивных материалов (веществ)					
251.	СанПиН 2.6.1.2523	Медицинские источники ионизирующего излучения	-	-	Мощность эффективной дозы	Не более 40 мкЗв/ч	
252.	СанПиН 2.6.1.3289	Рентгеновские установки медицинского назначения	-	-	Мощность амбиента	Не более 10 мкГр/ч	
253.	СП 2.6.1.2612	Техногенные источники (медицинские)	-	-	Доза	Не более 1 мГр	
254.	ГОСТ Р 52241	Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые	26.60.12 20.13.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Классы прочности источника	1 - 5	
255.	ГОСТ Р МЭК 62467-1	Изделия медицинские электрические. Дозиметрические приборы, используемые в брахитерапии. Приборы, основанные на ионизационных камерах коллоидного типа	26.60.12 20.13.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Мощность амбиента	Не более 10 мкГр/ч	
256.	ГОСТ ISO 4090	Медицинские рентгенографические кассеты/экраны/пленки и пленки для твердых копий изображения.	26.60.11	9022 21 9022 90	Размеры	10 - 90 см	
257.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63	Рентгеновские детальные экстраоральные аппараты	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	10 нГр - 9999 Гр 10 нГр/с - 1000 мГр/с 10 нГр - 9999 Гр 10 нГр/с - 1000 мГр/с 10 нГр/с - 1000 мГр/с 0,05 мкЗв - 10,0 Зв 50 нЗв/ч - 10,0 Зв/ч	

258.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65	Рентгеновские дентальные интраоральные аппараты	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
259.	ГОСТ ИЕС 60522	Излучатели рентгеновские	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Постоянная фильтрации	0,2 – 14 мм Al
260.	ГОСТ Р МЭК 60336	Излучатели медицинские рентгенодиагностические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размеры фокусного пятна	0,15 – 5,60 мм
					Функция расширения линии	-
					Функция передачи модуляции	Не менее 10%
					Степень размывания изображения	Меньше нормированного значения или равно ему
261.	ГОСТ Р 50755	Рентгенодиагностические трубки с вращающимся анодом	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Максимальное симметричное радиационное поле рентгенодиагностической трубки с вращающимся анодом	0 – 40 см

262.	ГОСТ Р 51746	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Эксплуатационные параметры рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики	Соответствует/не соответствует
263.	ГОСТ Р 51817	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Видеоконтрольные устройства	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Постоянство качества изображения видеоконтрольных устройств: - отклонение значений яркости экрана от базового значения - отклонение значения яркости черного квадрата от базового значения - отклонение значения яркости белого квадрата - стабильность изображения и артефакты	Соответствует/не соответствует $\pm 25\%$ $\pm 25\%$ $\pm 20\%$
264.	ГОСТ 29025	Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Степень защиты Сопротивление изоляции силовых цепей Изоляция силовых цепей Мощность экспозиционной дозы излучения Уровень звукового давления Классификация	Соответствует/не соответствует IP20 Не менее 20 МОм Должна выдерживать воздействие испытательного напряжения 1500 В Не более $2,16 \cdot 10^{-11}$ А/кг 30 – 70 дБ Соответствует/не соответствует
265.	ГОСТ 25113	Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Номинальное напряжение рентгеновской трубки Номинальный ток рентгеновской трубки Требования к электрическому питанию и присоединению к сети Сопротивление изоляции электрических цепей Воздействие испытательного напряжения Автоматический вывод на номинальный режим работы	60 – 400 кВ Не менее 1 мА 220 или 380 В ($\pm 10\%$), (50 ± 1) Гц Не менее 1,0 МОм 500 – 3000 В 0 – 5 с

Возможность выполнения минимальной экспозиции	0 – 30 с
Неравномерность дозы по полю облучения	0 – 20%
Нижняя граница диапазона регулирования напряжения на рентгеновской трубке	0 – 10 кВ
Воспроизводимость заданного значения напряжения и тока рентгеновской трубки	0 – 1,0% - для напряжения 0 – 0,5% - для тока
Усилие равномерного перемещения оператором передвижных аппаратов	0 – 250 Н
Усилие поворота, переключения и фиксации рукояток штативов	0 – 50 Н
Усилие равномерного перемещения подвижных частей штативов	0 – 100 Н
Масса моноблоков аппаратов	0 – 56 кг
Объем моноблоков аппаратов	0 – 0,065 м ³
Масса излучателей кабельных аппаратов	0 – 78 кг
Размеры излучателей кабельных аппаратов	0 – 800 мм
Масса пульта управления	0 – 20 кг
Номинальная электрическая мощность на аноде рентгеновской трубки	Не менее 50% мощности, потребляемой от сети
Устойчивость после воздействия климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
Степень защиты	IP20
Мощность дозы в воздухе от рентгеновских излучателей	0 – 10 мГр/ч
Отклонение размеров поля облучения, формируемого коллиматором	Не более ±10 мм на каждые 100 мм
Длина дополнительного кабеля	Не менее 15 м
Упаковка, маркировка	Соответствует/не соответствует

266.	МР № 0100/12883-07-34	Рентгеновские излучатели медицинских рентгенодиагностических аппаратов	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Радационный выход рентгеновских излучателей	10 нГр/с – 1 мГр/с
267.	ГОСТ 26114	Дефектоскопы на базе ускорителей заряженных частиц	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Номинальные значения энергии ускоренных электронов и граничной энергии квантов тормозного излучения Номинальные значения средней мощности поглощенной дозы тормозного излучения Номинальные значения средней мощности поглощенной дозы ускоренных электронов Относительная нестабильность энергии ускоренных электронов Относительная нестабильность средней мощности поглощений дозы ускоренных электронов или тормозного излучения Продолжительность установления рабочего режима Масса составных частей (блоков) переносных дефектоскопов	0,5 – 50 МэВ 0,010 – 250 гр/мин 0,40 – 250 Гр/мин 0 – 5% 0 – 3%
268.	ГОСТ 4.198	Аппараты рентгеновские аналитические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Номенклатура показателей качества	-
269.	ГОСТ Р МЭК 61267	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Условия излучения при определении характеристик	Соответствует/не соответствует
270.	ГОСТ 26140		26.60.11	9022 13	Питание аппаратов от сети	220 и (или) 380 В (±10%)

	Аппараты рентгеновские медицинские			9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90			Номинальная кратковременная мощность при номинальном напряжении сети	(50±1) Гц
							Пульсация анодного напряжения	0 – 12%
							Усилия поворота или переключения рукояток	0 – 50 Н
							Усилия перемещения подвижных частей рентгеновских штативных устройств	0 – 40 Н
							Усилия торможения экрано- снимочного устройства	Не менее 150 Н
							Устойчивость при климатических и механических воздействиях	Устойчивы/не устойчивы
							Мощность дозы излучения на расстоянии 100 см от фокусного пятна в любом направлении	0 – 8,7 мГр/ч
							Степень защиты	IP20
							Сопротивление изоляции электрических цепей	Не менее 10 МОм
							Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
							Общие требования к измерению параметров	Соответствует/не соответствует
							Ток и напряжение накала	0,001 – 2000 мА 22 – 160 кВ
							Ток и напряжение инъекции рентгеновских бетатронных камер	0,001 – 2000 мА 22 – 160 кВ

271. ГОСТ 22091.0

Приборы рентгеновские

26.60.11

272. ГОСТ 22091.1

Приборы рентгеновские

26.60.11

273. ГОСТ 22091.2

Приборы рентгеновские

26.60.11

					9022 29 9022 30 9022 90				
274.	ГОСТ 22091.3		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размер поля облучения	0 – 40 см	
275.	ГОСТ 22091.4		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Напряжение рентгеновской трубки	22 – 160 кВ	
276.	ГОСТ 22091.5		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Ток рентгеновской трубки	0,001 – 2000 мА	
277.	ГОСТ 22091.6		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения за импульс	10 нГр/с – 1 мГр/с 1 нГр/имп – 5 мГр/имп	
278.	ГОСТ 22091.9		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Размеры эффективного фокусного пятна	0,2 – 1,6 мм	
279.	ГОСТ 22091.11		Приборы рентгеновские	26.60.11		9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29	Время готовности	1-10 мин	

280.	ГОСТ 26141	Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов	26.60.11	9022 30 9022 90	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Диаметр основного рабочего поля УРИ Не менее 320 мм Предел разрешения Не менее 3,4 Геометрические искажения УРИ 0 – 12% Динамический диапазон УРИ Не менее 20 Отношение сигнал – шум Не менее 34 дБ Смещение центра выходного изображения УРИ 0 – 5 мм Диаметр выходного изображения УРИ Не менее 18 мм Время установления рабочего режима УРИ 0 – 15 мин Устойчивость к внешним воздействиям Устойчивы/не устойчивы	
281.	ГОСТ 26145	Кассеты рентгеновские медицинские	26.60.11	9022 90		Размеры: - формат кассеты (9×12 – 35×43) см - длина кассеты по внешнему контуру L 147,5 – 1227,5 мм - ширина кассеты по внешнему контуру B 117,5 – 383,5 мм - толщина S 15,0 – 16,5 мм - длина l 91 – 1202 мм - ширина b 121 – 358 мм Масса Не более 0,3 – 7,9 кг	
282.	ГОСТ ISO 9236-1	Системы экран/пленка для медицинской рентгенографии.	26.60.11	9022 90		Технические требования Соответствует/не соответствует Форма характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента Соответствует/не соответствует	
283.	ГОСТ Р ИСО 9236-3	Системы экран/пленка для медицинской рентгенографии.	26.60.11	9022 90		Форма характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента для маммографии Соответствует/не соответствует	
284.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-4	Рентгеновская аппаратура в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Мультитформатные камеры	26.60.11	9022 90		Постоянство параметров мультитформатной камеры Соответствует/не соответствует	
285.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5	Рентгеновская аппаратура для компьютерной томографии	26.60.11	9022 90		Позиционирование стола пациента ±1 мм Томографическая толщина среза 0,5 – 10 мм	

					Шум, среднее число КТ-единиц и однородность	Минус 1024 - 1024	
286.	ГОСТ Р ИСО 5799	Безэкранные медицинские и дентальные рентгенографические системы пленка/процесс обработки.	20.59.11	3701 10 3702 10	Пространственное разрешение	0 - 5 пар линий/мм	
287.	ГОСТ ISO 3665	Фотография. Интраоральные дентальные радиографические пленки.	20.59.11	3701 10 3702 10	Маркировка плёнки и обозначения	Соответствует/не соответствует	
					Чувствительность по ИСО	Не более 400 ед	
					Средний градиент по ИСО	1 - 4,5 ед	
288.	ГОСТ 27047	Экраны для рентгенокопии и флюорографии	26.60.11	9022 90	Классификация	Соответствует/не соответствует	
					Плотность основы и вуали пленок	Менее 0,25	
					Маркировка	Соответствует/не соответствует	
					Основные размеры:		
					- ширина	128 - 400 мм	
					- длина	178 - 410 мм	
					Технические требования	Края экранов должны быть обрезаны под углом 90°	
					Ширина окантовки из полимерной плёнки	0 - 2,5 мм	
289.	ГОСТ 27048	Экраны усиливающие медицинские	26.60.11	9022 90	Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы	
					Основные размеры:		
					- ширина	90 - 400 мм	
					- длина	120 - 1200 мм	
					Технические требования	Края экранов должны быть обрезаны под углом 90° Прямоугольность плоскости экрана должна быть такой, чтобы ее периметр находился между двумя прямоугольниками, один из которых построен с учетом минимального допуска, другой - с учетом максимального допуска.	
290.	ГОСТ 31114.1	Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике	26.60.11 14.22.30	9022 90	Радиус закругления углов экрана	(8±1) мм	
					Свинцовый эквивалент	0,01 - 5,0 мм. Рb	

291.	ГОСТ 31114.2	Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике	26.60.11 14.22.30	9022 90	Свинцовый эквивалент	0,01 – 5,0 мм. Pb
292.	ГОСТ 31114.3	Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике	26.60.11 14.22.30	9022 90	Свинцовый эквивалент	0,01 – 5,0 мм. Pb
293.	ГОСТ Р 50267.2.54 (МЭК 60601-2-54)	Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии	26.60.11	9022 12 9022 13	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность ambiентного эквивалента дозы рентгеновского излучения Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч 1,0 – 14,0 мм Al 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с 1,0 – 14,0 мм Al 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с
294.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28	Медицинские диагностические рентгеновские излучатели	26.60.11	9018 13 9018 14 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Длительность экспозиции Слой половинного ослабления (СПО) Анодное напряжение Анодный ток Длительность экспозиции	1,0 – 14,0 мм Al 35 – 160 кВ 0,001 – 200 мА 1,0 мс – 6,0 с
295.	ГОСТ ИЕС 61676	Дозиметрические приборы, используемые для неинвазивного измерения напряжения на рентгеновской трубке в диагностической радиологии	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения. Керма в воздухе Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения. Мощность кермы в воздухе Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения Мощность ambiентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	10 нГр – 9999 Гр 10 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 1000 мГр/с 10 нГр/с – 1000 мГр/с 0,05 мкЗв – 10,0 Зв 50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч

						Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
296.	ГОСТ IEC 62220-1	Цифровые приемники рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %	
297.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2	Устройства для получения цифровых рентгеновских изображений. Детекторы, используемые при маммографии	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %	
298.	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3	Цифровые приемники рентгеновского изображения. Приемники, работающие в динамическом режиме получения изображений	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Квантовая эффективность	0 – 100 %	
299.	НП-053-16	Радиоактивные материалы	-	-	Безопасность при транспортировании радиоактивных материалов	Соответствует/не соответствует	
300.	МУ 2.6.1.2944-11	Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв	
301.	МУ 2.6.1.2135-06	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв	
302.	МУ 2.6.1.1892-04	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов	-	-	Эффективная доза	0,1 мкЗв – 20 мЗв	
303.	ГОСТ Р 51818	Фотолаборатории	26.60.11	9018 13 9022 14 9022 21 9022 29	Постоянство параметров Неактиничность освещения	Соответствует/не соответствует	

304.	ГОСТ ИЕС 60601-2-43	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	26.60.11	9022 12 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Аl
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
305.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43	Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур	26.60.11	9022 12 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Аl
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
306.	ГОСТ ИЕС 60601-2-44	Рентгеновские компьютерные томографы	26.60.11	9022 12	Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с

307.	ГОСТ ИЕС 60601-2-45	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса	26.60.11	9022 14 9022 21 9022 29	Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО).	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток.	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
308.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45	Маммографические рентгеновские аппараты и маммографические устройства для стереотаксиса	26.60.11	9022 14 9022 21 9022 29	Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО).	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток.	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
					Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
					Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
					Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ

309.	ГОСТ IЕС 60601-2-7	Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов	26.60.11	9022 90		Анодный ток	0,001 – 200 мА
						Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
						Анодное напряжение	35 – 160 кВ
						Анодный ток	0,001 – 200 мА
						Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
310.	ГОСТ 30324.32	Вспомогательное оборудование рентгеновских аппаратов	26.60.11	9022 90		Воздействие влаги	Устойчивы/ не устойчивы
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Индикаторы и кнопки	Соответствует/не соответствует
						Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
						Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
						Коэффициент безопасности	Соответствует/не соответствует
						Движущиеся части	Соответствует/не соответствует
						Устойчивость при нормальной эксплуатации	Устойчивы/ не устойчивы
						Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
						Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
311.	ГОСТ 30324.0.3	Диагностические рентгеновские аппараты	26.60.11	9022 90		Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
						Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
						Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
						Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
						Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
						Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
312.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3	Диагностические рентгеновские аппараты	26.60.11 26.70.17	9022 90 3006 30 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30		Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
						Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
						Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр
						Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр
						Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
						Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
						Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
						Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al
						Поглощенная доза рентгеновского излучения.	10 нГр – 9999 Гр

			9022 90 9010 10			Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв на 408 листах, лист 100				
						Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч				
						Слой половинного ослабления (СПО)	1,0 – 14,0 мм Al				
313.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1	Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Осмотр	Соответствует/не соответствует					
					Анодное напряжение	19 – 153 кВ					
					Общая фильтрация	Соответствует/не соответствует					
					Фокусное пятно	Соответствует/не соответствует					
					Диафрагмирование и индикация размера пучка излучения	Соответствует/не соответствует					
					Автоматическое управление экспозиционной дозой	Соответствует/не соответствует					
					Пространственное разрешение	Соответствует/не соответствует					
					Осмотр	Соответствует/не соответствует					
					Анодное напряжение	19 – 153 кВ					
					Общая фильтрация	Соответствует/не соответствует					
314.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2	Рентгеновские аппараты для маммографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Фокусное пятно рентгеновской трубки	Соответствует/не соответствует					
					Диафрагмирование и индикация размера пучка излучения	Соответствует/не соответствует					
					Автоматическое управление экспозиционной дозой	Соответствует/не соответствует					
					Структурные артефакты	Соответствует/не соответствует					
					Размытость изображения движущегося отсеивающего растра	Соответствует/не соответствует					
					Идентификация, проверка документации	Соответствует/не соответствует					
					Осмотр	Соответствует/не соответствует					
					Воздушная керма	10 ⁻¹⁰ – 1500 Гр					
					315.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-3	Рентгеновские аппараты для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА)	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14	Идентификация, проверка документации	Соответствует/не соответствует
										Осмотр	Соответствует/не соответствует
Воздушная керма	10 ⁻¹⁰ – 1500 Гр										

316.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4	Дентальные рентгеновские аппараты	26.60.11	9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Динамический диапазон	20 – 100
					Контрастная чувствительность ЦСА	Соответствует/не соответствует
					Пространственное разрешение ЦСА	Соответствует/не соответствует
					Артефакты	Соответствует/не соответствует
					Осмотр	Соответствует/не соответствует
					Анодное напряжение	36 – 153 кВ
					Полная фильтрация	1,5 – 38 мм Al 50 – 150 кВ
317.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-1	Устройства для фотохимической обработки пленки	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	2,0 – 6,3 пар линий/мм
					Низкоконтрастное разрешение	1; 1,5; 2; 2,5 мм
					Размер рентгеновского поля	0 – 6,5 см
					Стабильность экспозиционных параметров	Отклонение оптической плотности основы плюс вуаль $\pm 0,05$ базового значения
					Отклонение показателя чувствительности $\pm 0,15$ базового значения	Отклонение оптической плотности основы плюс вуаль $\pm 0,05$ базового значения
					Наличие следов фиксажа на пленке	Соответствует/не соответствует
					Плотность прилегания рентгенографической пленки к усиливающим экранам	Соответствует/не соответствует
318.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-2	Рентгенографические кассеты и сменщики пленки	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Плотность прилегания рентгенографической пленки к усиливающим экранам	Соответствует/не соответствует
					Шум при компьютерной томографии	0 – 100 %
					Однородность поля	0 – 40 HU
319.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6	Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30	Шум при компьютерной томографии	0 – 100 %
					Однородность поля	0 – 40 HU
					Однородность поля	0 – 40 HU

		Пространственное разрешение		2,5 – 12,5 пар линий/см	
		Толщина слоя		0 – 54 мм	
		Точность положения стола для пациента		Соответствует/не соответствует	
320.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-7	Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии	26.60.11	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	0 – 60 мм
321.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9	Аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой рентгенографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует
322.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10	Рентгеновские аппараты для маммографии	26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	0,5 – 10 пар линий/мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 0 – ±10 мм
323.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11		26.60.11	9018 13	Входное излучение:

		Аппараты для общей прямой рентгенографии		9018 14 3006 30 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90			- поглощенная доза в воздухе (керма) - мощность кермы Входное излучение на поверхности приемника изображения: - поглощенная доза в воздухе Совпадение оптического и рентгеновского полей излучения Отклонение от перпендикулярности оси пучка излучения Пространственное разрешение Мощность дозы гамма - излучения	10 нГр -- 9999 Гр 10 - 10 ⁹ нГр/с
324.	ГОСТ 8.651	Медицинские изделия. Радиационная стерилизация.	26.51.66 28.99.39	9022 19 9030 10			Требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновского кабинета	Соответствует/не соответствует
325.	СанПиН 2.6.1.1192-03	Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований	-	-			Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты: - защитная эффективность передвижных средств радиационной защиты Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0 - 0,15 мм Pb 0,1 - 10 ⁶ мкЗв/ч
326.	СанПиН 2.6.1.2368-08	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников	-	-			Требования к размещению ускорителей	Соответствует/не соответствует
327.	СанПиН 2.6.1.2573-10	Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ	-	-			Требования к радиационной защите	Соответствует/не соответствует
328.	СанПиН 2.6.1.3164-14	Гигиенические требования по обеспечению радиационной	-	-			Требования к системам блокировки и сигнализации Требования к помещениям	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

		безопасности при рентгеновской дефектоскопии			Требования к радиационной защите	Соответствует/не соответствует
329.	СП 2.6.1.3241—14	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии	-		Требования к системам блокировки и сигнализации	Соответствует/не соответствует
330.	СП 2.6.1.3247—15	Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии	-		Мощность Ambientного эквивалента дозы излучения	Не более 20 мкЗв/ч
331.	Р 2.2.2006-05	Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда	-		Общие требования к устройству радоновых лабораторий	Соответствует/не соответствует
332.	MP 01/8152-8-26	Проведение радиационного контроля инспекционно-досмотровых ускорительных комплексов	-		Мощность дозы гамма-излучения	10 нГр – 50 мГр
333.	МУ 2.6.1.1017-01	Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закрытого источника I-125, фиксированного на полимерной рассасывающейся нити "I-125 Rapid Strand"	-		Доза Ambientная (эквивалент дозы)	0,015 – 10 МэВ 50 нЗв – 10 Зв
334.	МУ 2.6.1.1982-05	Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах	-		Радиационный контроль	Соответствует/не соответствует
335.	МУ 2.6.1.2500-09	Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в	-		Мощность Ambientного эквивалента дозы рентгеновского излучения	5·10 ⁻⁸ – 10 Зв/ч
					Мощность поглощённой дозы в воздухе	5·10 ⁻⁸ – 10 Гр/ч
					Эффективная доза	1·10 ⁻⁷ – 15 Зв
					Мощность эффективной дозы	1·10 ⁻⁷ – 100 Зв/ч
					Мощность Ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 – 10 ⁶ мкЗв/ч

		подразделении радионуклидной диагностики					
336.	МИ 2453-15	Радиационный контроль	-			Мощность ambientного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1 – 10 ⁶ мкЗв/ч
337.	ГОСТ 31222.2	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 19 9022 90		Фактор преобразования	0,2 – 4,0
338.	ГОСТ 31222	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 19 9022 90		Дисторсия	0,1-3,0 ед
339.	ГОСТ ИЕС 61262-1	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 19 9022 90		Размеры входного поля	0x0 – 43x43 см
340.	ГОСТ ИЕС 61262-3	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90		Неравномерность яркости изображения	1 – 15 %
341.	ГОСТ ИЕС 61262-5	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения	26.60.11	9022 19 9022 90		Квантовая эффективность	1,0 100,0 %
342.	ГОСТ ИЕС 61262-6	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 19 9022 90		Контрастность	100 – 400 ед
343.	ГОСТ ИЕС 61262-7	Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения.	26.60.11	9022 19 9022 90		Функция передачи модуляции	1 – 100 %
344.	ГОСТ Р 50267.7	Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов	26.60.11	9022 19 9022 90		Анодное напряжение	35 – 160 кВ
						Анодный ток	0,001 – 200 мА
345.	ГОСТ Р 50267.15	Рентгеновские генераторы с накопительным конденсатором	26.60.11	9022 19 9022 90		Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
						Анодное напряжение	35 – 160 кВ
						Анодный ток	0,001 – 200 мА
346.	ГОСТ 30324.28	Диагностические блоки источника рентгеновского излучения и рентгеновские излучатели	26.60.11	9022 19 9022 90		Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
						Анодное напряжение	35 – 160 кВ
						Анодный ток	0,001 – 200 мА
						Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
347.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44	Рентгеновские компьютерные томографы	26.60.11	9022 12		Поглощенная доза рентгеновского излучения. Длительность экспозиции	10 нГр – 9999 Гр
						Керма в воздухе	10 нГр – 9999 Гр

					Мощность поглощенной дозы рентгеновского излучения.	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Мощность кермы в воздухе	10 нГр/с – 1000 мГр/с
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	0,05 мкЗв – 10,0 Зв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	50 нЗв/ч – 10,0 Зв/ч
					Слой половинного ослабления (СПО).	1,0 – 14,0 мм Al
					Анодное напряжение	35 – 160 кВ
					Анодный ток	0,001 – 200 мА
					Длительность экспозиции	1,0 мс – 6,0 с
348.	ГОСТ Р МЭК 60789	Радионуклидные визуализирующие устройства гамма-камер типа Ангера	26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Системная чувствительность	Соответствует/не соответствует
					Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
					Томографическая чувствительность	Соответствует/не соответствует
349.	ГОСТ ИЕС 61675-1	Позитронные эмиссионные томографы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
350.	ГОСТ ИЕС 61675-2	Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Центр вращения	Соответствует/не соответствует
					Наклон головки детектора	Соответствует/не соответствует
					Смещение отверстий коллиматора	Соответствует/не соответствует
					Рассеяние	Соответствует/не соответствует
351.	ГОСТ ИЕС 61675-3	Системы визуализации всего тела на базе гамма-камеры	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Сопроводительные документы	Соответствует/не соответствует
352.	ГОСТ Р МЭК 61675-1	Позитронные эмиссионные томографы	26.60.12	9018 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Пространственное разрешение	0,6 – 10 пар линий/мм
					Коэффициент восстановления	Соответствует/не соответствует
353.	ГОСТ 31599		26.60.11	9022 90	Размеры	2 – 1228,5 мм

			Кассеты медицинские для общей рентгенографии и маммографии				Прямоугольность	Соответствует/не соответствует	на 408 листах, лист 10 /
354.	ГОСТ 25642		Пленки радиографические и флюорографические	26.60.11	9022 90		Маркировка	Соответствует/не соответствует	
355.	ГОСТ Р 51745		Экраны рентгенографические усиливающие медицинские.	26.60.11	9022 90		Упаковка	Соответствует/не соответствует	
356.	ГОСТ IEC 61303		Радионуклидные калибраторы	26.60.11 26.60.12	9018 14 9022 21 9022 90		Размеры	13 – 1200 мм	
							Маркировка	Соответствует/не соответствует	
357.	ГОСТ Р МЭК/ТО 60977		Медицинские электронные ускорители в диапазоне от 1 МэВ до 50 МэВ	27.90.11	8543 70		Эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует	
							Однородность радиационных полей	Соответствует/не соответствует	
							Индикация расстояния по оси пучка излучения	Соответствует/не соответствует	
							Нулевое показание на поворотных шкалах	Соответствует/не соответствует	
							Движения стола для пациента	Соответствует/не соответствует	
358.	ГОСТ IEC 61217		Аппараты дистанционные для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90		Системы координат	Соответствует/не соответствует	
							Шкалы и цифровые дисплеи	Соответствует/не соответствует	
							Движения частей аппарата	Соответствует/не соответствует	
							Нулевые позиции аппарата	Соответствует/не соответствует	
							Шкалы, градуировки, направления и дисплеи	Соответствует/не соответствует	
359.	ГОСТ 30324.2.9		Дозиметры для лучевой терапии, электрически соединенным с детекторами излучения, находящимися в контакте с пациентом	26.60.13	9018 19 9018 90 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90		Идентификация конструкции	-	
							Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчиво / не устойчиво	
							Электробезопасность:		
							- токи утечки	Не более 0,5 мА	
							Комплектность	Соответствует/не соответствует	
							Маркировка	Соответствует/не соответствует	
							Упаковка	Соответствует/не соответствует	

360.	ГОСТ 30324.8	Терапевтические рентгеновские аппараты	26.60.13	9022 19	Классификация Обозначение, маркировка и документы Излучение утечки Максимально допустимая мощность воздушной кермы Комплектность Маркировка Упаковка	- Соответствует/не соответствует 0 – 10 мГр 0,02 мГр в час Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
361.	ГОСТ 30324.15	Рентгеновские генераторы с накопительным конденсатором	26.60.11	9022 90	Идентификация: конструкции Электробезопасность: - разность потенциалов Комплектность Маркировка Упаковка	- Не менее 50 В Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
362.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-8	Аппараты рентгеновские терапевтические	26.60.13	9022 19	Идентификация: конструкции Излучение утечки Максимально допустимая мощность воздушной кермы Комплектность Маркировка Упаковка	- 0 – 10 мГр/с 0,02 мГр в час Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
363.	ГОСТ 26903	Пленки радиографические и флюорографические медицинских	20.59.11	3701 10 3702 10	Средний градиент	1-4,5 G
364.	ГОСТ ИЕС 60580	Измерители произведения дозы на площадь	26.60.1	9022 90	Эксплуатационные требования Минимальный эффективный диапазон произведения дозы на площадь Минимальный эффективный диапазон произведения мощности дозы на площадь	- $1,0 \cdot 10^{-1} - 1,0 \cdot 10^6 \text{ мГр} \cdot \text{м}^2$ $1,0 \cdot 10^{-2} - 1,0 \cdot 10^4 \text{ мГр} \cdot \text{м}^2/\text{с}$

					Эквивалентная фильтрация ионизационной камеры	Не более 0,5 мм
365.	ГОСТ Р МЭК 60627	Отсеивающие растры и маммографические отсеивающих растров		26.60.11	9022 90	Соответствует/не соответствует
366.	ГОСТ Р 53938	Наборы реактивов для химико- фотографической обработки медицинских рентгеновских плёнок		21.20.23	3006 30	Соответствует/не соответствует
367.	ГОСТ 4.178	Аппараты рентгеновские медицинские диагностические		26.60.11	9018 13 9018 14 3006 30 9022 13 9022 14 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Соответствует/не соответствует
368.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-1	Изделия медицинские электрические. Электронные ускорители, работающие в диапазоне от 1 до 50 МэВ		26.60.13	9022 90	Соответствует/не соответствует
369.	ГОСТ ИЕС 60601-2-1	Изделия медицинские электрические. Электронные ускорители, работающие в диапазоне от 1 до 50 МэВ		26.60.13	9022 90	Соответствует/не соответствует
370.	ГОСТ 4.490	Ускорители электронов для лучевой терапии		26.60.13 28.98.39	9022 21	-

371.	ГОСТ IEC 60976	Медицинские ускорители электронов.	26.60.13	9022 90	Угловые положения	Соответствует/не соответствует
					Расположение фантома	Соответствует/не соответствует
					Расположение точек измерения	Соответствует/не соответствует
					Поглощенная доза ионизирующего излучения	0,005 – 2,5 Гр
					Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения	0,003 – 3,0 Гр/мин
					Геометрические размеры светового поля и радиационного поля, симметрия распределения радиационного поля	0 – 40 мм
					Угловые положения	Соответствует/не соответствует
372.	ГОСТ Р МЭК 60976	Медицинские ускорители электронов.	26.60.13	9022 90	Расположение фантома	Соответствует/не соответствует
					Расположение точек измерения	Соответствует/не соответствует
					Поглощенная доза ионизирующего излучения	0,005 – 2,5 Гр
					Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения	0,003 – 3,0 Гр/мин
					Геометрические размеры светового поля и радиационного поля, симметрия распределения радиационного поля	0 – 40 мм
					Термины и определения	-
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
373.	ГОСТ Р 52103	Ускорители заряженных частиц	26.60.13	9022 90	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
374.	ГОСТ Р МЭК 62274	Системы записи и верификации лучевой терапии	26.60.12	9018 14 9022 90	Ток утечки на корпус	0 – 0,5 мА
					Скорость линейного движения	0 – 50 мм/с
					Информация, предоставляемая изготовителем аппарата для лучевой терапии	-
375.	ГОСТ 30324.11	Гамма-терапевтические аппараты	26.60.13	9022 21	Размер ограниченного радиационного поля	0 – 500 мм, 0 – 100 %
376.	ГОСТ Р МЭК 61859	Кабинеты лучевой терапии.	26.60.13	9022 30 9022 90		
377.	ГОСТ IEC 61168	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии.	26.60.13			

					Движение стола для пациента и штатива	0 – 1000 мм, 0 – 360°
					Расхождение светового и радиационного полей	0 – 500 мм, 0 – 100 %
378.	ГОСТ ИЕС/ТС 61170	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии.	26.60.13	9022 30 9022 90	Нормирование значений эксплуатационных характеристик	-
379.	ГОСТ 30324.2.29	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на землю	0 – 20 мА
					Ток утечки на корпус	0 – 0,5 мА
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	0 – ±50 мм
380.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-29	Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии	26.60.13	9022 30 9022 90	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на землю	0 – 20 мА
					Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения	0 – ±50 мм
381.	ГОСТ Р МЭК 61217	Аппараты дистанционные для лучевой терапии.	26.60.13	9022 30 9022 90	Координаты, перемещения и шкалы	-
382.	ГОСТ Р МЭК 62083	Системы планирования лучевой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90	Аспекты разработки, производства и размещения систем планирования лучевой терапии	-
383.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17	Аппараты для брахитерапии с автоматическим управлением	26.60.13	9022 90	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Мощность эквивалентной дозы	0 – 0,01 мЗв/ч
384.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-17-2017	Оборудование для брахитерапии, работающее по методу «афтерлодинг»	26.60.13	9022 21 9022 29	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Мощность эквивалентной дозы	0 – 0,01 мЗв/ч
385.	ГОСТ 24658	Аппараты радиоизотопные терапевтические	26.60.13	9022 21 9022 29	Работоспособность от сети электропитания	Работоспособны/не работоспособны

на 408 листах, лист 112

		внутриполостные для контактного облучения.				Время готовности 0 – 3 мин Устойчивость к климатическим и вибрационным воздействиям Устойчивы/не устойчивы Потребляемая мощность 0 – 2 кВт Усилие для перемещения органов управления 0 – 50 Н Мощность эквивалентной дозы излучения 0 – 8,34·10 ⁻⁹ Вт/кг Уровень звука 30 – 55 дБА Токи утечки на корпус 0 – 3 мА Путь тока утечки Не менее 1,7 мм Воздушный зазор Не менее 0,8 мм Электрическая прочность изоляции Испытательное напряжение 0,5 – удвоенное рабочее напряжение +1,5 кВ Длина заземляющего проводника Не менее 5 м
386.	ГОСТ 23643	Аппараты радиоизотопные терапевтические внутриполостные для контактного облучения	26.51.41	9030 10		Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от закрытого радионуклидного источника излучения (14 – 4480) · 10 ⁻⁹ А/кг, (Р/с) (55 – 1760) · 10 ⁻⁶ А/кг, (Р/с)
387.	ГОСТ 23154	Аппараты гамма-терапевтические статические и ротационные для дальнедистанционного облучения	26.60.12 26.60.13 20.13.13	9018 14 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90	Классификация Соответствует/не соответствует 2,58·10 ⁻⁴ – 7,74·10 ⁻⁴ А/кг Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от закрытого радионуклидного источника излучения 9; 12; 15; 20 мм Диаметр активной части источника 0 – 5 с Время перемещения затвора радиационной головки 75 – 150 см Расстояние от торца источника до стола Не менее 5 Количество независимых перемещений опорной панели стола ±180° Поворот опорной панели стола относительно его основания от среднего положения Не менее 70 см Продольное перемещение опорной панели стола Не менее ±90 см Поперечное перемещение	

388.	ГОСТ Р 56138	Протезы верхних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Вертикальное перемещение опорной панели стола	Не менее 40 см
					Минимальная высота опорной панели стола над уровнем пола	50 – 95 см
					Максимальная высота опорной панели стола над уровнем пола	115 – 135 см
					Длина опорной панели стола	Не менее 200 см
					Ширина опорной панели стола	Не менее 40 см
					Номинальное значение напряжения трехфазного переменного тока частоты 50 Гц	220/380 В
					Диапазон работы измерителя времени	0,1 – 99,9 мин
					Усилия для перемещения органов управления и узлов аппаратов	Не более 150 Н
					Корректированный уровень звуковой мощности звуковой сигнализации	Не менее 65 дБА
					Корректированный уровень звуковой мощности	30 – 65 дБА
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: классификация, материалы, комплектность	-
					Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Устойчивы/ не устойчивы
					Эргономические требования	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования:	
					- угол сгибания	40° – 60°
					- угол разгибания	165° – 170°
					- размеры	Соответствует/не соответствует

394.	ГОСТ 29097 п.5	Изделия корсетные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	15 кВ/м
395.	ГОСТ Р 54407	Обувь ортопедическая	32.50.22	9021 10	Размеры	68 – 108 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация:	-
					классификация, материалы	
					Линейные размеры обуви и ее деталей:	
					- высота обуви	Не менее 410 мм
					- высота задников	32 – 56 мм
					Высота каблук в детской обуви	0 – 30 мм
					Внешний вид готовой обуви	Соответствует/не соответствует
					Пороки обуви	0 – 10 мм
396.	ГОСТ Р 54739	Обувь ортопедическая	32.50.22	9021 10	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация:	-
					классификация, материалы	
					Размер (длина стопы)	105 – 305 мм
					Требования надежности	Соответствует/не соответствует
					Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести	Соответствует/не соответствует
					Конструктивные требования	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
397.	ГОСТ Р 57761 (раздел 3)	Обувь ортопедическая	32.50.22	9021 10	Идентификация	-

398.	ГОСТ Р 57890	Обувь ортопедическая профилактическая	32.50.22	9021 10	Номенклатура показателей	Соответствует/не соответствует
399.	ГОСТ Р 57765 (раздел 5, раздел 6, раздел 7 раздел 10, раздел 11 раздел 12 раздел 13)	Изделия протезно- ортопедические	32.50.22	9021 10	Идентификация внешний вид, показатели назначения Технические требования - усилие в локтевой тяге - угол между осями гильзы предплечья и плеча Устойчивость при транспортировании и хранении Комплектность Маркировка Упаковка	- 30 – 80 Н 165° – 170° Устойчиво /не устойчиво Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
400.	ГОСТ Р 57770 (раздел 5)	Матрацы ортопедические	32.50.50 32.50.22	3006 10	Идентификация внешний вид, внешний вид Масса Габаритные размеры: - длина - ширина Высота: - пружинный матрац - беспружинный матрац Основные параметры матрацев: - масса потребителя - диаметр пружины - количество пружин на м ²	- Соответствует/не соответствует 1860 – 2050 мм 600 – 1800 мм Не менее 180 мм Не менее 160 мм До 60 кг для мягких 60-90 кг для средней жесткости Более 90 кг для повышенной жесткости Не менее 60 мм для мягких Не менее 40 мм для средней жесткости Не менее 20 мм для повышенной жесткости 250 – 290 шт для мягких 500 – 580 шт для средней жесткости 1000 – 1160 шт для повышенной жесткости

401.	ГОСТ Р 57764 (раздел 8, п 8.6 п 8.2 -8.3 п.8.4 п. 8.23 п. 8.10 п.8.32)	Трости опорные и кости подмышечные	32.50.22 32.50.22	9021 10 6602 00	Идентификация внешний вид, показатели назначения Конструктивные требования: - масса опорной трости - масса костыля подмышечного - ширина рукоятки изделия Механические свойства Устойчивость при транспортировании и хранении Усиле управления элементами фиксации Комплектность Маркировка Упаковка	-
						0 – 1,5 кг
						0 – 3 кг
						Не менее 25 мм и не более 50 мм
						Соответствует/не соответствует Устойчиво /не устойчиво
						5 – 36 Н
402.	ГОСТ Р 57768	Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей	32.50.22	9021 10	Идентификация: конструкции и материалам Устойчивость при транспортировании и хранении Комплектность Маркировка Упаковка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
						-
						Устойчиво /не устойчиво
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
403.	ГОСТ Р 57771	Узлы электронные протезов верхних и нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 31	Идентификация: конструкции и материалам Устойчивость при транспортировании и хранении Комплектность Маркировка Упаковка	-
						Устойчивы /не устойчивы
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
404.	ГОСТ Р 51819	Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 31	Идентификация классификация, терминология	-
						Устойчивы/не устойчивы
405.	ГОСТ Р 53346	Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31	Стойкость к внешним воздействиям и живучести Конструктивные требования: - изгибающий момент в сагиттальной плоскости - испытательная сила Р Требования к голеностопным узлам: - регулируемое угловое перемещение шины-лапки в	Устойчивы/не устойчивы
						4 – 89 Н·м
						88 – 1461 Н
						Не более 20° в сторону тыльного сгибания и не более

409.	ГОСТ Р 53868	Узлы протезов нижних конечностей для детей	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31	- высота приподнятости носочной части колодки - стойкость к внешним воздействиям и живучести - Маркировка - Материал - Упаковка	- высота приподнятости носочной части колодки	Не менее 6 – 15 мм
						- стойкость к внешним воздействиям и живучести	Устойчиво/не устойчиво
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Материал	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						- Стойкость к внешним воздействиям и живучести - Конструктивные требования: - предельная испытательная сила при статических испытаниях до разрушения - максимальная испытательная сила при циклических испытаниях - усилия воздействия на рычаги замковых и регулировочных устройств - максимальная масса узлов - высота приподнятости пятки узла стопы - компенсирующий момент - материал	Устойчивы/не устойчивы
410.	ГОСТ Р ИСО 10328	Протезы нижних конечностей	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31		370 – 2250 Н	370 – 2250 Н
						250 – 610 Н	250 – 610 Н
						Не более 30 Н при переключении одной рукой / Не более 2 Н при переключении пальцем	Не более 30 Н при переключении одной рукой / Не более 2 Н при переключении пальцем
411.	ГОСТ Р ИСО 22675	Голеностопные узлы и узлы стоп протезов нижних конечностей	32.50.22 32.50.23	9021 10 9021 29 9021 31		0,10 – 0,60 кг (5±5) мм	0,10 – 0,60 кг (5±5) мм
						2 – 5 Н	2 – 5 Н
						Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
412.	РСТ РФСР 644	Изделия протезно-ортопедические	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31		300 МПа	300 МПа
						500 МПа	500 МПа
						Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Идентификация классификация и обозначение	-
						Предельная прочность	150 МПа
						Усталостная прочность	350 МПа
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Классификация протезно-ортопедических изделий	Соответствует/не соответствует
						Технические требования	Соответствует/не соответствует

413.	РСТ РСФСР 736	Костыли и трости опорные	32.50.22 32.50.22	9021 10 9021 90	Внешний вид Шероховатость поверхностей деревянных деталей, R_a Влажность древесины деталей для изготовления костылей Отклонение от прямолинейности по длине стоек Несимметричность боковых стоек к оси костыля	Соответствует/не соответствует 0 – 100 мкм 0 – 11% 0 – 2 мм 0 – 5 мм
414.	ГОСТ ISO 8319-1	Инструменты ортопедические. Ключи для винтов с шестигранным углублением в головке	32.50.22	9021 10	Размеры: - ширина по граням шестигранника - диаметр по выступам - длина шестигранной части Идентификация - материалы и марки металлов Твердость Требования к испытанию на крутящий момент	1,475 – 4,500 мм 1,650 – 5,130 мм Не менее 2 – 6 мм - 45 – 54 HRC Отсутствие разрушений или остаточных деформаций при минимальном крутящем моменте 0,7 – 12 Н·м
415.	ГОСТ ISO 8319-2	Инструменты ортопедические. Отвертки для винтов с одним шлицем, с крестообразным шлицем и крестообразным углублением в головке	32.50.22	9021 10	Маркировка Идентификация (виды отверток) Размеры: - толщина а - ширина b - материалы и классы - твердость - крутящий момент	Соответствует/не соответствует - 1,03 – 1,13 мм 4,8 – 5,6 мм - 48 – 50 HRC Отсутствие разрушения или наличия остаточной деформации при минимальном крутящем моменте 9,7 Н·м
416.	ГОСТ Р 51632	Технические средства реабилитации людей с	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10	Маркировка Общие положения Требования назначения Требования надежности	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

	ограничениями жизнедеятельности			8713 90 8714 20	Требования стойкости к внешним воздействиям	Устойчивы/ не устойчивы
417.	ГОСТ Р ИСО 11334-4	Трости с тремя или более ножками	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Требования к уровням шума, вибрации и радиопомех	Соответствует/не соответствует
					Масса переносных ТСР	Не более 20 кг на одно место
					Усилие нажатия приводного элемента	0 – 5 Н
					Усилие, необходимое для прижимания приводного элемента поворотных выключателей и переключателей ТСР	0 – 5 Н
					Размеры	Соответствует/не соответствует
418.	ГОСТ Р ИСО 11334-1	Костыли локтевые	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Уровень звукового давления звукового сигнализатора	Не более 20 дБ при частоте не более 1500 Гц
					Рукоятка: - ширина рукоятки	не менее 25 мм и не более 50 мм
					Секция ножек и наконечники: - диаметр части наконечника, которая соприкасается с опорной поверхностью	не менее 35 мм
419.	ГОСТ Р ИСО 11199-3	Ходунки с опорой на предплечье	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Ширина рукоятки	не менее 25 мм и не более 50 мм
					Ширина рукоятки	не менее 20 мм и не более 50 мм
					Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения	35 мм
420.	ГОСТ Р ИСО 9999	Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Идентификация классификация, терминология	-
					Идентификация: типы	-
421.	ГОСТ Р 57769 (раздел 4, раздел 5, п.5.1-5.6	Противопролежневые изделия - матрацы - подушки	32.50.50	3006 10	Основные параметры матрацев: - габаритные размеры	800×1900 мм – 2000 ×2000 мм
					- максимальная нагрузка	120 – 160 кг
					- давление компрессора (входящего в состав матраца)	40 – 100 мм.рт.ст.

п.5.7	раздел 8					Уровень шума, создаваемого компрессором (входящего в состав матраца)	30 – 50 дБА
						Основные параметры подушек:	
						- габаритные размеры	400×300 мм – 500 ×700 мм
						- максимальная нагрузка	100 – 110 кг
						- давление компрессора (входящего в состав матраца)	40 – 100 мм.рт.ст.
422.	ГОСТ Р 52871	Дисплеи для слабовидящих	26.20.17	8471 90		Уровень шума, создаваемого компрессором (входящего в состав матраца)	30 – 50 дБА
						Устойчивость к внешним воздействиям	Устойчивы /не устойчивы
423.	ГОСТ Р 52873	Синтезаторы речи для специальных компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению	26.20.16	8471 60		Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля дисплея	10 В/м в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц / 1 В/м в диапазоне частот от 2 до 400 Гц
						Требования к входным и выходным данным:	
424.	ГОСТ Р 51633	Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях	32.50.22 32.50.50	8713 90		- отсчеты сигнала	Формат РСМ 16 разрядное, моно
						- частота дискретизации	От 8000 до 44100 Гц
						- алгоритм работы программных средств	Соответствует/не соответствует
						Объемно- временные характеристики программных средств:	
						- процент загрузки центрального процессора	Не более 25% (при тактовой частоте процессора 3ГГц)
						- объем требуемой оперативной памяти	Не более 120 Мб
						Требования назначения	Соответствует/не соответствует
						Требования надежности	Соответствует/не соответствует
						Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
						Требования эргономики	Соответствует/не соответствует
424.	ГОСТ Р 51633	Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях	32.50.22 32.50.50	8713 90		Требования технологичности	Соответствует/не соответствует
						Конструктивные требования:	Соответствует
						- масса манипулятора	0 – 0,150 кг

на 408 листах, лист 123

						- максимальные осевые нагрузки на манипуляторе 50 Н
					- максимальное разведение консолей органов захвата 60 мм	
					- радиус внутреннего отверстия зацепа 50 – 70 мм	
					- масса устройства для сбора мусора 0 – 1 кг	
					- длина рукоятки устройства для сбора мусора 85 – 115 см	
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
425.	ГОСТ Р 51076 п.5.5	Тренажеры слухо-речевые реабилитационные	32.50.21	9019 10	Требования стойкости к внешним воздействиям	Устойчиво/не устойчиво
426.	ГОСТ Р 50918	Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля	26.20.16	8471 60	Число символов	Соответствует/не соответствует
					Размеры элемента символа на рабочей поверхности:	1, 4, 12, 20, 40, 80 в одной строке / 160, 320, 640 на многострочных устройствах
					- основной диаметр d	
					- высота h	1,5 – 1,7 мм
					- разброс элементов символов	0,5 – 0,6 мм
					- основной шаг строк	Не более 0,1d мм по вертикали и не более 0,1d мм по горизонтали
					- основной шаг символов	10±0,25 мм для 6-точечного представления / 12,5±0,25 мм для 8-точечного представления
					- взаимное расположение соседних элементов символа (расстояние между центрами соседних элементов символа на рабочей поверхности)	6,0±0,25 мм
					- время отображения символов	2,4 – 2,6 мм
					- требования назначения	Не более 0,01; 0,005; 0,001 с
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Конструктивные требования	-

427.	ГОСТ Р 51261	Устройства опорные стационарные реабилитационные				Комплектность	-
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Указания по эксплуатации	-
						Типы	-
428.	ГОСТ Р ИСО 18113-1	Информация, предоставляемая изготовителем - маркировка медицинских изделий - эксплуатационная документация	32.50.50		9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Общие технические требования: - минимальная длина свободного участка	Соответствует/не соответствует
						- форма и размеры	Не менее 100 мм для захвата всей кистью руки
						- расстояние между опорным устройством и ближайшим элементом оборудования или стенками помещения	Соответствует/не соответствует
						- поверхность опорных устройств	Не менее 40 мм
						- прочность	Соответствует/не соответствует
						Общие требования к информации, предоставляемой изготовителем:	
						- символы и окраски для идентификации	Соответствует/не соответствует
						- значения и номенклатура	Соответствует/не соответствует
						- микробиологический статус	Соответствует/не соответствует
						- инструкции по применению	Соответствует/не соответствует
						- изменения в медицинском изделии для диагностики <i>in vitro</i>	Соответствует/не соответствует
						- обнаружение остаточных рисков	Соответствует/не соответствует
						- идентификация компонентов	Соответствует/не соответствует
						- оказание помощи	Соответствует/не соответствует
						- содержание этикетки внешнего контейнера (упаковки)	Соответствует/не соответствует

429.	ГОСТ Р ИСО 18113-2	Информация, предоставляемая изготовителем - маркировка медицинских изделий - эксплуатационная документация	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Общие требования к информации, предоставляемой изготовителем: - содержание этикетки внутренней упаковки - содержание инструкций по применению - этикетка и маркировка	Соответствует/не соответствует
430.	ГОСТ Р ИСО 18113-3	Информация, предоставляемая изготовителем - маркировка медицинских изделий - эксплуатационная документация	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Содержание инструкции по применению	Соответствует/не соответствует
431.	ГОСТ Р ИСО 18113-5	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Инструменты для диагностики in vitro для самотестирования	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 10 9021 10 9021 29 9021 31	Идентификация компонентов Содержание этикетки и маркировки Построение и изложение инструкции по применению Содержание инструкции по применению Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/отсутствие информации Наличие/отсутствие идентификации Наличие/отсутствие информации Наличие/отсутствие информации Наличие/отсутствие информации
432.	ГОСТ ISO 15197	Системы диагностические in vitro. Системы мониторинга наблюдения за концентрацией глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета	32.50.50	9018 90 9402 90 8713 10 8713 90 8714 20	Идентификация: конструкции и материалов	Наличие/отсутствие информации
433.	ГОСТ Р ИСО 15197	Системы мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета	32.50.50 26.20.17 26.20.16	3006 10 8471 90 8471 60	Устойчивость при транспортировании и хранении Проверка электропитания Комплектность Маркировка Упаковка Описание изделия и его технических характеристик, включая варианты	Устойчивы/не устойчивы 12 – 32 В Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

					(конфигурации) и принадлежности	
434.	ГОСТ Р 56894	Медицинские изделия для диагностики in vitro	26.60.12	9027 10 3822 00	Таблица соответствия общим принципам	Соответствует/не соответствует
					Основные результаты анализа и управления риском	Соответствует/не соответствует
					Информация по проектированию и производству	Соответствует/не соответствует
					Деятельность по верификации и валидации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: тип	Соответствует/не соответствует
435.	ГОСТ Р EN 13612	Медицинские изделия для диагностики in vitro	32.50.22 32.50.50	8713 90	Устойчивость при транспортировании и хранении	Устойчивы /не устойчивы
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	
					Упаковка	
					Критерии конструкции	
436.	ГОСТ Р EN 13532	Медицинские изделия для диагностики in vitro для самотестирования	26.60.12	9027 10	Маркировка и информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные характеристики, безопасность	Соответствует/не соответствует
437.	ГОСТ ISO 17593	Системы мониторинга in vitro для самотестирования при пероральной терапии антикоагулянтами	26.60.12	9027 10	Интервал измерения	от 1,0 до 6,0 МНО
					Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/отсутствие информации
					Рабочие характеристики:	Соответствует/не соответствует
					- среднее значение МНО	
					- среднеквадратичное отклонение воспроизводимости	Соответствует/не соответствует
					- смещение	Соответствует/не соответствует
					- повторяемость	Соответствует/не соответствует
					Механическая устойчивость против удара, вибрации и сдвигания	Соответствует/не соответствует
					Пределы воздействия температуры	Соответствует/не соответствует
438.	ГОСТ Р EN 14254	Изделия медицинские для диагностики in vitro.	29.20.21	8609 00	Номинальная вместимость жидкости	±10% номинальной вместимости

439.	ГОСТ ISO 7886-1	Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Шприцы для ручного использования	32.50.13	9018 31	Линии градуировки и заполнения	Соответствует/не соответствует
						Протекание жидкости	Наличие/отсутствие
						Конструкция крышки	Соответствует/не соответствует
						Видимость содержимого	Соответствует/не соответствует
						Пригодность этикетки для маркировки	Соответствует/не соответствует
						Прочность конструкции	Соответствует/не соответствует
						Устойчивость к центрифугированию	Устойчивы / не устойчивы
						Наличие острых краев, выступов, шероховатостей	Соответствует/не соответствует
						Маркировка этикетки	наличие/отсутствие
						Информация, предоставляемая изготовителем	Наличие/отсутствие информации
						Чистота	Соответствует/не соответствует
						Смазка	Соответствует/не соответствует
						Номинальная вместимость	Соответствует/не соответствует
						Максимальное «мертвое» пространство	0,07 – 0,20 мл
						Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости	Не менее 75 мм
						Деление шкалы	0,05 – 5,0 мл
						Вместимость между линиями градуировки с числами	0,1 – 10 мл
						Усилие при испытаниях на герметичность	0,25 – 300 кПа
						Длина цилиндра	Соответствует/не соответствует
						Длина выступающего штока	8 – 12,5 мм
						Посадка поршня в цилиндре	Соответствует/не соответствует
						Линия отсчета	Соответствует/не соответствует
						Положение наконечника на конце цилиндра	Соответствует/не соответствует
						Диаметр центрального	Не менее 1,2 мм

440.	ГОСТ Р ИСО 7886-2	Шприцы инъекционные однократного применения	32.50.13	9018 31	отверстия наконечника Упаковка, маркировка Размеры шприца Шток и поршень: - конструкция - посадка поршня в цилиндре Просвет наконечника Максимальная временная задержка Отклонение объемной скорости потока Податливость шприца: - максимальный вытесненный объем жидкости Усилие перемещения штока: - усилие инициации движения - максимальное поддерживающее усилие - максимальное отклонение усилия перемещения Упаковка Маркировка	- 2 – 10 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не менее 1,2 мм 0 – 10 мин $\pm 2\% / \pm 5\%$ 0,03 – 2,1 мл 30 Н 15 – 20 Н 10% – 20% - -
441.	ГОСТ ISO 7886-3	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Шприцы для иммунизации фиксированной дозой, автоматически приходящие в негодность после применения	32.50.13	9018 31	Номинальная вместимость Максимальный объем «мертвого» пространства Градуировка шкалы Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Устройство автоматического приведения шприца в негодность Упаковка, маркировка Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Упаковка, маркировка Номинальный объем Размеры	0,05 – 2 мл 0,025; 0,07 мл Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует -
442.	ГОСТ ISO 7886-4	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению	32.50.13	9018 31	Упаковка, маркировка Размеры цилиндра Конструкция шток-поршень Упаковка, маркировка Номинальный объем Размеры	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует -
443.	ГОСТ 22967	Шприцы медицинские инъекционные многократного	32.50.13	9018 31	Упаковка, маркировка Номинальный объем Размеры	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 1 – 100 см ³ 10 – 245 мм

444.	ГОСТ 25046	Иглы инъекционные однократного применения	32.50.13	9018 32	Цена деления	0,1 – 5 см ³
					Прочность при растяжении	Не менее 8,6 МПа
					Относительное растяжение	Не менее 300%
					Остаточное растяжение	Не менее 5%
					Твердость по Шору	60±5
					Герметичность соединения стеклянного цилиндра с наконечником и поршня с цилиндром	Наличие/отсутствие протечек Нагрузка 150 – 300 кПа
					Номинальный диаметр цилиндра	5 – 40 мм
					Шероховатость поверхности шпирцев	Не более 0,63 мкм
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
445.	ГОСТ ISO 7864	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	32.50.13	9018 32	Устойчивость к обработке	Устойчивы/не устойчивы
					Типы и основные размеры	0,4×10 – 1,2×50 мм
					Диаметр иглы	(0,4 – 1,2) ±0,04 мм
					Длина трубки иглы	9 – 50 мм
					Угол заточки иглы	10° – 20°
					Шероховатость наружной поверхности	Не более Ra 0,16 мкм
					Отклонение трубки от оси головки	±3°
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Чистота	Соответствует/не соответствует
					pH экстракта иглы	1 – 14
					Дефекты на трубке иглы	Наличие/отсутствие
					Смазка на трубке иглы	Соответствует/не соответствует
					Угол заточки иглы	(11±2)°; (17±2)°
					Прочность соединения головки и трубки иглы	Испытательная нагрузка 22 – 69 Н
					Проходимость просвета (канала трубки иглы)	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка	-
					Твердость	HV 4750 – 6100 Н/мм ² (HRC 47,4 – 55,3)
					Шероховатость поверхностей	Ra: от 0,32 до 0,63 мкм

446.	ГОСТ 25981	Иглы хирургические	32.50.13	9018 32	Ширина режущих ребер	Rz: 20 мкм
					Маркировка, упаковка	0,1 – 0,33 мм
					Соответствует/не соответствует	Соответствует
					Масса	10 – 500 г
447.	ГОСТ 26641	Иглы атрауматические	32.50.13	9018 32	Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
					Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	Устойчивы/ не устойчивы
					Твердость	HV 4900 – 6475 Н/мм ² (HRC 47,4 – 55,3)
					Параметры шероховатости поверхностей	Ra: 0,32 – 0,63 мкм Rz: 10 – 20 мкм
					Ширина режущих ребер	0,1 – 0,33 мм
					Остаточная деформация	0,01 – 0,05
					Продолжительность испытаний	60 – 65 мин
					Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	-
					Твердость	HV 4900 – 6475 Н/мм ²
					Шероховатость поверхностей	Ra: 0,3 – 0,32 мкм Rz: 10 – 20 мкм
					Острота колошей части	0,02 – 0,025 мм
448.	ГОСТ ISO 8836	Катетеры аспирационные для респираторного тракта	32.50.13	9018 90	Ширина режущих ребер	0,02 – 0,025 мм
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Прочность закрепления нити	1,00 – 8,00 Н
					Цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
					Основные размеры:	
					- номинальный наружный диаметр	1,33 – 6,67 мм
					- минимальный внутренний диаметр	0,55 – 4,3 мм
449.	ГОСТ ISO 10555-1	Катетеры внутрисосудистые	32.50.13	9018 90	Минимальное усилие, необходимое для отделения любого компонента, постоянно соединенного с катетером	5 – 20 Н
					Маркировка	-
					Чистота поверхности	Соответствует/не соответствует

454.	ГОСТ Р ИСО 11070	Интродьюсеры однократного применения стерильные	32.50.13	9018 90	Скорость потока	от 80 % до 125 % скорости, указанной изготовителем для катетеров номинальным наружным диаметром менее 1,0 мм или от 90 % до 115 % скорости, указанной изготовителем для катетеров номинальным наружным диаметром 1,0 мм и более
					Информация, предоставляемая изготовителем	-
					Отсутствие посторонних включений на поверхности	Соответствует/не соответствует
					Коррозионная стойкость	Стойкие/не стойкие
					Информация, предоставляемая изготовителем	-
455.	ГОСТ Р 57629	Магистраль инфузионные однократного применения	32.50.21	9018 90	Острые иглы	Соответствует/не соответствует
					Прочность соединения трубки иглы и соединительной втулки иглы	Соответствует/не соответствует при нагрузке до 20 Н
					Минимальная сила разрыва при оценке прочности соединения между интродьюсерным катетером и соединительной втулкой	3 – 15 Н
					Загрязненность частицами:	
					- количество частиц	Не более предельного значения индекса загрязнения, равного 90
					- размер частиц	От 25 мкм более 100 мкм
					- весовой коэффициент	От 0,1 до 5
					Утечки	Изделия должны обеспечивать отсутствие утечек воздуха при положительном и отрицательном внутреннем давлении
					Прочность при растяжении	Не менее 15 Н в течение 15 с
					Размеры иглы для прокола крышки ёмкости	0 – 29 мм
					Длина трубки от дистального конца до капельной камеры	Не менее 1500 мм

					Расстояние между окончанием каплеобразующего элемента и выходным отверстием капельной камеры	Не менее 40 мм
					Расстояние между окончанием каплеобразующего элемента и жидкостным фильтром	Не менее 20 мм
					Расстояние между стенкой капельной камеры и стенкой каплеобразующего элемента	Не менее 5 мм
					Роликовый зажим	-
					Объемная скорость потока	Истечение 1000 мл раствора NaCl с высоты 1 м в течение 10 мин
					Инъекционный узел	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
456.	ГОСТ Р ИСО 6009	Иглы инъекционные одноразового применения	32.50.13	9018 32 9018 39	Идентификация: цветовое кодирование	-
457.	ГОСТ Р ИСО 9626	Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских игл	32.50.13	9018 32 9018 39	Шероховатость поверхности	Соответствует/не соответствует
					Чистота	Соответствует/не соответствует
					Размеры:	
					- наружный диаметр	0,203 – 3,500 мм
					- внутренний диаметр	0,089 – 2,819 мм
					Сопротивление изгибу:	
					- усилие на изгиб	1,1 – 60,1 Н
					Сопротивление излому:	
					- расстояние между жесткой опорой и точкой приложения силы изгиба	5,9 – 31,6 мм
					Сопротивление коррозии	Соответствует/не соответствует
458.	ГОСТ 25377	Иглы инъекционные многократного применения	32.50.13	9018 32	Идентификация: внешний вид	
					Диаметр	0,4 – 2,5 мм
					Длина	10 – 200 мм
					Угол заточки	13° – 32°
					Диаметр мандрена	Не менее 0,10 – 1,75 мм
					Толщина стенки	0,13 – 0,33 мм
					Радиус кривизны мандрена	Не менее 30 – 80 мм
					Усилие прокола	Не более 0,35 – 2,80 Н
					Осевая нагрузка	Не менее 25 – 80 Н

459.	ГОСТ ISO 8537			Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглой или без иглы для инсулина	32.50.13	9018 31 9018 31		Соосность	Не более 3°
								Шероховатость Ra	Не более 0,16 мм
460.	ГОСТ 4.183				32.50.13	9018 32		Устойчивость к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации	Соответствует/не соответствует
								Стойкость к механическим воздействиям при транспортировании	Соответствует/не соответствует
								Маркировка, упаковка	-
								Чистота	Соответствует/не соответствует
								Смазка шприцев и игл	Наличие/отсутствие капель
								Размеры:	
								- номинальная вместимость	0,3 – 2,0 мл
								- минимальная длина шкалы	41 – 60 мм
								- цена деления шкалы	0,5/1/2 единицы
								- градуировочная шкала	Градуировочные линии должны быть постоянной толщины от 0,2 до 0,4 мм. Минимальная высота символов должна быть 3 мм
								Цилиндр:	Соответствует/не соответствует
								- размеры	Соответствует/не соответствует
								- упоры для пальцев	Соответствует/не соответствует
								Шток-поршень:	Соответствует/не соответствует
								- конструкция	Соответствует/не соответствует
								- посадка поршня в цилиндре	Соответствует/не соответствует
								Наконечник:	Соответствует/не соответствует
								- коническое соединение	Соответствует/не соответствует
								- положение наконечника цилиндра	Соответствует/не соответствует
460.	ГОСТ 4.183				32.50.13	9018 32		- трубка игл и иглы	Соответствует/не соответствует
								Рабочие характеристики собранного шприца:	
								- максимальное «мертвое» пространство	0,01 – 0,1 мл
								- отсутствие утечки в игле	Соответствует/не соответствует
								- утечка жидкости и воздуха через поршень	Соответствует/не соответствует
								Упаковка	Соответствует/не соответствует
460.	ГОСТ 4.183		Иглы стержневые		32.50.13	9018 32		Применимость показателей качества стержневых игл	-

461.	ГОСТ 4.310	Иглодержатели	32.50.13	9018 39	Применяемость показателей качества иглодержателей	-
462.	ГОСТ 7826	Ленты и диски диаграммные регистрирующих приборов	21.20.23 17.12.14	4823 40	Идентификация: типы Размеры Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
463.	ГОСТ 7717	Бумага диаграммная	21.20.23 17.12.14	4823 40	Ширина рулонов для бумаги Диаметр рулонов Масса бумаги площадью 1 м ² Толщина Степень проклейки Линейная деформация в среднем по двум направлениям	420 – 930 мм 600 – 800 мм 48 – 119 г 50 – 125 мм Не менее 1,2 – 2 мм Не более 0,2 % – 0,4 %
464.	ГОСТ 21643	Сшиватели медицинские	32.50.13	9018 49 9018 50 9018 90	Идентификация: классификация Материал Твердость Шероховатость Состояние поверхности Усилие, необходимое для осуществления прошивания или прошивания Усилие, необходимое для установки магазина в сшиватели Взаимозаменяемость матриц и магазинов Радиус скругления острия иглы Внешний вид иглы Ширина режущей кромки ножа Высота неровностей ножа Внешний вид лезвия Стойкость к коррозии Устойчивость к обработке, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистке, воздушной стерилизации	- Соответствует/не соответствует 30 – 61 HRC Не более 2,5 мкм Соответствует/не соответствует 0 – 250 Н 0 – 8 Н Соответствует/не соответствует Не более 0,03 мм Соответствует/не соответствует 1 – 8 мкм 1 – 10 мкм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчивы/не устойчивы

465.	СТ РК ИСО 3826-2 (ISO 3826-2, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00		Вибро- и ударопрочность	Соответствует/не соответствует
						Маркировка, упаковка	Соответствует/не соответствует
						Графические символы	Соответствует/не соответствует
466.	СТ РК ИСО 3826-3 (ISO 3826-3, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00		Размеры:	
						- номинальная вместимость	100 – 600 мм
						- ширина	75 – 120 мм
						- высота	120 – 185 мм
						- условные обозначения	Соответствует/не соответствует
						- конструкция	Соответствует/не соответствует
						Физические требования к индивидуальным пластмассовым (пластиковым) контейнерам и встроенным элементам:	Соответствует/не соответствует
						- стерилизация	Соответствует/не соответствует
						- прозрачность	Соответствует/не соответствует
						- окраска	Соответствует/не соответствует
						- тепловая стабильность	Соответствует/не соответствует
						- перенос водяного пара	Соответствует/не соответствует
467.	СТБ ИСО 3826-3 (ISO 3826-3, IDT)	Контейнеры гибкие полимерные для человеческой крови и ее компонентов	29.20.21	8609 00		- сопротивление утечке	Соответствует/не соответствует
						- загрязнение микрочастицами	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Размеры:	
						- номинальная вместимость	100 – 600 мм
						- ширина	75 – 120 мм
						- высота	120 – 185 мм
						- условные обозначения	Соответствует/не соответствует
						- конструкция	Соответствует/не соответствует
						Физические требования к индивидуальным пластмассовым (пластиковым) контейнерам и встроенным элементам:	
						- стерилизация	Соответствует/не соответствует
						- прозрачность	Соответствует/не соответствует
						- окраска	Соответствует/не соответствует
						- тепловая стабильность	Соответствует/не соответствует

на 408 листах, лист 131					
				- перенос водяного пара - сопротивление утечке - загрязнение микрочастицами Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
				Идентификация (классификация, маркировка) Идентификация (классификация, маркировка)	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
468.	ГОСТ 19433	Грузы опасные	-	-	-
469.	ГОСТ ISO 9585	Имплантаты для хирургии. Металлических пластинок для скрепления отломков кости	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
470.	ГОСТ 31621	Имплантаты для хирургии. Эндопротез тазобедренного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
471.	ГОСТ 31615	Имплантаты для хирургии. Фосфатно-кальциевые и металлические покрытия	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ 31514	Протезы кровеносных сосудов	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90	Соответствует/не соответствует Со

		сустава частичные и тотальные.		9021 29 9021 31 9021 39 9021 90		Прочностные свойства	Наличие / отсутствие дефектов
474.	ГОСТ Р ИСО 7206-6	Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90		Сопротивление статической нагрузке	Соответствует/не соответствует
475.	ГОСТ Р ИСО 7206-10	Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90		Поверхность	Наличие/ отсутствие дефектов
476.	ГОСТ 31619	Эндопротезы молочных желез	32.50.22	9021 29 9021 39		Масса	Отклонение от номинальной не более $\pm 3\%$
						Высота, ширина и профиль	Отклонение от номинальных не более $\pm 10\%$
						Прочность	Соответствует/не соответствует
						Предел прочности оболочки	Не менее 3 МПа
						Относительно удлинение при разрыве	Не менее 350%
						Соединение оболочки эндопротеза и накладки, герметизирующей технологическое отверстие	Должно выдерживать растяжение на 300% в течение 10 с
477.	ГОСТ Р ИСО 14242-2	Имплантаты для хирургии. Тотальные эндопротезы тазобедренного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90		Износ	Соответствует/не соответствует
478.	ГОСТ Р 56332	Имплантаты для хирургии. Гидроксипатит	32.50.22	3006 10 3006 40 3006 70		Прочность сцепления покрытия из гидроксипатита	Соответствует/не соответствует
479.	ГОСТ 31580.2	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы.	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90		Задняя вершинная рефракция	От $0 \pm 0,3$ до св. $30 \pm 1,0$
						Разрешающая способность	не менее 60%
480.	ГОСТ 31580.3	Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы.	32.50.22	9021 29 9021 39 9021 90		Допускаемые отклонения размеров	$\pm(0,05 - 0,45)$ мм
						Сила сжатия	Соответствует/не соответствует

					Смещение оси в сжатом состоянии	Соответствует/не соответствует
					Оптическая децентрация	Соответствует/не соответствует
					Оптический наклон	Соответствует/не соответствует
					Угол контакта	Соответствует/не соответствует
					Уменьшение силы сжатия	Соответствует/не соответствует
					Продолжительность динамической нагрузки	Соответствует/не соответствует
					Прочность петель	Соответствует/не соответствует
					Однородность поверхности и материала	Соответствует/не соответствует
481.	ГОСТ 31617	Имплантаты для хирургии. Имплантируемые материалы	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
482.	ГОСТ Р 54936	Имплантаты для хирургии. Эндоэкспандеры.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Внешний вид	Наличие/отсутствие видимых дефектов
					Предел прочности при разрыве	Не менее 3 МПа
					Относительное удлинение при разрыве	Не менее 350%
					Остаточное удлинение	Не более 10%
					Прочность	Сохраняет/ не сохраняет герметичность
					Клапан	Должен выдерживать не менее 50 проколов инъекционной иглой наружным диаметром 0,8 мм
483.	ГОСТ Р ИСО 9326	Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные.	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
484.	ГОСТ Р ИСО 14243-1	Имплантаты для хирургии. Тотальные протезы коленного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует
485.	ГОСТ Р ИСО 14243-3	Имплантаты для хирургии. Тотальные протезы коленного сустава	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31 9021 39 9021 90	Износ	Соответствует/не соответствует

488.	ГОСТ Р ИСО 14708-3	Имплантируемые нейростимуляторы	32.50.21.121	9021 90 900 9	Идентификация: конструкция Устойчивость при транспортировании и хранении Характеристики импульса стимуляции Сопротивление проводника или кабеля-удлинителя при постоянном токе Комплектность Маркировка Упаковка	- Устойчиво /не устойчиво 5 – 500 Гц Не менее 500 Ом Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
489.	ГОСТ Р ИСО 14708-4	Имплантируемые инфузионные насосы	32.50.21.121	9021 39 900 0	Идентификация: конструкция Число частей Устойчивость при транспортировании и хранении	- 100 частей/мл Устойчиво /не устойчиво
490.	ГОСТ Р ИСО 14708-7	Системы кохлеарной имплантации	32.50.21.121	9021 40 000 0	Идентификация: конструкция Амплитуда выходного сигнала Полное сопротивление	- 2 – 5 В 10 кОм
491.	ГОСТ Р ИСО 14630	Имплантаты хирургические неактивные.	32.50.22	3006 10 9018 39 9021 31 9021 39 9021 90	Материалы Конструкция Стерилизация Упаковка Информация, предоставляемая производителем Этикетки Инструкция по эксплуатации Маркировка	Соответствует/не соответствует Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
492.	ГОСТ ISO 14602	Неактивные хирургические имплантаты. Имплантаты для остеосинтеза.	32.50.22	9021 31 9021 39	Функциональные характеристики Конструкция Материалы Стерилизация Упаковка Информация, предоставляемая изготовителем	- - - Устойчивы/ не устойчивы Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

					Маркировка	Соответствует/не соответствует
493.	ГОСТ Р ИСО 7206-1	Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные.	32.50.22	9021 31 9021 39	Идентификация: классификация Обозначение размеров	Соответствует/не соответствует
494.	ГОСТ Р ИСО 7206-2	Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и тотальные. Суставные поверхности, изготовленные из металлических, керамических и полимерных материалов	32.50.22	9021 31 9021 39	Бедренные компоненты тотального эндопротеза тазобедренного сустава: - сферичность - обработка поверхности - размерные допуски Полимерные vertлужные компоненты: - сферичность - обработка поверхности - размерные допуски Бедренный протез для частичной замены сустава: - сферичность - обработка поверхности - размерные допуски Отклонение от сферичности не более 100 мкм Ra не более 0,05 и 0,02 мкм Минус 0,2 – 0 мм Отклонение от сферичности не более 100 мкм Ra не более 2 мкм 0,1 – 0,3 мм Отклонение от сферичности не более 100 мкм Ra не более 0,5 мкм ±0,5 мм Ra не более 0,5 мкм	Соответствует/не соответствует
495.	ГОСТ Р ИСО 21534	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов.	32.50.22	9021 31 9021 39	Идентификация: общие требования, материалы - обработка поверхности металлических или керамических имплантатов, сочленяющихся с компонентами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена - обработка поверхности металлических или керамических частичных протезов - поверхности сферических металлических или керамических имплантатов, сочленяющихся с компонентами	Соответствует/не соответствует

					- поверхности сферических металлических или керамических частичных протезов	Ra не более 10 мкм
					- поверхности сферических вогнутых компонентов	Ra не более 0,5 мкм
					- конструкция	Ra не более 2 мкм
					Стерилизация	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Устойчивы/ не устойчивы
					Информация, предоставляемая производителем	Соответствует/не соответствует
496.	ГОСТ Р ИСО 7207-1	Имплантаты для хирургии. Бедренный и большеберцовый компоненты частичных и тотальных эндопротезов коленного сустава.	32.50.22	9021 31 9021 39	Идентификация: классификация	-
497.	ГОСТ Р ИСО 7207-2	Имплантаты для хирургии. Компоненты частичных и тотальных эндопротезов коленного сустава. Суставные поверхности, изготовленные из металлических, керамических и полимерных материалов	32.50.22	9021 31 9021 39	Обозначение размеров	Соответствует/не соответствует
498.	ГОСТ Р 57386 (ГОСТ Р 57386/ISO/TR 14283)	Имплантаты для хирургии	32.50.21 32.50.22	9021 29 9021 50	- Тотальные эндопротезы коленного сустава: - параметр шероховатости Ra - Бедренные металлические или керамические эндопротезы для частичного замещения коленного сустава: - параметр шероховатости Ra	Не более 0,1 мкм
499.	ГОСТ Р ИСО 14607	Имплантаты молочных желез	32.50.21	9021 39	- Идентификация: конструкция - Устойчивость при транспортировании и хранении - Комплектность - Маркировка - Упаковка - Целостность оболочек: - удлинение - остаточное удлинение - прочность соединений, швов и спаек - исправность клапана и инъекционного порта	- Не более 0,5 мкм - - Устойчиво /не устойчиво - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Не менее 450% - Не более 10% - Должны выдерживать удлинение на 100% - 300% в течение 10 с - Не должно происходить никаких утечек

						- усталостная прочность	Соответствует/не соответствует при десятикратном увеличении	на 408 листах, лист 144
						- ударопрочность	Не должно быть повреждений	
						Информация для пользователя	Соответствует/не соответствует	
500.	ГОСТ Р ИСО 15142-1	Гвозди для остеосинтеза	32.50.22	9021 10		Идентификация: конструкция, материал	-	
						Комплектность	Соответствует/не соответствует	
						Маркировка	Соответствует/не соответствует	
						Упаковка	Соответствует/не соответствует	
501.	ГОСТ Р ИСО 15142-2	Составные части замков	32.50.22	9021 10		Идентификация: конструкция, материал	-	
						Комплектность	Соответствует/не соответствует	
						Маркировка	Соответствует/не соответствует	
						Упаковка	Соответствует/не соответствует	
502.	ГОСТ Р ИСО 21535	Имплантаты для протезирования тазобедренного сустава	32.50.22	9021 10 9021 31		Показатели назначения	Соответствует/не соответствует	
						Конструкция	Соответствует/не соответствует	
						Материалы	Соответствует/не соответствует	
						Стерилизация	Соответствует/не соответствует	
						Упаковка	Соответствует/не соответствует	
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	
503.	ГОСТ Р ИСО 21536	Имплантаты для протезирования коленного сустава	32.50.22	9021 10 9021 31		Показатели назначения	Соответствует/не соответствует	
						Конструкция	Соответствует/не соответствует	
						Материалы	Соответствует/не соответствует	
						Стерилизация	Соответствует/не соответствует	
						Упаковка	Соответствует/не соответствует	
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	
504.	ГОСТ 31585 (ISO 16671)	Имплантаты офтальмологические. Растворы ирригационные для офтальмологической хирургии	32.50.21	7018 90 3307 90		Буферная способность основания	Менее 0,0005 – Более 0,005 моль/л на pH	
						Буферная способность кислоты	Менее 0,004 – Более 0,04 моль/л на pH	

				Диапазон значений показателя pH	6,5 – 8,5	
				Спектральный коэффициент пропускания	300 – 1100 нм	
				Стерильность	Соответствует/не соответствует	
				Стабильность	Соответствует/не соответствует	
				Упаковка	Соответствует/не соответствует	
				Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	
505.	ГОСТ 31579 (ISO 15798)	Изделия офтальмологические вискохирургические	32.50.21	7018 90 3307 90	Соответствует/не соответствует	
				Сдвиговая вязкость	Соответствует/не соответствует	
				Упругость	Соответствует/не соответствует	
				Значение pH	Соответствует/не соответствует	
				Коэффициент пропускания	Соответствует/не соответствует	
				Показатель преломления	Соответствует/не соответствует	
				Стерильность	Соответствует/не соответствует	
				Стабильность	Соответствует/не соответствует	
				Целостность и характеристика комплекта доставки	Соответствует/не соответствует	
				Упаковка	Соответствует/не соответствует	
				Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	
506.	ГОСТ 31580.6 (ISO 11979-6)	Интраокулярные линзы	32.50.21	7018 90 3307 90	Соответствует/не соответствует	
507.	ГОСТ Р 51892	Интраокулярные линзы	32.50.21	7018 90	-	
508.	ГОСТ Р 50581 / ГОСТ 30399 (ISO 6475)	Металлические шурупы для костей с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью	32.50.22	9021 10 9021 90	0,2 – 6,2 Н·м	
				Минимальный крутящий момент на разрыв	90° – 180°	
				Минимальный угол поворота при повреждении (если открыто пять нитей резьбы)		
509.	ГОСТ ISO 8615	Неактивные хирургические имплантаты. Устройства, используемые для фиксации бедренных костей взрослых пациентов	32.50.22	9021 10 9021 90	-	
				Идентификация материалов	-	
				- типы гвоздей и фиксирующих винтов	-	
				Размеры:		
				- максимальная ширина гвоздей	16 мм	
				- максимальная глубина	6,5 мм	
				- полезная длина	50 – 150 мм	

510.	ГОСТ ISO 5836	Имплантаты для хирургии. Металлические пластинки для скрепления отломков кости. Отверстия под винты с асимметричной резьбой и сферической опорной поверхностью	32.50.22	9021 10 9021 90		- номинальный диаметр сквозного отверстия 2,0 мм / 2,2 мм / 2,8 мм - минимальный действующий диаметр сквозного отверстия 2,0 мм / 2,2 мм / 2,8 мм - минимальная толщина стенки сквозных отверстий 0,79 – 1,35 мм - полезная глубина резьбы гнезда под винт в головке гвоздя Не менее 8 мм - длина выступающей части головок с наружной винтовой резьбой Не более 20 мм - винтовая резьба гнезд под винт и выступающей части головок M6 / M8×1 / M7 / M10×1, с классом допуска 6H/6g - угол между бедренной пластиной и гвоздем или фиксирующим винтом - отверстия для винтов - зазор между внешней поверхностью скользящего гвоздя или винта и внутренней поверхностью втулки Дополнительные компоненты к составным фиксирующим устройствам Обработка поверхности Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует
						1 ⁰ -0,25 мм	
						-	
						1,6 – 6,8 мм	
						3,1 – 8,4 мм	
						Не менее 0,15 – 1,3 мм	
						0,2 – 1,4 мм	
						0,1 – 0,55 мм	
						1,3 – 3,5 мм	
						1,5 – 4,075 мм	
						30°±2° / 90°±2°	
						Соответствует/не соответствует	
						1,5 – 6,5 мм	
						1,1 – 8 мм	
						1,6 – 4,6 мм	
						0,1 – 4,25 мм	
						3° - 35°	
						1,5 – 3,558 мм	
						S _w	
511.	ГОСТ 30400 (ИСО 5835) / ГОСТ Р 50582 (ИСО 5835)	Имплантаты для хирургии. Металлические костные шурупы со специальной резьбой, сферической головкой и внутренним шестигранником под ключ	32.50.22	9021 10 9021 90		Код резьбы шурупов Номинальный диаметр d ₁ Диаметр головки шурупа d ₂ Высота головки k Радиусы скруглений Угловые размеры	Соответствует/не соответствует

512.	ГОСТ Р ИСО 17853	Имплантаты для хирургии. Имплантируемые материалы.	26.60.14	9021 90	f_{min} Износ	0,8 – 2,8 мм Соответствует/не соответствует
513.	ГОСТ Р ИСО 16054	Имплантаты для хирургии	26.60.14	9021 90	Идентификация наборов данных	-
514.	ГОСТ Р 50267.25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Ток утечки на пациента (сетевое напряжение на зажиме рабочего заземления: - рабочая часть типа В, ВF - рабочая часть типа CF Пути утечки и воздушные зазоры	Не более 5 мА Не более 0,05 мА Не менее 4 мм
515.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Функциональные характеристики Воздушный зазор разъема провода отведения между контактами соединителя и плоской поверхностью Входной импеданс Коэффициент усиления Амплитуда сигнала Длительность зубца Р Интервал PQ Длительность комплекса QRS Интервал QT Время восстановления Уровень шумов	Соответствует/не соответствует Не менее 0,5 мм Не менее 2,5 МОм Не менее 5 мм/мВ 0 – 1000 мкВ 0 – 100 мс 0 – 100 мс 0 – 100 мс 0 – 100 мс 0 – 10 с Не более 30 мкВ
516.	ГОСТ ИЕС 60601-2-51	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы	26.60.12	9018 11	Идентификация, маркировка и документация Отклонения разностей интервалов Цепи отведений. Допустимый размах Размах сигнала	- 5 – 30 мс 0 – 27 мм 10 – 28 мм
517.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27	Электрокардиографические мониторы	26.60.12	9018 11	Идентификация, маркировка и документация Функциональные характеристики Воздушный зазор разъема провода отведения между контактами соединителя и плоской поверхностью Входной импеданс	Соответствует/не соответствует Не менее 0,5 мм Не менее 2,5 МОм

518.	ГОСТ 30324.2.47	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12	9018 11	Коэффициент усиления	Не менее 9 мм/мВ
					Подавление синфазного сигнала	Размах не более 10 мм
					Амплитуда сигнала	0 – 1000 мкВ
					Длительность зубца Р	0 – 100 мс
					Интервал PQ	0 – 100 мс
					Длительность комплекса QRS	0 – 100 мс
					Интервал QT	0 – 100 мс
					Время восстановления	0 – 10 с
					Уровень шумов	Не более 30 мкВ
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Время восстановления	Не более 60 с
					Амплитуда сигнала	0 – 1000 мкВ
					Длительность зубца Р	0 – 100 мс
					Интервал PQ	0 – 100 мс
519.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-47	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12	9018 11	Длительность комплекса QRS	0 – 100 мс
					Интервал QT	0 – 100 мс
					Время восстановления	0 – 10 с
					Входной импеданс	Не более 10 МОм
					Коэффициент усиления	5 – 20 мм/мВ
					Уровень шумов	Не более 50 мкВ
					Динамический диапазон входного сигнала	0 – 300 мВ
					Входной импеданс	Более 10 МОм
					Подавление синфазной помехи	Не менее 45 дБ
					Время непрерывной работы	До 24 ч
					Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Линейность и динамический диапазон	Размах не более 6 мВ (при усилении 5 мм/мВ)
					Входной импеданс	Не менее 10 МОм
					Подавление синфазных помех	Не менее 45 дБ
520.	ГОСТ Р 50267.26	Электроэнцефалографы	26.60.12	9018 19	Стабильность усиления	Не более 3% в течение 24 ч
					Шум системы	Не более 50 мкВ
					Погрешность измерения времени	Не более 30 с
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на пациента	Не более 5 мА

521.	ГОСТ 30324.2.49	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12	9018 19	Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки на пациента	Не более 500 мкА
					Ток утечки на землю	Не более 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Уровень звукового давления сигнала тревоги	От 45 до 85 дБА
					Воздушный зазор между штырьками разъема и плоской поверхностью	Не менее 0,5 мм
					Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на пациента	Не более 500 мкА
522.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-49	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12	9018 19	Ток утечки на землю	Не более 10 мА
					Размеры ЭКГ-электродов	Не более 60 мм
					Диаметр токосъемной поверхности черепного электрода	Не более 12 мм
					Размеры игольчатых ЭМГ-электродов:	
					- диаметр иглы	0,30 – 1,14 мм
					- длина рабочей части иглы	19,0 – 91,5 мм
					- число поверхностей	1 – 14
					- форма	Соответствует/не соответствует
					- длина малой оси токосъемной поверхности электродов	0,019 – 0,165 мм
					- диаметр малой оси токосъемной поверхности электродов	0,019 – 0,031 мм
523.	ГОСТ 25995	Электроды для съема биоэлектрических потенциалов.	26.60.12	9018 11	Угол заточки вводимого в ткани конца иглы	13 – 17 °
					Размеры кожных ЭМГ-электродов:	
					- форма	Соответствует/не соответствует
					- размеры прямоугольника	5,4 – 460 мм
					- диаметр	5 – 10 мм

					- расстояние между токосъемными поверхностями Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции Разность электродных потенциалов Дрейф разности электродных потенциалов Напряжение шума Полное сопротивление электрода Время готовности Усилие, необходимое для сжатия группы присасывающихся электродов Вибропрочность Устойчивость в процессе эксплуатации, хранения и транспортирования Идентификация (термины и определения) Метрологические характеристики ГС, используемых при поверке мониторов Внешний вид индикации Длина деления Изменение показаний Начальное значение шкалы термометра Конечное значение шкалы термометра Цена деления шкалы Габаритные размеры: - длина - ширина Неразрывность жидкости при движении в капиллярной трубке Зазор между шкальной пластиной и капиллярной трубкой	6 – 140 мм Не менее 30 В Не менее 10⁹ Ом Не более 100 мВ Не более 250 мкВ Не более 30 мкВ Не более 5 · 10³ Не более 15 мин Не более 25 Н Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы - - Соответствует/не соответствует 0,25 – 1,75 мм Не более 1 с 32 °С – 35 °С 42 °С 0,1 °С 110 – 145 мм 10,5 – 13,5 мм Соответствует/не соответствует Не более 1 мм
524.	ГОСТ 24878	Электроды для съема биопотенциальных потенциалов	26.60.12	9018 11		Устойчивы/не устойчивы
525.	ГОСТ 8.628	Мониторы прикроватные.	26.60.12	9018 19		Устойчивы/не устойчивы
526.	ГОСТ Р 53228	Весы неавтоматического действия.	28.29.31	8423 30		Соответствует/не соответствует
527.	ГОСТ 302	Термометр медицинский максимальный стеклянный.	26.60.12	9018 19		Соответствует/не соответствует

528.	ГОСТ 31516	Термометры медицинские максимальные стеклянные.	26.60.12	9018 19	Смещение капиллярной трубки, выходящее за пределы длины наименьшей отметки шкалы	Наличие/отсутствие
					Внешний вид внутренней и наружной поверхностей капиллярной трубки	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид резервуара и оболочки термометра	Соответствует/не соответствует
					Продольное смещение шкальной пластины внутри оболочки	Наличие/отсутствие
					Ширина отметок шкалы	Не более 0,2 мм
					Длина деления шкалы	Не менее 0,7 мм
					Цвет числовых значений, отметки и надписи на шкальной пластине	Соответствует/не соответствует
					Предел допускаемой погрешности термометра	Не более $\pm 0,1$ °C
					Маркировка, упаковка	-
					Градуировка	Соответствует/не соответствует
					Начальное значение шкалы	32 °C – 35 °C
					Конечное значение шкалы	42 °C
					Цена деления шкалы	0,1 °C
					Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра	От плюсов 0,1 °C до минус 0,15 °C
					Неразрывность жидкости при движении в капиллярной трубке	Соответствует/не соответствует
					Смещение капиллярной трубки за пределы длины наименьшей отметки шкалы	Наличие/отсутствие
					Зазор между пластиной шкалы и капиллярной трубкой	0 – 1 мм
					Внешний вид внутренней и наружной поверхностей капиллярной трубки	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид резервуара и оболочки термометра	Соответствует/не соответствует
					Ширина отметок шкалы	0 – 0,2 мм
					Длина деления шкалы	Не менее 0,7 мм

					Цвет числовых значений, отметки и надписи на шкальной пластине	Соответствует/не соответствует
					Разрушение при воздействии нагрузки	Наличие/отсутствие
529.	СТБ EN 12470-1 (EN 12470-1, IDT)	Термометры жидкометаллические стеклянные максимальные	26.51.51	9025 11	Виды	Соответствует/не соответствует
					Шкала:	
					- минимальный диапазон измерения температуры	35,5°C – 42,0°C
					- цена деления	0,1 °C
					- максимально допускаемая погрешность	От минус 0,15°C до плюс 0,1°C
					Влияние времени погружения	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Виды	Соответствует/не соответствует
					Шкала:	
					- диапазон измерения	35,5°C – 40,4°C / 35,5°C – 42,0°C
					- цена деления	Не более 0,1°C
					Сохранение результата измерений	Сохранение показаний термометра в течение не менее 20 с после прекращения контакта термометра с участком тела и выдержки термометра при температуре окружающего воздуха в помещении (23±5)°C
					Восстановление	Обеспечивать возможность/невозможность восстановления работоспособности и точности термометра, если он частично или полностью активизирован
					Максимальная допускаемая погрешность при нормальных условиях	Не более 0,1°C; минус 0,2°C
					Пустые точки	Отсутствие/наличие двух смежных пустых точек.
530.	СТБ EN 12470-2 (EN 12470-2, IDT)	Термометры с фазовым изменением (точечная матрица)	26.51.51	9025 11 9025 19	Виды	Соответствует/не соответствует
					Шкала:	
					- диапазон измерения	35,5°C – 40,4°C / 35,5°C – 42,0°C
					- цена деления	Не более 0,1°C
					Сохранение результата измерений	Сохранение показаний термометра в течение не менее 20 с после прекращения контакта термометра с участком тела и выдержки термометра при температуре окружающего воздуха в помещении (23±5)°C
					Восстановление	Обеспечивать возможность/невозможность восстановления работоспособности и точности термометра, если он частично или полностью активизирован
					Максимальная допускаемая погрешность при нормальных условиях	Не более 0,1°C; минус 0,2°C
					Пустые точки	Отсутствие/наличие двух смежных пустых точек.

531.	СТБ ISO 80601-2-56 (ISO 80601-2-56, IDT)	Медицинские термометры для измерения температуры тела	26.51.51	9025 11	Количество пустых точек: не более 5% от общего количества точек конкретного термометра Датчик температуры должен быть гладко закруглен Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует	Механическая безопасность Маркировка Основные характеристики Идентификация, маркировка и документация Точность устройств управления и измерительных приборов Эксплуатационная пригодность Требования к характеристикам в лабораторных условиях Электромагнитная совместимость
532.	ГОСТ 22224	Динамометры ручные плоскострунные.	26.60.12	9018 19	3 – 120 даН 0,2; 1,0; 2,0 даН Не более 0,25 кг 0 – 130 мм Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует	Диапазон измерений Цена деления шкалы Масса Габаритные размеры Устойчивость к механическим воздействиям Устойчивость к воздействию климатических факторов Маркировка, упаковка
533.	ГОСТ 8.250	Термометры медицинские максимальные стеклянные.	26.60.12	9018 19	Безопасность	Безопасность
534.	ГОСТ 31515.1	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные.	26.60.12	9018 90	Размеры пневмокамеры манжет: - длина - ширина Максимальная погрешность измерения давления в манжете Влияние условий хранения на устройство при его эксплуатации Влияние температуры условий эксплуатации Информация, предоставляемая изготовителем	85 – 470 мм 28 – 190 мм ±3 мм рт.ст. Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Соответствует/не соответствует
535.	ГОСТ 31515.2	Сфигмоманометры (измерители артериального давления)	26.60.12	9018 90	Падение давления вследствие утечки воздуха	Не более 4 мм рт.ст.

536.	ГОСТ 31515.3	неинвазивные. Механические сфигмоманометры	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Электромеханические системы измерения давления крови	26.60.12	9018 90	Скорость снижения давления	2 – 5 мм рт.ст./с
						Быстрое срабатывание	Не более 10 с
						Расстояние между смежными штрихами шкалы	Не менее 0,7 мм
						Толщина штрихов шкалы	Не более 20% наименьшего деления шкалы
						Информация, представляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
537.	ГОСТ 30324.30	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом		26.60.12	9018 90	Утечка воздуха в пневматической системе	Не более 6 мм рт.ст./мин
						Скорость срабатывания	2 – 5 мм рт.ст.
						Быстрое срабатывание воздуха	Не более 10 с
						Влияние температуры, влажности в условиях эксплуатации и хранения	Устойчивы/не устойчивы
						Дискретность показаний цифрового индикатора	1 мм рт.ст.
538.	ГОСТ Р 50267.34	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления		26.60.12	9018 90	Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
						Классификация	-
						Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
						Ток утечки на корпус и пациента	Не более 0,5 мА
						Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
539.	ГОСТ Р 50267.23	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления		26.60.12	9018 90	Максимальное давление манжеты	Не более 300 мм р.ст.
						Время работы	Не более 180 с
						Время сбрасывания давления	Не менее 30 с
						Воздушные зазоры и пути утечки	Не менее 4 мм
						Классификация	-
						Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
						Ток утечки на пациента	Не более 0,05 мА
						Электрическая прочность изоляции	Испытательное напряжение 1500 В
						Время восстановления после разряда дефибриллятора	Не более 5 с
						Пути утечки и воздушные зазоры	Не менее 4 мм
						Классификация	-
						Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует

								Токи утечки	
								Не более 0,5 мА	Испытательное напряжение
540.	ГОСТ ISO 9918 п.6	Капнометры медицинские.	26.60.12	9018 19			Электрическая прочность изоляции	1500 В	Не более 0,6°С в течение более 20 с
							Превышение температуры контактирующей поверхности рабочей части		
							Площадь поперечного сечения проводников сетевых шнуров	Соответствует/ не соответствует	Не менее 0,5 мм ²
							Проверка сопроводительной документации	30 – 60 дБА	
							Уровень звука	Соответствует/ не соответствует	
541.	ГОСТ ISO 9919 п.6	Пульсовые оксиметры	26.60.12	9018 19			Маркировка	Соответствует	
							Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует	
							Удар и вибрация	Соответствует/не соответствует	
							Маркировка	Соответствует/ не соответствует	
							Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует	
542.	ГОСТ 31513 п.6	Мониторы для контроля содержания кислорода в дыхательной смеси для пациента.	26.60.12	9018 19			Маркировка	Соответствует/ не соответствует	
							Проверка сопроводительной документации	Соответствует	
							Маркировка	Соответствует/ не соответствует	
							Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует	
							Маркировка	Соответствует/ не соответствует	
543.	ГОСТ 27072 п.2.32	Генераторы сигналов диагностические звуковые. Аудиометры.	26.60.12	9018 19			Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/ не устойчивы	
							Идентификация: конструкции	-	
							Электробезопасность:		
							- напряжение	110 – 320 В	
							- переменный ток	2 – 30 А	
544.	ГОСТ 30324.23	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12	9018 19			- токи утечки	Не более 0,5 мА	
							Комплектность	Соответствует/не соответствует	
							Маркировка	Соответствует/не соответствует	
							Упаковка	Соответствует/не соответствует	
							Идентификация: конструкции	-	
545.	ГОСТ 30324.25	Электрокардиографы	26.60.12	9018 11			Электробезопасность:		
							- токи утечки на рабочую часть	не более 0,05 мА	
							Комплектность	Соответствует/не соответствует	

546.	ГОСТ 30324.26	Электроэнцефалографы	26.60.12	9018 19	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
547.	ГОСТ 30324.34	Приборы для прямого мониторинга кровяного давления	26.60.12	9018 90	Идентификация: конструкции	-
					Электробезопасность:	3-5 кВ
					- электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Идентификация: конструкции	-
					Электробезопасность:	110 – 320 В
					- напряжение	2 – 30 А
					- переменный ток	Не более 0,5 мА
548.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37	Изделия медицинские электрические. Ультразвуковая медицинская диагностическая и контрольная аппаратура	26.60.12	9018 12	- токи утечки	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Классификация	-
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки в цепи пациента	Соответствует/не соответствует
					Дополнительный ток в цепи	Соответствует/не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
					Циклическое воздействие температуры	Соответствует/не соответствует
549.	ГОСТ Р 8.605	Приборы медицинские	26.60.12	9018 12	Соединенные кабелем портативные части и работающие от ножного привода устройства управления	Соответствует/не соответствует
					Ультразвуковая энергия	Соответствует/не соответствует
					Прикладываемые части, не предназначенные для передачи тепла пациенту	Соответствует/не соответствует
					Рабочее расстояние	Соответствует/не соответствует

		ультразвуковые диагностические. Доплеровские приборы непрерывной волны				Верхняя граница полосы частот Влияние неподвижной мишени на чувствительность Избирательность по направлению Уровень шума Нижняя граница полосы частот Нелинейные искажения Влияние противоположного движения на избирательность прибора по направлению										Соответствует/не соответствует
550.	ГОСТ Р МЭК 61391-1	Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое.	26.60.12	9018 12		Длины прямых линий Длины кривых линий Окружности Площади Объемы Искажения изображения и регистрации Калибровка М-режима										Соответствует/не соответствует
551.	ГОСТ Р МЭК 61391-2	Оборудование медицинское ультразвуковое диагностическое.	26.60.12	9018 12		Максимальная глубина зондирования Динамический диапазон Механический индекс Тепловой индекс										Соответствует/не соответствует
552.	ГОСТ Р МЭК 62359	Оборудование медицинское. Медицинские приборы ультразвуковой диагностики	26.60.12	9018 12												Соответствует/не соответствует
553.	ГОСТ Р 8.604	Приборы медицинские. ультразвуковые диагностические. Мониторы акушерские портативные для измерения параметров сердцебиения плода	26.60.12	9018 12		Частота акустического воздействия Безопасность Выходная мощность Пространственный и временной пик акустического давления Эффективная площадь активного элемента преобразователя Чувствительность Уровень звукового давления										±15% от номинального значения Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
554.	ГОСТ 12.4.077	Ультразвук	26.60.12	9018 12												Соответствует/не соответствует
555.	ГОСТ 23702	Преобразователи ультразвуковые	26.60.12	9018 12		Отклонение эффективной частоты эхоимпульса и (или) частоты максимума преобразования Отклонение угла ввода от номинального значения:										Не более ±10(20)% от номинального значения

556.	ГОСТ Р 55808	Преобразователи ультразвуковые	26.60.12	9018 12	- для угла ввода до 60° - для угла ввода свыше и равного 60° - отклонение точки ввода от номинального значения Время распространения звука в призме Электрическое сопротивление Фокусное расстояние и протяженность фокальной области	Не более $\pm(1,5-5)^\circ$ Не более $\pm(2-5)^\circ$ Не более $\pm(1-2)$ мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
					Эффективная частота эхоимпульса	Соответствует/не соответствует
					Импульсные характеристики	
					Электрическое сопротивление	
					Время распространения звука в призме	
557.	ГОСТ Р 8.616	Средства измерений мощности ультразвука в воде	26.60.12	9018 12	Углы ввода	Диапазон частот от 0,5 до 12 МГц
558.	ГОСТ Р МЭК 61161	Ультразвук в жидкостях	26.60.12	9018 12	Мощность ультразвука в воде	Диапазон частот от 0,5 до 25 МГц
559.	ГОСТ 25052	Аппараты для ультразвуковой терапии.	26.60.12 26.60.13	9018 90	Классификация	-
					Обозначения аппаратов	Соответствует/не соответствует
					Частота	0,88 – 5,28 МГц
					Эффективная интенсивность	0,05-1,0 Вт/см ²
					Номинальное значение длительности импульса	1; 2; 4; 10 мс
					Относительное отклонение длительности импульса от номинального значения	Не более $\pm 20\%$
					Длительность фронта и среза импульса	Не более 5% от номинального значения длительности импульса
					Неравномерность вершины импульса	Не более 20%
					Нижний предел диапазона устанавливаемых продолжительностей процедуры	Не более 3 мин

				Верхний предел диапазона устанавливаемых продолжительностей процедуры	Не более 15 мин
				Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора или деления шкалы	Не более 1 мин
				Допустимое отклонение длительности процедуры от устанавливаемого значения:	
				- при длительности процедуры не более 10 мин	Не более ± 30 с
				- при длительности процедуры более 10 мин	Не более $\pm 5\%$ от устанавливаемого значения
				Длительность звукового сигнала после автоматического прекращения излучения ультразвуковых колебаний	Не менее 5 с
				Время установления рабочего режима аппарата	Не более 30 с
				Потребляемая мощность	Не более 50 Вт
				Масса электронного блока	Не более 4,5 кг
				Безопасность	Соответствует/не соответствует
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
560.	ГОСТ Р 50267.5	Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.12 26.60.13	9018 90	Интенсивность нежелательного излучения ультразвука лечебной головкой, которую применяют держа в руке, должна быть не более 100 мВт/см ²
					Соответствует/не соответствует
					Соответствует/не соответствует
					Соответствует/не соответствует
561.	ГОСТ 25053	Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии.	26.60.12 26.60.13	9018 90	-
					Соответствует/не соответствует
					0,88 – 5,28 МГц

562.	ГОСТ 30324.5	Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13	9018 90	Номинальное значение эффективной площади излучателя	0,1 – 10,0 см ²
					Диаметры цилиндрических рабочих поверхностей	(3,0 – 20,0) ± 0,3 мм
					Эффективная интенсивность	Не менее 1,0 Вт/см ²
					Длина соединительного кабеля излучателя	1,5-1,7 м
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Акустическая энергия (включая ультразвук)	Интенсивность нежелательного излучения ультразвука лечебной головкой не более 100 мВт/см ²
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
563.	ГОСТ Р 55310	Оборудование ультразвуковое медицинское терапевтическое.	26.60.13	9018 90	Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Выходная мощность	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент неоднородности пучка	Соответствует/не соответствует
564.	ГОСТ IEC 61689	Аппараты для ультразвуковой терапии.	26.60.13	9018 90	Номинальная выходная мощность	Соответствует/не соответствует
					Эффективная площадь излучения лечебной головки	Соответствует
					Эффективная интенсивность при той же самой установке органов управления, что и для номинальной выходной мощности	Соответствует/не соответствует
					Частота акустического воздействия	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент неоднородности пучка	Соответствует/не соответствует
					Максимальная интенсивность в пучке	Соответствует/не соответствует

565.	ГОСТ Р 8.584	Оборудование медицинское ультразвуковое. Аппараты экстракорпоральной литотрипсии	26.60.13	9018 90		Длительность импульса, периода повторения импульсов, коэффициента заполнения и отношения временного максимума выходной мощности к выходной мощности для каждого режима модуляции	Соответствует/не соответствует
							Пик-положительное акустическое давление
							Пик-отрицательное акустическое давление
							Фокус
							Ширина фокальной области
							Протяженность фокальной области
							Площадь фокальной области
							Объем фокальной области
							Идентификация: конструкции
							Частота
566.	ГОСТ Р 57630 (ГОСТ Р 57630/IEC/TS 62736)	Сканеры эхо-импульсные	26.60.12	9018 12			-
							0,5 – 100 МГц
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
567.	ГОСТ Р 57631 (ГОСТ Р 57631/IEC/TS 62791)	Сканеры эхо-импульсные	26.60.12	9018 12			Соответствует/не соответствует
							3 – 20 мм
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Типы доплеровских ультразвуковых систем	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Рабочее расстояние	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Верхняя граница полосы частот	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Влияние неподвижной мишени на чувствительность	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Избирательность по направлению	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Уровень шума	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Нижняя граница полосы частот	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Нелинейные искажения	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
568.	СТ РК 2.189 (IEC/TR 61206, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические	26.60.12	9018 12		Влияние противоположного движения на избирательность прибора по направлению	Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует
							Соответствует/не соответствует

569.	ГОСТ 4.324	Аппараты для ультразвуковой терапии	26.60.13	9018 90	Номенклатура показателей	-
570.	ГОСТ Р МЭК 61157	Приборы ультразвуковой диагностики	26.60.13	9018 12	Идентификация требований к установлению соответствия системы	-
					Идентификация номенклатуры показателей	-
571.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33	Изделия медицинские электрические. Медицинское диагностическое оборудование, работающее на основе магнитного резонанса	26.60.12	9022 12	Идентификация номенклатуры показателей	
					Ток утечки	Соответствует/не соответствует
					Акустический шум	Не более 20 мА
					Магнитное поле	Не более 140 дБ
					Система аварийного отключения магнитного поля	Не более 10 Гл
					Система аварийного отключения магнитного поля	Соответствует/не соответствует
572.	ГОСТ Р 54840	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Классификация	-
					Классы лазеров	1, 1М, 2, 2М, 3R, 3B, 4
					Спектральный диапазон	180 – 10 ⁶ нм
					Диаметр ограничивающей апертуры	1 – 11 мм
					Длительность T _i	10 ⁻⁷ – 10 с
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
573.	ГОСТ 31581	Лазерная безопасность	26.60.12	9018 13	Классификация	-
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
					Защитные устройства и блок	Соответствует/не соответствует
					Устройства предупреждения лазерной опасности ировки	Соответствует/не соответствует
					Органы управления лазерным изделием	Соответствует/не соответствует
					Системы наблюдения	Соответствует/не соответствует
					Защитные экраны	Соответствует/не соответствует
					Технологические кабины	Соответствует/не соответствует

					Поверхность	Соответствует/не соответствует
574.	ГОСТ ИЕС 60825-1 Таблица 6 п.5	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Длительность эмиссии	Соответствует/не соответствует 10 – 30000 с
					Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
575.	ГОСТ ИЕС 60825-4	Безопасность лазерной аппаратуры. Средства защиты от лазерного излучения	26.60.12	9018 13	Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Изнашивающиеся части средств защиты от лазера	Соответствует/ не соответствует
					Время действия активной защиты	Заменяемы/ не заменяемы
						Превышает/ не превышает время отключения лазера
576.	ГОСТ ИЕС/TR 60825-13	Лазерная аппаратура	26.60.12	9018 13	Проверка сопроводительной документации	Соответствует/ не соответствует
					Маркировка	Соответствует/ не соответствует
					Временные характеристики источника	Импульсный/нет
577.	ГОСТ 12.4.308 п.7	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки для защиты от лазерного излучения	32.50.42	9004 10 4203 29	Требования к маркировке	Соответствует/не соответствует
578.	ГОСТ 12.4.309.2	Средства индивидуальной защиты глаз	32.50.42 32.99.11	9004 10 9004 90	Оптические параметры	Соответствует/не соответствует
579.	ГОСТ Р ИСО 11990-1	Лазеры и оборудование, относящиеся к лазерам. Ствол трахеальной трубки	26.60.12	9018 13	Неоптические параметры	Соответствует/не соответствует
580.	ГОСТ 12.1.040	Лазерная безопасность	26.60.12	9018 13 9013 20	Стойкость к воздействию лазера	Устойчивы/ не устойчивы
581.	ГОСТ 12.2.091	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	26.60.11 26.60.12 32.50.12	9027 9030 9032 10 3822 00 2804 40 2811 21 8419 20 8419 39	Идентификация классификации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Определение доступных частей	Соответствует/не соответствует
					Ток доступных частей	Соответствует
					Напряжение доступной части	0 – 500 мА 0 – 500 В

8419 40	Защитное соединение	Соответствует/не соответствует
8419 89	Закрепление клеммы защитного проводника	Соответствует/не соответствует
8419 90	Импеданс защитного соединения	0 – 0,1 Ом
8421 19	Импеданс соединения постоянно подключенного оборудования	Соответствует/не соответствует
	Соединения с внешними цепями	Соответствует/не соответствует
	Зазоры	0,05 – 100 мм
	Пути утечки	0,025 – 160 мм
	Испытания напряжением	Наличие/отсутствие пробоя или повторяющегося искрения
	Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
	Требования к шнурам сетевого питания	Соответствует/не соответствует
	Требования к вилкам и соединителям	Соответствует/не соответствует
	Требования к устройствам отсоединения от источника питания	Соответствует/не соответствует
	Требования к движущимся частям	Соответствует/не соответствует
	Оценка устойчивости оборудования	Соответствует/не соответствует
	Требования к ручкам и захватам, кронштейнам	Соответствует/не соответствует
	Жесткость кожуха	Соответствует/не соответствует
	Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
	Предельно допустимая температура поверхности для защиты от ожогов	Не более 105°C
	Температура обмоток	Не более 210 °C
	Стойкость неметаллических кожухов к повышенным температурам	Соответствует/не соответствует

582.	ГОСТ 12.2.091	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.					Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответствует/не соответствует
							Защита от излучения	Соответствует/не соответствует
582.	ГОСТ 12.2.091	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.					Микроволновое излучение	Соответствует/не соответствует
							Уровень звукового давления	Не более 10 Вт/м ²
							Давление ультразвука	30 – 85 дБ
							Защита от выделяющихся газов, взрыва и от направленного внутри взрыва	Не более 110 дБ
							Требования к устройствам защиты от превышения температуры электродвигателя	Соответствует/не соответствует
							Цепи или компоненты, используемые как устройства, ограничивающие переходное перенапряжение	Соответствует/не соответствует
							Защита с помощью блокировок	Соответствует/не соответствует
							Маркировка	Соответствует/не соответствует
							Документация	Соответствует/не соответствует
							Нахождение доступных частей	Соответствует/не соответствует
							Ток доступных частей	Соответствует/не соответствует
							Напряжение доступной части	0 – 500 мА
							Защитное заземление	0 – 500 В
							Защитный импеданс	Соответствует/не соответствует
							Соединения с внешними цепями	Соответствует/не соответствует
							Зазоры	0 – 0,1 Ом
							Пути утечки	Соответствует/не соответствует
							Воздействие испытательным напряжением	0,05 – 100 мм
							Конструктивные требования по защите от поражения электрическим током	0,025 – 160 мм
							Требования к шнурам сетевого питания	Отсутствие разряда или повторяющегося поверхностного пробоя
								Соответствует/не соответствует

Требования к сетевым вилкам и соединителям	Соответствует/не соответствует
Требования к зажимам	Соответствует/не соответствует
Требования к устройствам отключения от источника питания	Соответствует/не соответствует
Требования к движущимся частям	Соответствует/не соответствует
Оценка устойчивости оборудования	Соответствует/не соответствует
Требования к ручкам и захватам	Соответствует/не соответствует
Испытание на прочность	Соответствует/не соответствует
Испытание ударным молотком	Соответствует/не соответствует
Испытание на воздействие вибрации	Соответствует/не соответствует
Испытание на механическую прочность при падении	Соответствует/не соответствует
Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
Температурные ограничения	Не более 100°C
Оборудование, выделяющее при работе теплоту	Не более 180 °C
Теплостойкость	Соответствует/не соответствует
Защитные ограждения	Соответствует/не соответствует
Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Соответствует/не соответствует
Защита от излучения	Соответствует/не соответствует
Ультрафиолетовое излучение	Соответствует/не соответствует
Электромагнитное излучение	Не более 10 Вт/м ²
Уровень звукового давления	30 – 80 дБ
Ультразвуковое давление	Не более 110 дБ
Защита от выделяющихся газов	Соответствует/не соответствует

				Требования к устройствам защиты от перегрева электродвигателя	Соответствует/не соответствует
				Требования к сетевым трансформаторам	Соответствует/не соответствует
				Защита блокировками	Соответствует/не соответствует
				Измерительные цепи	Соответствует/не соответствует
583.	ГОСТ ИЕС 61010-1 (за исключением п. 10.5.3, п.9.3.2)	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	26.60.12	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90	- Устойчиво /не устойчиво
				Идентификация: конструкции	
				Устойчивость при транспортировании и хранении	
				Электробезопасность:	
				- напряжение	110 – 420 В
				- переменный ток	2 – 30 А
				Комплектность	Соответствует/не соответствует
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
584.	ГОСТ 22729	Анализаторы жидкостей ГСП	26.60.12	9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 90	- Соответствует/не соответствует Соответствует Более 40 МОм
				Идентификация: классификация	
				Внешний вид	
				Электрическое сопротивление изоляции измерительных цепей и цепей питания	
				Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
				Комплектность	Соответствует/не соответствует
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
585.	ГОСТ 13350	Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП	26.60.12 26.51.53	9027 80	- Устойчиво /не устойчиво
				Идентификация: классификация	
				Работоспособность при питании от сети переменного тока:	
				- напряжение	187 – 242 В
				- частота питания	50±1 Гц
				Время переходного процесса	Не более 60 с

586.	ГОСТ 22171	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные	26.60.12 26.51.53	9027 80	Время установления показаний (выходных сигналов)	Не более 480 с
					Время установления режима работы	Не более 15 мин
586.	ГОСТ 22171	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные	26.60.12 26.51.53	9027 80	Сопротивление изоляции электрических цепей	Не менее 40 МОм
					Электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
					Масса	0 – 6,5 кг
					Потребляемая мощность	0 – 10 ВА
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Параметры питания:	
					- частота переменного тока	50±1 Гц
					- напряжение	187 – 242 В
					Уровень автоматизации	Соответствует/не соответствует
					Длина линии связи между первичными преобразователями и измерительным блоком	Не менее 1,0 м
					Конструкция первичных преобразователей	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к транспортной тряске, воздействию температур и влажности	Соответствует/не соответствует
					Время установления выходных сигналов (показаний)	Не более 20 с
586.	ГОСТ 22171	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные	26.60.12 26.51.53	9027 80	Продолжительность однократного измерения	Не более 120 с
					Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Требования безопасности	Соответствует/не соответствует

587.	ГОСТ 27987	Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП	26.60.12 26.51.53	9027 80	Идентификация: классификация, материалы Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей Прочность электрической изоляции Сопротивление изоляции цепи вспомогательного электрода арматуры чувствительных элементов Герметичность чувствительных элементов Параметры питания: - частота переменного тока - напряжение Время прогрева преобразователей Перегрузка по входному сигналу Комплектность Маркировка Упаковка Требования безопасности	- Не менее 40 МОм Соответствует/не соответствует Не менее $1 \cdot 10^9$ Ом Соответствует/не соответствует 50±1 Гц 187 – 242 В 0 – 120 мин Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
588.	ГОСТ 29024	Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические	26.60.12 26.51.53	9027 80	Идентификация: классификация Требования безопасности Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей Прочность электрической изоляции	- Соответствует/не соответствует Не менее 40 МОм Соответствует/не соответствует
589.	ГОСТ ИЕС 61010-2-010	Лабораторное оборудование для нагревания материалов	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка и документация Функциональные характеристики	- Соответствует/не соответствует
590.	ГОСТ ИЕС 61010-2-020	Лабораторные центрифуги	26.60.12 26.51.53 28.29.41	9027 80	Маркировка и документация Функциональные характеристики	- Соответствует/не соответствует
591.	ГОСТ 18996	Анализаторы биологических жидкостей медицинские	26.60.12 26.51.53	9027 80	Термины и определения	- Соответствует/не соответствует

592.	ГОСТ IEC 61010-2-030	Испытательные и измерительные цепи	26.60.12 26.51.53	9027 80	Идентификация маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
593.	ГОСТ IEC 61010-2-033	Портативные мультиметры и другие измерительные приборы	26.60.12 26.51.53	9027 80	Мощность дозы	Не более 13 мкЗв/ч
594.	ГОСТ Р МЭК 61010-2-041	Лабораторные автоклавы, в том числе использующие пар для обработки медицинских материалов	26.60.12 26.51.53	9027 80	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Динамическое испытание горизонтальных нагревательных поверхностей из стеклянных или керамических материалов	Соответствует/не соответствует
					Устройства защиты от перегрева	Соответствует/не соответствует
595.	ГОСТ IEC 61010-2-051	Лабораторное оборудование для перемешивания и взбалтывания	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Перемещение в процессе работы	Соответствует/не соответствует
					Повторный запуск после прерывания	Соответствует/не соответствует
596.	ГОСТ IEC 61010-2-061	Лабораторные атомные спектрометры с термической атомизацией и ионизацией	32.50.12 32.50.13	8421 19	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию газов и растворителей	Соответствует/не соответствует
					Уровень звука	30 – 130 дБА
					Система зажигания пламени (поджига)	Соответствует/не соответствует
597.	ГОСТ IEC 61010-2-081	Автоматическое и полуавтоматическое лабораторное оборудование для проведения анализов и других целей	26.60.12	9018 19 9018 90	Маркировка и документация	-
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
598.	ГОСТ IEC 61010-2-091	Кабинетные рентгеновские системы	-	-	Требования к предоставлению информации	Соответствует/не соответствует
599.	ГОСТ IEC 61010-2-101	Медицинское оборудование для лабораторной диагностики (IVD)	26.51.43 26.51.45	9030 32 9030 33 9030 39	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует

600.	ГОСТ 28311	Дозаторы медицинские лабораторные	32.50.12	8419 20 8419 39	Идентификация: классификация	-
					Характеристики отклонений объемов доз	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность при питании от сети переменного тока	
					- напряжение	198 – 242 В
					- частота питания	(50±0,5) или (60±0,6) Гц
					Максимально допустимое время установления рабочего режима с момента включения	1 – 30 мин
					Время подготовки дозаторов к работе	1 – 30 мин
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчиво/не устойчиво
					Усилие нажатия на кнопки управления автоматических дозаторов	0 – 15 Н
					Усилие, необходимое для формирования объема дозы с помощью пальцев	0 – 50 Н
601.	ГОСТ 18856 п.2.10	Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких.	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Корректируемый уровень звуковой мощности	30 – 62 дБА
					Превышение температуры наружных поверхностей	0 – 20 °С
602.	ГОСТ 30324.12	Аппараты искусственной вентиляции легких	32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	Максимальное рабочее давление	1,5 – 3 кПа
					Максимальное рабочее разрежение	0,8 – 1,5 кПа
					Идентификация: конструкции	-
					Электробезопасность:	
					- напряжение	110 – 320 В
					- переменный ток	2 – 30 А
					- токи утечки	Не более 0,5 мА
					Температура поверхностей	Не более 41°С

			32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13 32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	Комплектность	Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
						Соответствует/не соответствует
603.	ГОСТ ISO 7228	Коннекторы трахеальных трубок	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Обозначение размеров	Соответствует/не соответствует
					Диапазон размеров:	
					- номинальный внутренний диаметр	2,5 – 11,0 мм
					- внутренний диаметр d	2,35 – 11,15 мм
					- прямые коннекторы L ₁	9 – 20 мм
					- изогнутые коннекторы L ₂	8 – 12 мм
					Материал	Соответствует/не соответствует
					Конструкция коннектора	Соответствует/не соответствует
					Площадь поперечного сечения просвета	Большее просвета трубок
					Внутренний диаметр изогнутого или углового коннектора	Не менее 80% номинального диаметра, площадь поперечного сечения не должна уменьшаться более чем на 10 %
					Коническое соединение со стороны аппарата	15 и 22 мм соответственно

					Маркировка	Соответствует/не соответствует
604.	ГОСТ 31054.1	Трубки трахеотомические. Соединения	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Соответствие требований	Соответствует/не соответствует
605.	ГОСТ 31054.2	Трубки трахеотомические	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Обозначения размеров Внутренний диаметр трубок Основные параметры и другая информация, которая должна быть представлена Материалы Стойкость к стерилизации Устойчивость к воздействию анестезирующих паров и газов Конструкция и отделка Наружный диаметр трубки для раздувания Просвет трубки для раздувания Длина свободного конца трубки для раздувания Конусность Угол среза Удаление мандрена из трахеотомической трубки Упаковка Маркировка	Соответствует/не соответствует Соответствует 2,35 – 11,2 мм Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Устойчиво/не устойчиво Устойчиво/не устойчиво Соответствует/не соответствует Не более 3,0 мм Не должен перекрывать просвет трахеотомической трубки более чем на 10% ее внутреннего диаметра и не должен существенно выступать на ее наружной поверхности Не менее 40 мм 6% Не менее 50° Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
606.	ГОСТ ISO 5358	Аппараты ингаляционного наркоза.	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Стойкость к чистящим средствам Расположение органов управления, контроля и измерения Соединения медицинских газовых баллонов	Устойчиво/не устойчиво Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

						Градировка манометров баллонов и трубопроводов	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Газопровод аппарата ИН	Выдерживать давление, превышающее не менее чем в два раза расчетное рабочее давление	Выдерживать давление, превышающее не менее чем в два раза расчетное рабочее давление
						Утечка в части газопровода аппарата ИН	Не более 50 мл/мин	Не более 50 мл/мин
						Утечка газа во вращающемся регуляторе потока	Не более 5 мл/мин	Не более 5 мл/мин
						Градировка расходомеров	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Маркировка испарителей	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Общее выходное отверстие	15 мм и 22 мм	15 мм и 22 мм
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Идентификация: термины и определения	-	-
607.	ГОСТ Р 52423	Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Механическое воздействие	Выдерживает/ не выдерживает	Выдерживает/ не выдерживает
						Размеры	Аппарат в футляре должен проходить сквозь прямоугольное отверстие размером 300x600 мм	Аппарат в футляре должен проходить сквозь прямоугольное отверстие размером 300x600 мм
						Масса аппарата	Не более 18 кг	Не более 18 кг
						Давление, создаваемое в отверстии для присоединения пациента	Не более 0.5 кПа	Не более 0.5 кПа
						Мертвое пространство аппарата	Не более 5 мл +10%	Не более 5 мл +10%
608.	ГОСТ 31057	Аппараты искусственной вентиляции легких для оживления	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Устойчивость к воздействию окружающей среды	Устойчивы/ не устойчивы	Устойчивы/ не устойчивы
						Маркировка	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Части, находящиеся в контакте с пациентом	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Скорость потока газа и утечки	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
609.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12	Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40				

					Классификация	
					Идентификация, маркировка, документация	Соответствует/не соответствует
610.	ГОСТ 31511.2	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для применения на дому	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: общие требования	-
					Классификация	-
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Длительные токи утечки и дополнительные токи в цепи пациента	Соответствует/не соответствует
					Максимальное давление в отверстии для присоединения пациента	0 – 8 кПа или 120% максимального рабочего давления
					Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
611.	ГОСТ Р ИСО 10651.3	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские, применяемые в экстренных ситуациях и в транспортных средствах	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация: общие требования	-
					Классификация	-
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
612.	ГОСТ ИЕС 60601-2-13	Изделия медицинские электрические. Анастезиологические комплексы	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация	-
					Маркировка и документация	-
					Основные функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
613.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-13	Изделия медицинские электрические. Анастезиологические комплексы	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Защита шнура питания от случайного отсоединения	Соответствует/не соответствует
					Перемещение через препятствие	Соответствует/не соответствует
					Расплевывание жидкостей	Соответствует/не соответствует
					Защита от случайной установки органов регулирования	Соответствует/не соответствует

614.	ГОСТ ISO 8185	Увлажнители медицинские	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Условия срабатывания сигнализации	Соответствует/не соответствует
					Идентификация	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхности	Не более 44°C
					Выплеск воды из емкости (сосуда) для жидкости и из резервуара в дыхательный контур	Не более 5 мл
					Объемная скорость потока жидкости на выходе	Не более 20 мл/ч
					Прерывание нагрева	Соответствует/не соответствует
					Термический перегрев	Соответствует
					Диаметры коннекторов	Не более 50°C
					Соответствие трубок подачи	15 мм; 22 мм
615.	ГОСТ 31517	Шланги газоподводящие низкого давления медицинские	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
					Производительность	Не менее 33 мг H ₂ O/л
					Максимальное падение давления	0 – 2 кПа
					Уровень шума	30 – 50 дБА
					Утечка коннектора	0 – 5 мл/мин
					Скорость утечки	0 – 10 мл/мин
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Совместимость материалов	Соответствует
					Стойкость к воздействию окружающей среды	Соответствует/не соответствует
					Диаметр шлангов	Соответствует
					Разрывное давление	Не менее 5 мм
					Выдерживание усилия при осевом растяжении	Не менее 4000 кПа
					Деформация под давлением	Выдержано/не выдержано
					Соппротивление окклюзии	Увеличение наружного диаметра не должно превышать 5% первоначального
					Прочность сцепления	Расход газа 20 л/мин не должен снижаться более чем на 10%
					Гибкость шлангов	Не менее 1,5 кН/м
						Соответствует/не соответствует

616.	ГОСТ 31518.1	Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Конические патрубки и гнезда	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Специфичные для газа соединители Концевые соединители Размеры соединителя NIST Шероховатость соединителя NIST Обозначение соединения Диаметры для корпусов соединителей NIST Диаметры для ниппелей соединителей NIST Размер O-образных колец: - внутренний диаметр - диаметр сечения Обозначение соединителя DISS Утечка газа из шланга Падение давления Маркировка и цветовая кодировка Упаковка Информация изготовителя Область применения Размеры конических металлических соединений: - диаметр A - размер B - длина конуса - расстояние до фланца D - расстояние до проточки E - конусность Размеры конических неметаллических соединений: - диаметр A - размер B - размер C - размер D - размер E	Наличие/отсутствие
						Соответствует/не соответствует 4,7 – 25 мм 1,6 мкм Соответствует/не соответствует 7,5 – 17,0 мм 7,3 – 17,0 мм 6,95 – 8,25 мм 1,52 – 2,48 мм Соответствует/не соответствует Не более 0,6 мл/мин Не более 80 кПа Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует - 8,45 – 30,95 мм 6 – 15 мм 6,4 – 21 мм 8,9 – 21,5 мм 8 – 21,5 мм 1:19 – 1:40 8,495 – 30,985 мм 8,085 – 30,125 мм 8,395 – 19,505 мм 1,305 – 5,205 мм 1,495 – 2,205 мм

						- конусность F	1:19 – 1:40
						- радиус	0,35 – 0,5 мм
						Утечка газа из сопрягаемых соединений	Не более 5 мл/мин
						Надежность сопряжения охватываемой детали конического соединения с охватываемой деталью, снабженной фиксатором	Соответствует/не соответствует
617.	ГОСТ ISO 8835-3	Системы ингаляционного наркоза. Системы выведения газонаркозной смеси. Передающие и принимающие системы	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Устойчивость к падению	Собранное соединение разоединилось/не разоединилось
						Увеличение давления на входе СВГС	Не более 1,5 кПа
						Индукционный расход	Не более 500 мл/мин
						Утечка газа в атмосферу	Не более 100 мл/мин
						Передающие и принимающие системы	Соответствует/не соответствует
						Сопротивление отсасывающему потоку	1 – 2 кПа
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Идентификация	Соответствует/не соответствует
						Безопасность	Соответствует/не соответствует
618.	ГОСТ Р ИСО 7396-1	Системы трубопроводные медицинских газов. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Материалы	Соответствует/не соответствует
						Компоненты системы	Соответствует/не соответствует
						Маркировка и цветовое кодирование	Соответствует/не соответствует
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
						Безопасность	Соответствует/не соответствует
						Материалы	Соответствует/не соответствует
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
						Безопасность	Соответствует/не соответствует
						Материалы	Соответствует/не соответствует
						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
619.	ГОСТ Р ИСО 10083	Системы подачи с концентраторами кислорода для использования в трубопроводных системах медицинских газов	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Безопасность	Соответствует/не соответствует
						Материалы	Соответствует/не соответствует

620.	ГОСТ Р ИСО 10651-4	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для оживления с ручным приводом	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Конструкция коннекторов	Соответствует/не соответствует
					Функционирование клапана пациента после его загрязнения рвотой	Соответствует/не соответствует
					Стойкость к падению	Соответствует/не соответствует
					Работоспособность после погружения в воду	Соответствует/не соответствует
					Материалы	Соответствует/не соответствует
					Обеспечение объемной концентрации кислорода	Не менее 85 %
					Сопротивление выдоху	Не более 0,5 кПа
					Сопротивление вдоху	Не более 0,5 кПа
					Неисправность клапана пациента	Соответствует/не соответствует
					Мертвое пространство	Не более 5 мл +10% дыхательного объема
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Сведения, которые должны быть указаны производителем в инструкциях по применению и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
621.	ГОСТ Р ИСО 10651-5	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские для оживления	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40	Поверхности, углы и кромки	Соответствует/не соответствует
					Защита против случайных настроек	Соответствует/не соответствует
					Соединительные устройства:	
					Соединение с медицинской системой газоснабжения	Соответствует/не соответствует
					Соединение с входным каналом для газа высокого давления	Соответствует/не соответствует
					Соединитель канала для соединения с пациентом	15 мм и 22 мм
					Соединитель лицевой маски	15 мм и 22 мм
					Соединитель газового выходного канала	30 мм
					Функционирование клапана пациента после загрязнения рвотой	Время очистки и восстановления нормального функционирования не более 20 с

622.	ГОСТ Р ИСО 80601-2-55	Изделия медицинские электрические. Мониторы дыхательных смесей	32.50.12 32.50.13			Чистка, стерилизация или дезинфекция Соответствует/не соответствует Функциональность после повторной сборки Соответствует/не соответствует Устойчивость к воздействиям окружающей среды Соответствует/не соответствует Механическая устойчивость при обычном использовании Соответствует/не соответствует Водонепроницаемость IPX4 Размеры 0 – 600 мм Масса 0 – 5 кг Переключатель, связанный с баллонным клапаном Не менее 200 Н Внешнее обеспечение 280 – 600 кПа Невозможность неправильного соединения Соответствует/не соответствует Сопротивление вдоху в течение фазы выдоха Не более чем на $6 \cdot 10^6$ Па ниже атмосферного давления Сопротивление выдоха Не более чем на $6 \cdot 10^6$ Па Незапланированное РЕЕР Не более $2 \cdot 10^6$ Па Мертвая зона реанимационного аппарата и мертвая зона оснастки для воздушного потока Не более 5,5% минимального доставляемого объема из реанимационного аппарата Не более $80 \cdot 10^6$ Па Давление в канале для соединения с пациентом Не менее атмосферного давления более чем на $2 \cdot 10^6$ Па Давление в канале для соединения с пациентом, необходимое для возникновения газового потока из клапана, срабатывающего по требованию 100 л/мин Минимальное значение вдыхаемого потока Соответствует/не соответствует Идентификация, маркировка и документация Соответствует Информация, подготовленная производителем для работы и поддержки Соответствует/не соответствует Идентификация, маркировка и документация Соответствует/не соответствует Проникание воды или твердых частиц IPX2
						8419 20 8419 39 8419 40

						Технические условия срабатывания сигнализации при отказе подачи питания	Соответствует/не соответствует	на 406 листах, лист 101
						Сохранение настроек и данных после кратковременного отключения или автоматического переключения питания	Соответствует/не соответствует	
						Работа после длительного отключения	Соответствует/не соответствует	
						Работа от резервного источника питания	Соответствует/не соответствует	
						Удар и вибрация	Соответствует/не соответствует	
						Скорость утечки через датчик неотводящего RGM	Не более 10 мл/мин	
623.	ГОСТ 31056	Концентраторы кислорода				Вибрация и шум:		
						- максимальный уровень звукового давления	8419 20 8419 39 8419 40	
						Максимальная температура частей изделий, которых может одновременно коснуться пациент	8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40	
						Температура газа на выходе	8419 20 8419 39 8419 40	
						Соединительные устройства:	8419 20 8419 39 8419 40	
						- размеры конического соединителя	8419 20 8419 39 8419 40	
						- электрическая проводимость	8419 20 8419 39 8419 40	
						- материалы	8419 20 8419 39 8419 40	
						Дыхательные контуры:	8419 20 8419 39 8419 40	
						- утечка газа	8419 20 8419 39 8419 40	
624.	ГОСТ 31510.2	Анестезиологические циркуляционные дыхательные контуры				- сопротивление вдоху: давление, генерируемое на канале соединения на стороне пациента	Не более 150 мл/мин (15,65 кПа/(л·мин ⁻¹))	
						- сопротивление выдоху: давление, генерируемое на канале соединения на стороне пациента	Не более 0,6 кПа	
						- направление движения	Движение по часовой стрелке должно постепенно	
						8419 20		
						8419 39		
						8419 40		
						8419 20		
						8419 39		
						8419 40		
						8419 20		

					увеличивать предельное давление
					Предохранительные клапаны
					ограничения давления:
					- падение давления на клапане в полностью открытом положении при расходе воздушного потока 3 л/мин
					0,05 – 0,3 кПа
					- падение давления на клапане в полностью открытом положении при расходе воздушного потока 30 л/мин
					0,1 – 0,5 кПа / 0,1 – 0,6 кПа
					- утечка при полностью закрытом клапане
					Не более 50 л/мин
					Узел циркуляционного адсорбера:
					- конструкция
					Соответствует/не соответствует
					- механизм байпаса адсорбера
					Соответствует/не соответствует
					- утечка
					Соответствует/не соответствует
					Обратные клапаны:
					- давление, генерированное сухим клапаном
					Не более 0,15 кПа
					- увеличение давления
					Не менее чем до 0,5 кПа в течение 5 мин
					- давление открытия сухого клапана
					Не более 0,12 кПа
					- контроль давления
					От минус 10 см. вод. ст. до плюс 60 см. вод. ст. и (или) от минус 1 кПа до плюс 6 кПа
					Маркировка
					Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем
					Соответствует/не соответствует
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				
32.50.13	8419 20				
32.50.12	8419 39				
32.50.13	8419 40				
32.50.12	8419 20				
32.50.13	8419 39				
32.50.12	8419 40				

				8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40 8419 20 8419 39 8419 40				
625.	ГОСТ 24264.2	Резьбовые соединения, несущие весовую нагрузку	32.50.12 32.50.13	8419 20 8419 39 8419 40		Материалы Свободное осевое перемещение накидной гайки на охватываемой детали соединения Рекомендуемые размеры уплотнительного кольца: - внутренний диаметр - диаметр сечения - резьба на охватываемой детали	- 0 – 2 мм 22,1 мм 1,6 мм M33x2-6g	
626.	ГОСТ Р 50267.10	Стимуляторы нервов и мышц	32.50.21	9018 90		- резьба на охватываемой детали Инструкция по эксплуатации Техническое описание Ток утечки на пациента Ток утечки на корпус Ток утечки на землю Электрическая прочность изоляции Выходное напряжение Выходной ток Частота импульсов Постоянная составляющая тока Колебания напряжения питания Идентификация, маркировка и документация	M33x2-6H - - 0 – 500 мкА 0 – 2 мА 0 – 10 мА 500 – 4000 В 0 – 36 В 0 – 100 мА 0 – 100 кГц 0 – 10 мА - -	
627.	ГОСТ Р 50267.14	Аппараты электрошоковой терапии	32.50.21	9018 90		Ток утечки на корпус Ток утечки на землю Электрическая прочность изоляции Путь утечки	0 – 0,5 мА 0 – 10 мА 500 – 4000 В 0 – 50 мм	

					Воздушные зазоры	0 – 50 мм
					Ограничение выходных характеристик	0 – 100 Дж
628.	ГОСТ 30324.31	Наружные кардиостимуляторы с внутренним источником питания	26.60.14	9021 50	Идентификация, маркировка и документация	-
					Дополнительный ток в цепи пациента	0,001 мА
					Путь утечки	0 – 50 мм
					Воздушные зазоры	0 – 50 мм
629.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4	Кардиодефибрилляторы	26.60.14	9021 50	Идентификация, маркировка и документация	-
					Допустимые значения токов утечки на пациента	0 – 0,1 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Путь утечки	0 – 50 мм
					Воздушные зазоры	0 – 25 мм
					Сопrotивление изоляции кабеля	500 МОм
					Сопrotивление нагрузки	25 – 175 Ом
					Энергия	0 – 360 Дж
					Выходное напряжение	0 – 5 кВ
					Время, необходимое для полной зарядки	0 – 40 с
					Время от включения до готовности к разряду с максимальной энергией	0 – 50 с
					Емкость нового полностью заряженного аккумулятора	0 – 20 разрядов
630.	ГОСТ Р 50267.3	Аппараты для коротковолновой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	-
					Потребляемая мощность	0 – 2 кВт
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Номинальная выходная мощность	0 – 500 Вт
					Температура	0 – 120°C
631.	ГОСТ Р 50267.6	Аппараты для микроволновой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА

632.	ГОСТ 28603 п.2.7	Аппараты для УФЧ-терапии	26.60.13	9018 90	Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нежелательное излучение	0 – 10 мВт/см ²
					Утечка микроволнового излучения	0 – 10 мВт/см ²
					Номинальная выходная мощность	0 – 250 Вт
					Рабочий диапазон таймера	0 – 30 мин
					Устойчивость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
633.	ГОСТ 30324.6	Аппараты для микроволновой терапии	26.60.13.130	9018 90 840 9	Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА
					Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нежелательное излучение	0 – 10 мВт/см ²
634.	ГОСТ ИЕС 60601-2-22	Хирургическое, косметическое, терапевтическое и диагностическое лазерное оборудование	26.60.13	9018 90	Утечка микроволнового излучения	0 – 10 мВт/см ²
					Номинальная выходная мощность	0 – 250 Вт
					Рабочий диапазон таймера	0 – 30 мин
					Идентификация оборудования, маркировка и документы	-
					Усилие для срабатывания переключателя	0 – 10 Н
					Индикация выходной мощности лазера	Отклонение от фактической выходной мощности лазера не более чем на ±20% от заданного значения
635.	ГОСТ ИЕС 60601-2-2	Высокочастотные электрохирургические аппараты	26.60.13	9018 20 9018 90	Индикация параметров, относящихся к безопасности	Обозначенная выходная мощность лазера не должна отклоняться от значения предварительной установки более чем на ±20%
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Ток утечки на пациента	0 – 500 мкА

636.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2	Высокочастотные электрохирургические аппараты и высокочастотные электрохирургические принадлежности	26.60.13	9018 20 9018 90	Ток утечки на землю	0 – 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Сопротивление проводящих путей от ножных переклюателей к проводящему полу	0 – 10 МОм
					Суммарная выходная мощность	0 – 400 Вт в течение 1 с
					Усилие для срабатывания переклюателя	0 – 10 Н
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Емкость цепи	5 пФ – 100 нФ
					Сопротивление между контактами	0 – 10 МОм
					Пути утечки	0 – 50 мм
					Токи утечки	0 – 10 мА
637.	ГОСТ 4.485	Аппараты электрохирургические высокочастотные	26.60.13	9018 90	Электрическая прочность изоляции	500 – 4000 В
					Нагрузочные сопротивления	0 – 2000 Ом
					Усилие для срабатывания переклюателя	0 – 10 Н
					Номенклатура показателей	-
					Номенклатура показателей	-
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Электрическая прочность изоляции	250 – 4000 В
					Токи утечки	0 – 10 мА
					Выдерживание максимальных нагрузок опор и кронштейнов	Выдерживает/не выдерживает
					Максимальный уровень освещенности	0 – 60 мВт/см ²
638. 639.	ГОСТ 4.129 ГОСТ 30324.21	Техника криогенная медицинская Детские инфракрасные обогреватели	32.50.21 26.60.13	9019 20 9018 20 9018 90 9019 20	Температура поверхностей, рассчитанных на контакт с пациентом	0 – 42 °С
					Температура предохранительного устройства	0 – 85 °С
					Диапазон температуры регулирования	36 – 38 °С
					Уровень звука сигналов тревоги	65 – 130 дБА

640.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21	Излучающие обогреватели для новорожденных	26.60.13	9018 20 9018 90 9019 20	Концентрация CO ₂ Идентификация, маркировка и документация Уровень звука сигналов тревоги Выдерживание максимальных нагрузок опор и кронштейнов Электрическая прочность изоляции Токи утечки Максимальный уровень облученности Температура поверхностей, рассчитанных на контакт с пациентом Температура тепловых ограждений	0 – 4% - 65 – 130 дБА Выдерживает/не выдерживает 250 – 4000 В 0 – 10 мА 0 – 60 мВт/см ² 0 – 43 °C 0 – 85 °C 0 – 4%
641.	ГОСТ 30324.19	Детские инкубаторы	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Концентрация CO ₂ Идентификация, маркировка и документация Электрическая прочность изоляции Прочность опор и кронштейнов Устойчивость Боковое усилие, приводящее к опрокидыванию инкубатора Предотвращение движения при наклоне Температура поверхностей Диапазон температуры регулирования Уровень звука Уровень звука сигнала тревоги Концентрация CO ₂	0 – 4% - 250 – 4000 В Соответствует/не соответствует Устойчивы/не устойчивы Не менее 100 Н Соответствует/не соответствует 0 – 43 °C 30 – 39 °C 30 – 80 дБА 65 – 130 дБА 0 – 4%
642.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19	Инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Идентификация, маркировка и документация Уровень звука Уровень звука звуковой сигнализации Прочность опор Температура поверхностей	- 30 – 60 дБА 65 – 130 дБА Соответствует/не соответствует 0 – 43 °C

643.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20	Транспортные инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Стабильность температуры инкубатора	Соответствует/не соответствует
					Равномерность температуры инкубатора	1 °C
643.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20	Транспортные инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Точность датчика температуры кожи	±0,3 °C
					Диапазон температуры регулирования	35 – 39 °C
					Время прогрева	-
					Колебания температуры инкубатора	0 – 2 °C
					Диапазон отображаемой температуры кожи	33 – 38 °C
					Устройства управления температурой и защита от перегрузки	Соответствуют/не соответствуют
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Неустойчивость в положении транспортирования	Устойчивы/не устойчивы
					Неустойчивость от нежелательных поперечных перемещений	Устойчивы/не устойчивы
					Сила опрокидывания	Более 100 Н
					Уровень звука	30 – 60 дБА
					Уровень звука звуковой сигнализации	65 – 130 дБА
					Прочность опор	Соответствует/не соответствует
					Температура поверхностей	0 – 43 °C
					Стабильность температуры инкубатора	Соответствует/не соответствует
					Равномерность температуры инкубатора	2 °C
643.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20	Транспортные инкубаторы для новорожденных	26.60.13	9018 19 9018 20 9018 90 9019 20	Точность датчика температуры кожи	±0,3 °C
					Диапазон температуры регулирования	35 – 39 °C
					Время прогрева	-
					Колебания температуры инкубатора	0 – 2 °C

				Диапазон отображаемой температуры кожи	33 – 38 °С	Соответствуют/не соответствуют
				Устройства управления температурой и защита от перегрузки		
644.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50	Аппараты для фототерапии новорожденных	32.50.21 26.60.13	9018 20 9018 90	-	
				Акустическая энергия	30 – 60 дБА	
				Прочность опор и кронштейнов	Соответствует/не соответствует	
				Инфракрасное излучение	0 – 10 мВт/см²	
				Эффективное ультрафиолетовое излучение	0 – 1,0 · 10 ⁻⁵ мВт/см²	
645.	ГОСТ Р 51024 п.5.5	Аппараты слуховые электронные реабилитационные.	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	0 – 43 °С	Соответствуют/не соответствуют
646.	ГОСТ 10893	Аппараты слуховые электронные.	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	1 – 10%	Устойчивы/не устойчивы
				Изменение акустического усиления или чувствительности индукционной катушки	0 – 25 дБ	
				Масса	1 – 3 дБ	
				Стойкость к механическим воздействиям	5 – 100 г	Устойчивы/не устойчивы
				Стойкость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы	
647.	ГОСТ Р 51407	Слуховые аппараты.	26.60.14 32.50.22	9021 40	0 – 55 дБ УЗД	
648.	ГОСТ Р МЭК 60118-14	Аппараты слуховые программируемые	26.60.14 32.50.22	9021 40 9021 90	2 – 3 В/м	Соответствует/не соответствует
649.	ГОСТ Р ИСО 11904-1	Слуховой аппарат	32.50.21	9021 40	-	
650.	ГОСТ Р ИСО 11904-2	Слуховой аппарат	32.50.21	9021 40	-	
651.	СТБ ИЕС 60645-1 (ИЕС 60645-1, IDT)	Аудиометры тональные	26.60.12	9018 19	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует

652.	СТБ ИЕС 60645-2 (ИЕС 60645-2, IDT)	Оборудование для речевой аудиометрии	26.60.12.129	9018 19 900 0	Требования по акустической безопасности	Соответствует/не соответствует
					Внешние условия:	
					- температура	От 15°C до 35°C
					- относительная влажность	От 30% до 90%
					- атмосферное давление	От 98 до 104 кПа
					Время выхода в рабочий режим:	
					- минимальное время выхода в рабочий режим	0 – 10 мин
					Колебания питания	Соответствует/не соответствует
					Постороннее акустическое излучение	Соответствует/не соответствует
					Испытательные сигналы:	
					- частота	125 – 16000 Гц
					- уровни прослушивания	20 – 120 дБ
					- суммарный коэффициент гармоник	3% / 6%
					- скорость изменения частоты	1 октава в минуту $\pm 25\%$
					- частотная модуляция	Соответствует/не соответствует
					- внешние источники сигнала	Соответствует/не соответствует
					- маскирующий звук	Соответствует/не соответствует
					- преобразователь	Соответствует/не соответствует
					- регулятор уровня сигнала	Соответствует/не соответствует
					- опорный тональный сигнал	Соответствует/не соответствует
					- электрический выход	Соответствует/не соответствует
					Испытательных сигналов	Соответствует/не соответствует
					- формат аудиотрамм	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
652.	СТБ ИЕС 60645-2 (ИЕС 60645-2, IDT)	Оборудование для речевой аудиометрии	26.60.12.129	9018 19 900 0	Общие требования	Соответствует/не соответствует
					Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
					Индикатор уровня сигнала	Соответствует/не соответствует
					Регулировка выходного уровня речевых сигналов	Соответствует/не соответствует
					Выходной уровень звукового давления и вибросилы:	
					- уровень звукового давления	(20 $\pm$ 2) дБ
					- вибросила	(55 $\pm$ 5) дБ
					- частотная характеристика	Соответствует/не соответствует
					- гармонические искажения	Соответствует/не соответствует

653.	ГОСТ 31212	Электрокардиостимуляторы имплантируемые	26.60.14	9021 50	- отношение «сигнал-шум»	Соответствует/не соответствует
					- маскирующий звук	Соответствует/не соответствует
					- контрольный головной телефон или громкоговоритель	Соответствует/не соответствует
					- система двухсторонней связи	Соответствует/не соответствует
					- устройства прерывания	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Ударопрочность и виброустойчивость	Соответствует/не соответствует
					Исправность в процессе эксплуатации и транспортировки	Соответствует/не соответствует
					Нарушение функций ЭКС после разряда дефибрилятора	Соответствует/не соответствует
654.	ГОСТ 31582	Электроды для электрокардиостимуляторов имплантируемые	26.60.14	9021 50 9021 90	Устойчивость к предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Амплитуда, длительность и период следования импульсов	Соответствует/не соответствует
					Порог срабатывания (чувствительности) ЭКС	Соответствует/не соответствует
					Длительность задержки	Соответствует/не соответствует
					Интервал блокировка	-
					Сопроводительная документация	Соответствует/не соответствует
					Сопrotивление электрода	Соответствует/не соответствует
					Электрический импеданс электрода	Соответствует/не соответствует
					Ток утечки	0 – 2 мА
655.	ГОСТ Р ИСО 5841-3	Соединители IS-1 для имплантируемых	26.60.14	9021 50 9021 90	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
					Комплектность, упаковка, маркировка, инструкция по применению	-
					Конструкция соединительного вывода	Соответствует/не соответствует

		электрокардиостимуляторов низкопрофильные.				Размеры соединительного вывода Максимальная сила введения и извлечения проходного калибра соединительного вывода Электрический импеданс между проводящими частями Деформация, обусловленная действием прижимных винтов Маркировка Максимальная сила выведения: ножка калибра Конструкция соединительного вывода	0,3 – 18 мм 0 – 14 Н 50 кОм 0 – 14 Н - 0 – 9 Н Соответствует/не соответствует	
656.	ГОСТ Р ИСО 11318	Узлы соединительные DF-1 для имплантируемых дефибрилляторов	26.60.14	9021 50 9021 90		Размеры соединительного вывода Сила введения и извлечения Деформации соединителя Электрическая изоляция Маркировка Конструкция соединительного гнезда Размеры соединительного гнезда Сила введения и извлечения Идентификация, маркировка и документация Точки утечки Распескивание и утечка Прерывание электропитания Системы защиты Маркировка соединителей концентра	0,1 – 18 мм 0 – 14 Н - - - Соответствует/не соответствует 1,31 – 18,0 мм 0 – 9 Н - 0 – 10 мА - - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует	
657.	ГОСТ Р 50267.16	Изделия медицинские электрические. Изделия для гемодиализа, гемофильтрации и гемофильтрации	32.50.21	3926 90 9018 90				
658.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-16	Изделия медицинские электрические. Аппараты для гемодиализа, гемофильтрации и гемофильтрации	32.50.21	3926 90 9018 90				

					Поток субституата	Соответствует/не соответствует
					Время диализа	Соответствует/не соответствует
					Температура диализирующего раствора	33 – 42°C
					Температура субституата	Соответствует/не соответствует
					Идентификация, маркировка и документация	-
					Точки утечки	0 – 10 мА
					Очистка и дезинфекция	Соответствует/не соответствует
					Прерывание питания	Соответствует/не соответствует
					Системы защиты	Соответствует/не соответствует
					Маркировка соединителей	-
					Громкость звуковых сигналов опасности	65 – 130 дБА
					Период паузы звуковой сигнализации	0 – 10 мин
659.	ГОСТ Р ИСО 7199	Системы газообмена с кровью (оксигенаторы)	32.50.21	3926 90 9018 90	Целостность кровеносного контура	Соответствует/не соответствует
					Целостность жидкостного контура теплообменника	Соответствует/не соответствует
					Объем кровеносного контура	Соответствует/не соответствует
					Надёжность соединительных устройств	Соответствует/не соответствует
					Скорость переноса кислорода и углекислого газа	Соответствует/не соответствует
					Коэффициент эффективности теплообменника	-
					Информация, предоставляемая изготовителем	-
660.	ГОСТ 27422	Аппараты для внепочечного очищения крови	32.50.21	3926 90 9018 90	Классификация	-
					Диапазон регулирования расхода перфузата	50 – 500 мл/мин
					Контроль воздушных включений в перфузате	Соответствует/не соответствует

Диапазон регулирования расхода инфузата	0 – 1 мл/ч, 10 – 100 мл/ч
Расход диализата	400 – 600 мл/мин
Диапазон регулирования температуры диализата	0 – 40 °С
Включение световой сигнализации	При температуре диализата не менее 33 °С
Прекращение перемещения диализата	При температуре диализата не более 41,8 °С
Диапазон регулирования удельной электрической проводимости диализата	12 – 16 мСм/см
Диапазон регулирования расхода не замещаемого ультрафильтрата	0,2 – 2 л/ч
Диапазон измерения объема не замещаемого ультрафильтрата	0 – 5 л
Верхний предел диапазона регулирования трансмембранного давления	60 кПа
Диапазон измерения трансмембранного давления	5 – 80 кПа
Диапазон регулирования расхода ультрафильтрата	0,5 – 6 л/ч
Диапазон регулирования температуры замещающего раствора	35 – 40 °С
Автоматическая остановка перфузионного насоса	0,5 мл/л
Уровень звуковой мощности предупредительной сигнализации	70 – 130 дБА
Время установления рабочего режима после включения	0 – 20 мин
Непрерывный режим работы	8 ч
Электропитание	198 – 242 В, 50 Гц
Стойкость к протиранию	Стойкие/не стойкие
Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
Корректируемый уровень звуковой мощности	30 – 58 дБА

661.	ГОСТ ISO 8638	Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов	32.50.21	3926 90 9018 90	Комплектность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
					Размеры	0 – 15 мм
					Герметичность инъекционного узла	Соответствует/не соответствует
					Цветовое кодирование	-
					Объемы заполнения венозных и артериальных магистралей	Соответствует/не соответствует
					Длина и внутренний диаметр насосных сегментов магистралей	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка и эксплуатационная документация	-
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
662.	ГОСТ 27874	Диализаторы для внепочечного очищения крови.	32.50.21	3926 90 9018 90	Расход перфузата	20 – 350 мл/мин
					Расход деаэрированного диализата	250 – 600 мл/мин
					Температура перфузата и диализата	36 – 38 °C
					Трансмембранное давление	7 – 60 кПа
					Присоединительные размеры	0 – 22 мм
					Стойкость к внешним воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
					Комплектность	-
					Техническое описание и инструкция по эксплуатации	-
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Конструкционная прочность	Соответствует/не соответствует
663.	ГОСТ ISO 8637	Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы.	32.50.21	3926 90 9018 90	Избыточное давление	В 1,5 раза выше максимального избыточного давления На 700 мм рт.ст. ниже атмосферного давления
					Целостность мембраны	Соответствует/не соответствует

				Соединения с полостью по крови	Соответствует/не соответствует
				Соединения с полостью по диализату гемодиализатора	Соответствует/не соответствует
				Соединения с полостью фильтра гемодиализатора или гемоконцентратора	Соответствует/не соответствует
				Размеры соединителей	0 – 22 мм
				Скорость фильтрации	Соответствует/не соответствует
				Упаковка, маркировка и эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
664.	ГОСТ 31616	Протезы фиброзных колец для аннулопластики	32.50.22	9021 39	-
665.	ГОСТ 26997	Клапаны сердца искусственные.	32.50.22	9021 39	-
				Посадочные диаметры клапанов	13 – 41 мм
				Пропускная способность	Не менее 50 см ³ /цикл
				Обратный переток (объем регургитации)	0 – 14 см ³ /цикл
				Шероховатость поверхности	0 – 0,4 мкм
				Устойчивость к транспортной тряске	Устойчивы/не устойчивы
				Стойкость к климатическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
				Чистота поверхности	Соответствует/не соответствует
				Устойчивость к предстерилизационной очистке и стерилизации	Устойчивы/не устойчивы
				Комплектность	-
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
666.	ГОСТ Р ИСО 7198	Имплантаты для сердечно-сосудистой системы. Трубчатые сосудистые протезы	32.50.22	9021 39 9021 90	-
				Классификация	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Качество поверхности	Соответствует/не соответствует

667.	ГОСТ 31618.1	Протезы клапанов сердца	32.50.22	9021 39	Пористость	-
					Проницаемость для воды	Соответствует/не соответствует
					Утечка	Соответствует/не соответствует
					Давление просачивания воды	Соответствует/не соответствует
					Прочность после нанесения многократных проколов	Соответствует/не соответствует
					Прочность при растяжении	Соответствует/не соответствует
					Прочность при разрыве	Соответствует/не соответствует
					Используемая длина	Соответствует/не соответствует
					Внутренний диаметр в ненагруженном состоянии	Соответствует/не соответствует
					Внутренний диаметр под давлением	Соответствует/не соответствует
					Толщина стенок	Соответствует/не соответствует
					Прочность удержания нитей стенкой протеза	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление перегибу	Соответствует/не соответствует
					Посадочный диаметр клапана	0 - 31 мм
					Эффективная площадь проходного отверстия	Не менее 60 мм ²
					Объем регургитации	0 - 12 мл
					Стационарная утечка	0 - 2100 мл/мин
					Механическая прочность манжеты	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к воздействию обратным давлением	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к деформированию каркаса (корпуса)	Соответствует/не соответствует
					Шероховатость поверхности	0 - 0,4 мкм
					Комплектность, упаковка, маркировка, инструкция пользователя	-

668.	ГОСТ Р ИСО 25539-1	Имплантаты сердечно-сосудистые. Внутрисосудистые имплантаты. Эндоваскулярные протезы	32.50.22	9021 39 9021 90	Система доставки эндоваскулярного протеза:	Соответствует/не соответствует
					- возможность доступа	Соответствует/не соответствует
					- способность к раскрытию	Соответствует/не соответствует
					- возможность удаления системы доставки	Соответствует/не соответствует
					Имплантируемое изделие:	
					- способность к точному развертыванию	Соответствует/не соответствует
					- эффективность фиксации имплантата	Соответствует/не соответствует
					- целостность имплантата	Соответствует/не соответствует
					- проницаемость	Соответствует/не соответствует
					- модульность	Соответствует/не соответствует
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					- проходимость	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
669.	ГОСТ Р ИСО 25539-2	Имплантаты сердечно-сосудистые. Внутрисосудистые имплантаты. Сосудистые стенты	32.50.22	9021 39 9021 90	Информация, предоставляемая изготовителем	-
					Система доставки и стент-система:	
					- возможность доступа	Соответствует/не соответствует
					- способность к раскрытию	Соответствует/не соответствует
					- возможность удаления	Соответствует/не соответствует
					Стент:	
					- способность к точному раскрытию	Соответствует/не соответствует
					- эффективность фиксации	Соответствует/не соответствует

670.	ГОСТ 31512	Бароаппараты одностенные медицинские стационарные.	32.50.21	9019 20	- целостность стента	Соответствует/не соответствует
					- размеры	Соответствует/не соответствует
					- проходимость	Соответствует/не соответствует
					Защита от повреждений при хранении и транспортировании	-
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	-
					Требования к применяемым материалам	Соответствует/не соответствует
					Требования к системе управления	Соответствует/не соответствует
					Требования к системе контроля и связи	Соответствует/не соответствует
					Требования к конструкции, обеспечивающие пожаробезопасность бароаппаратов	Соответствует/не соответствует
671.	ГОСТ Р 57217	Барокамеры медицинские многостенные	32.50.21	9019 20	Требования к конструкции, обеспечивающие электробезопасность бароаппаратов	Соответствует/не соответствует
					Требования к конструкции, обеспечивающие электробезопасность бароаппаратов	Соответствует/не соответствует
					Требования к применяемым материалам	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры и размеры:	
					- рабочее давление	1,0 МПа
					- внутренний диаметр корпуса	Не менее 1800 мм
					- диаметр в свету входного люка в отсек	Не менее 700 мм
					- диаметр в свету переходного круглого люка из отсека в барокамеру (отсек)	Не менее 700 мм
					- длина медицинского круглого шлюза	Не менее 300 мм
					- диаметр в свету медицинского круглого шлюза	Не менее 200 мм

					- диаметр смотровых иллюминаторов в свету - диаметр световых иллюминаторов в свету - Обеспечиваемая длительность пребывания людей в условиях повышенного давления газовой среды - Основные показатели и характеристики (свойства) - Требования к сырью, материалам, купленным изделиям - Комплектность - Маркировка - Упаковка	- Не менее 200 мм - Не менее 105 мм 240 ч - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует
672.	ГОСТ Р 51936	Барокамеры	32.50.21	9019 20	Идентификация маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
673.	ГОСТ 28386	Аппаратура гипербарической оксигенации	32.50.21	9019 20	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Основные параметры:	
					- содержание кислорода в рабочем газе	Не более 23% / 100%
					- максимальное давление изопрессии (рабочее давление)	150 – 1000 кПа
					- минимальное давление изопрессии	20 кПа
					- максимальное парциальное давление кислорода во вдыхаемом газе	190 – 500 кПа
					- максимальная скорость компрессии	50 – 200 кПа/мин
					- максимальная скорость декомпрессии	50 – 200 кПа/мин
					- материалоемкость	0,3 – 5 кг/кПа·м³
					- интенсивность орошения системы пожаротушения	0,2 – 0,3 кг/м²·с
					- количество функциональных устройств	2 – 10

					- количество диагностических приборов Технические требования: - скорректированный уровень звуковой мощности, создаваемый аппаратом ГБО на расстоянии 1 м от аппаратуры - уровень вентилируемости внутри барокамеры - уровень температуры внутри барокамеры - уровень влажности внутри барокамеры Безопасность	2 - 10	
674.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-36	Аппараты для экстракорпоральной литотрипсии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация Непрерывное воздействие Сила, необходимая для приведения в действие ножного переключателя Функциональные характеристики	Не более 62 дБА Не менее 14 м³/ч·чел (23±3) °С От 65 до 85% Соответствует/не соответствует	
675.	ГОСТ 30324.3	Аппараты для коротковолновой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация: классификация Идентификация, маркировка и документация Номинальная выходная мощность Функциональные характеристики	- - Не более 500 Вт Соответствует/не соответствует	
676.	ГОСТ 30324.10	Стимуляторы нервов и мышц	26.60.13	9018 90	Идентификация: классификация Идентификация, маркировка и документация Функциональные характеристики Предельный ток Значения длительностей импульса	- - Соответствует/не соответствует 0 - 100 мА ±30% при измерении с погрешностью не более ±10% с нагрузочным резистором	

677.	ГОСТ 30324.14	Аппараты для электрошоковой терапии	26.60.13	9018 90	Идентификация, маркировка и документация Функциональные характеристики Нарушение электропитания Выходная энергия Уровень звукового давления Максимальное установившееся значение ограничителя времени Площадь проводящей поверхности каждого из электродов Путь утечки Воздушный зазор Термины и определения	- Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 100 Дж при сопротивлении нагрузки 300 Ом 30 – 65 дБА 0 – 10 с Не менее 7 см ² 20 – 50 мм 10 – 50 мм -
678.	ГОСТ 23498	Аппаратура искусственного кровообращения	32.50.21	9018 19 9018 90	Термины и определения	-
679.	ГОСТ Р 51945	Аспираторы	26.60.12	9018 90	Классификация Параметры питания: - от сети переменного тока - от автономных источников постоянного тока Устойчивость к климатическим воздействиям Устойчивость к механическим воздействиям Перепад давления Герметичность при рабочих давлениях газовой пробы Комплектность Маркировка Упаковка	- - 220 В, 50 Гц 12 В; 24 В Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Не менее 2,5 кПа Соответствует/не соответствует -
680.	ГОСТ ISO 10079-1	Изделия медицинские для отсасывания. Отсасывающие устройства с электроприводом	26.60.13 32.50.50	9018 90	Идентификация, маркировка и документация Механическая прочность Уровень звукового давления Перелив	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Сохраняет/ не сохраняет работоспособность Выдерживает/ не выдерживает падение с высоты 1 м 30 – 60 дБА Сохраняет/ не сохраняет работоспособность

681.	ГОСТ ISO 10079-2	Изделия медицинские для отсасывания. Отсасывающие устройства с ручным приводом.	26.60.13 32.50.50	9018 90	Распознавание	Соответствует/не соответствует
					Утечка	Наличие/отсутствие
					Прерывание электропитания	Соответствует/не соответствует
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Конструкция	Соответствует/не соответствует
682.	ГОСТ ISO 10079-3	Изделия медицинские для отсасывания. Отсасывающие устройства, приводимые в действие источником вакуума или давления.	26.60.13 32.50.50	9018 90	Внутренний диаметр отсасывающих трубок	Не менее 6 мм
					Размеры	Соответствует/не соответствует
					Масса	0 – 6 кг
					Внутренний диаметр входного отверстия в контейнере-сборнике	Не менее 6 мм
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Внутренний диаметр входного отверстия в контейнере-сборнике	Не менее 6 мм
					Объем контейнера-сборника	Не менее 200 мл
					Внутренний диаметр отсасывающей трубки	Не менее 6 мм
					Утечка воздуха	Не более 200 мл/мин
					Устойчивость	Угол наклона 20°
					Масса	0 – 6 кг
					Отсасывающее устройство с высоким расходом воздуха и высоким вакуумом	Не менее минус 60 кПа
					Отсасывающее устройство со средним вакуумом	минус 20 – минус 60 кПа
					Минимальное значение свободного расхода воздуха в отсасывающем устройстве	20 л/мин
683.	ГОСТ 25047		32.50.21	3926 90	Маркировка	Вакуум не менее 40 кПа за 10 с
					Документация	Соответствует/не соответствует
					Классификация	-

684.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-24	Изделия медицинские электрические. Насосы и контроллеры инфузионным	32.50.21	9018 39 9018 90	9018 90	Размеры устройств	1,5 – 1530 мм
						Обозначение вида устройства	-
						Герметичность соединения деталей	40 кПа
						Прочность соединения деталей устройства	Не менее 50 Н
						Самозатягиваемость	-
						Устойчивость при климатических и механических воздействиях в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения	Устойчивы/не устойчивы
						Комплектность	Соответствует/не соответствует
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Классификация	-
685.	ГОСТ 22649	Стерилизаторы воздушные медицинские	32.50.12	8419 20	8419 20	Идентификация, маркировка и документация	-
						Распознавание жидкостей	IPX1 или лучше
						Сигнал опасности низкого приоритета	Не менее чем за 30 мин до прекращения работы вследствие разрядки батареи
						Сигнал опасности высокого приоритета	Сигнал тревоги должен работать не менее 3 мин
						Функциональные характеристики	Соответствует/не соответствует
						Классификация	-
						Полезный объем	1 – 1300 дм³
						Потребляемая мощность в режиме разогрева	0 – 60 кВт
						Работоспособность	220 В; 380 В 50 или 60 Гц
						Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания замков	0 – 150 Н
						Время нагрева	0 – 75 мин
						Корректируемый уровень звуковой мощности	30 – 85 дБА
						Устойчивость при климатических и механических	Устойчивы/не устойчивы

					воздействиях в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения	
					Устойчивость при дезинфекции	Устойчивы/не устойчивы
					Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
686.	ГОСТ 31598	Стерилизаторы паровые большие.	32.50.12	8419 20	Требования к конструктивным элементам	-
					Приборы (устройства) для индикации и регистрации	Соответствует/не соответствует
					Системы управления	Соответствует/не соответствует
					Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Время выравнивания	0 – 15 с
					Сухость загрузки	0 – 1%
					Уровень шума	30 – 70 дБА
					Скорость изменения давления	Не более 1000 кПа/мин
					Маркировка	-
687.	ГОСТ Р EN 13060	Стерилизаторы паровые малые	32.50.12	8419 20	Двери и запорные устройства	Соответствует/не соответствует
					Контрольный соединитель (соединители)	Соответствует/не соответствует
					Воздушный фильтр	Соответствует/не соответствует
					Контрольно-измерительная аппаратура, устройства индикации и регистрации	Соответствует/не соответствует
					Системы управления	Соответствует/не соответствует
					Минимальное время выдержки при стерилизации	1 – 15 мин
					Время установления равновесия	0 – 30 с
					Электропитание	
					Температура воды и пара, сливаемых во внешнюю дренажную систему	0 – 100°C
					Маркировка и сопутствующая документация	-
					Скорость повышения давления	Не более 0,13 кПа/мин

					Скорость изменения давления	Не более 10 бар/мин для любого двухсекундного интервала
					Содержание влаги для твердой загрузки	Не более 0,2%
					Содержание влаги для пористой загрузки	Не более 1,0%
688.	ГОСТ ISO 11140-1	Химические индикаторы	32.50.50	8419 20	Идентификация: маркировка метода стерилизации	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, инструкция или вкладыш технической информации	Соответствует/не соответствует
					Видимое изменение	Соответствует/не соответствует
689.	ГОСТ Р 57623	Стерилизаторы на основе этиленоксида	32.50.50 32.50.12	8419 20	Размер камеры стерилизатора	Соответствует/не соответствует
					Двери, замки и блокировки камеры	Соответствует/не соответствует
					Контрольные соединители	Соответствует/не соответствует
					Система откачки	Соответствует/не соответствует
					Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует
					Упаковка, маркировка и этикетки	-
					Информация, предоставляемая изготовителем	
690.	ГОСТ ISO 15883-1 п.7	Машины моюще- дезинфицирующие.	32.50.50	8422 20 7418 20	Маркировка, прикрепление этикеток, ярлыков или бирок и упаковка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
691.	ГОСТ ISO 15883-2	Машины моюще- дезинфицирующие, использующие термическую дезинфекцию	32.50.50	8422 20 7418 20	Длительность фазы термической дезинфекции	Не менее 3000 с
					Присоединительные устройства для загрузки	Соответствует/не соответствует
					Система управления	Соответствует/не соответствует
					Температура внутренних поверхностей изделий	Соответствует/не соответствует

						Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
692.	ГОСТ Р ИСО 15883-3	Машины моюще-дезинфицирующие, использующие термическую дезинфекцию контейнеров для отходов жизнедеятельности человека	32.50.50	8422 20 7418 20		Точность средств контроля объема добавок	Соответствует/не соответствует ±10%
						Работоспособность дренажного гидрозатвора	Соответствует/не соответствует
						Проверка вымывания неабсорбирующих материалов	Соответствует/не соответствует
						Проверка вымывания абсорбирующих материалов	Соответствует/не соответствует
						Проверка загрузки/опорожнения контейнеров	Соответствует/не соответствует
693.	ГОСТ Р ИСО 15883-4	Машины моюще-дезинфицирующие	32.50.50	8419 20 8422 20 7418 20		Проверка удаления загрязнений со стенок камеры, держателя загрузки и из загрузки	Соответствует/не соответствует
						Обязательная информация, предоставляемая производителем	Соответствует/не соответствует
						Требования к рабочим характеристикам	Соответствует/не соответствует
						Требования к механическим частям и процессу	Соответствует/не соответствует
						Информация, предоставляемая изготовителем	-
694.	ГОСТ 4.363	Оборудование дезинфекционное	32.50.50	3006 10		Номенклатура показателей	-
695.	ГОСТ 4.365		32.50.50	8419 20		Номенклатура показателей качества стерилизационного оборудования	-
696.	ГОСТ 22340	Аквадистилляторы медицинские электрические.	32.50.12	8419 20		Классификация	-
			28.29.11	8419 40		Производительность	4 – 250 л/ч
						Удельный расход исходной воды	Не более 25 л/л
						Работоспособность от сети переменного тока	220 В; 380 В
						Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
697.	ГОСТ 20887	Аквадистилляторы	32.50.12	8419 20		Вибро- и ударопрочность	Соответствуют/не соответствуют
			28.29.11	8419 40			Соответствует/не соответствует
698.	ГОСТ 28165	Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные	28.29.11	8419 40		Классификация	Соответствует/не соответствует
						Номинальная производительность	1, 2, 4, 8, 12 л/ч

699.	ГОСТ EN 14180 п. 8	Стерилизаторы медицинского назначения. Стерилизаторы низкотемпературные пароформальдегидные.	32.50.12	8419 20	Удельная электрическая проводимость дистиллята при 20°C	Не более $3,3 \cdot 10^{-4} \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$ Не более $8 \cdot 10^{-5} \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$
					Удельный расход электроэнергии	Не более 0,75 кВт/л / Не более 1,5 кВт/л
					Удельный расход охлаждающей воды при температуре $t_{\text{вх}} \approx 13^\circ\text{C}$	Не более 10 л/л / Не более 20 л/л
					Номинальная вместимость куба	0,01 – 6 л
					Диаметр активной зоны	6 – 75 мм
					Высота активной зоны (высота слоя насадки)	200 – 2000 мм
					Число реальных тарелок	Не менее 20, 40, 50 шт
					Рабочая температура в кубе	$20^\circ\text{C} - 250^\circ\text{C}$
					Диапазон рабочего давления	0,1 – 100 кПа
					Номинальный внутренний диаметр корпуса испарителя	30, 50, 80 мм
					Номинальная рабочая поверхность испарителя	0,03; 0,1; 0,2 м ²
					Номинальная вместимость испарительной колбы	0,05 – 20 л
					Диапазон частоты вращения	20 – более 1000 мин ⁻¹
					Диапазон температуры теплоносителя	$0^\circ\text{C} - \text{более } 250^\circ\text{C}$
					Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Маркировка и этикетки	Соответствует/не соответствует
					Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
700.	ГОСТ Р 57766	Кресла-стулья с санитарным оснащением	32.50.50	9402 10 9402 90	Показатели назначения:	
					- эффективная глубина сидения	Не менее 280 мм для взрослых/ Не менее 200 мм для детей
					- ширина сидения	Не менее 360 мм для взрослых/ Не менее 210 мм для детей
					Конструктивные требования:	
					- длина	Не более 1200 мм/ для усиленных не более 1750 мм
					- ширина	Не более 700 мм/ для усиленных не более 850 мм
					- расстояние между подлокотниками	Не менее 420 мм
					- расстояние от пола до нижней кромки передней подложки	Не менее 300 мм

					- усилие для торможения ведущих колес - минимальный радиус поворота при развороте на 360° - минимальная ширина разворота при развороте на 360° - Комплектность - Маркировка - Упаковка - Безопасность	- Не более 60 Н (стояночный тормоз) / Не более 100 Н (рабочий тормоз) - Не более 650 мм - Не более 1100 мм - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует 180 – 650 мм
701.	ГОСТ 30493	Изделия санитарные керамические	23.42.10	6909 90 6910 90	Габаритные размеры	
702.	ГОСТ 19715	Эмблема Красного Креста.	-	-	Номинальный диаметр эмблемы	5 – 4000 мм
703.	ГОСТ 16940	Носилки санитарные	32.50.50 30.99.10	9021 90 8716 80	Размеры эмблемы	0,1 – 2960 мм
					Усилие, необходимое для выдвигания (возвращения) или вращения рукоятки	0 – 150 Н
					Усилие, необходимое для развертывания носилок	0 – 300 Н
					Прогиб брусьев	0 – 20 мм
					Прогиб несущей основы в вертикальной плоскости	0 – 45 мм
					Расстояние между мягким ложем и опорной плоскостью	Не менее 10 мм
					Остаточная деформация на брусках или несущих основах носилок после снятия нагрузки	0 – 3 мм
					Масса	0 – 20 кг
					Работоспособность после климатических воздействий	Работоспособны/не работоспособны
					Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
704.	ГОСТ 33665	Автомобили скорой медицинской помощи.	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90	Габаритные размеры автомобилей	Не более 6500 мм
					Время разгона автомобиля до 80 км/ч	5 – 35 с

705.	ГОСТ Р 56328	Изделия медицинские. Подвижные (передвижные)	32.50.50 29.10.30 29.10.2	8703 23 8705 90 9018 90			Размеры дверного проема в перегородке	Не менее 1500 мм
							Площадь сдвижного окна	Не менее 0,1 м ²
							Внутренние габаритные размеры медицинского салона	Не менее 1250 мм
							Размеры проемов дверей	Не менее 660 мм
							Максимальное усилие открывания (закрывания) дверей	Не более 120 Н
							Максимальная высота пола медицинского салона	Не более 750 мм
							Угол наклона носилок при погрузке	Не более 16°
							Расстояние между серединой ручек носилок и уровнем дороги при погрузке или выгрузке пациента, лежащего на носилках	Не более 825 мм
							Размеры потолочного люка	Не более 500х700 мм
							Площадь проёма потолочного люка	Не менее 0,4 м ²
							Усилие открывания (закрывания) крышки люка	0 – 120 Н
							Ширина сидений	Не менее 450 мм
							Глубина сидений	Не менее 300 мм
							Высота сидений над уровнем пола	Не менее 420 мм
							Высота спинки с подголовником	Не менее 750 мм
							Толщина подушек сидений	Не менее 50 мм
							Угол спинки сиденья	15°
							Проход по всей длине носилок	Не менее 240 мм
							Устойчивость материалов к моеюще-дезинфицирующим средствам	Устойчивы/не устойчивы
							Емкость стартерной аккумуляторной батареи	Не менее 54 Ач
							Емкость дополнительной аккумуляторной батареи	Не менее 80 Ач
							Мощность генератора	700 – 1500 Вт
							Освещенность рабочих мест медицинского салона	50 – 300 лк
							Угол поперечной устойчивости с технически допустимой максимальной массой	Не менее 28°

	комpleксы медицинского назначения.	29.10.59			Время разгона СДТС до 80 км/ч	Не более 35 с
					Температура воздуха в помещениях ПКМН	Не менее 15 °С
706.	ГОСТ Р 56330	Изделия медицинские. Технические средства размещения и перемещения больных и пострадавших на догоспитальном этапе.	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90	Общий уровень освещенности ПКМН	Не менее 100 лк
					Местное освещение на рабочих местах и манипуляционных полях	Не менее 150 лк
					Уровень аварийного освещения	Не менее 30 лк
					Рабочее давление в системе снабжения газами	400 кПа/не более 40 кПа
					Расстояние органов управления:	
					- от уровня пола при управлении стоя	1000 – 1600 мм
					- от уровня пола при управлении сидя	600 – 1200 мм
					Усилие, прикладываемые к органам управления	0 – 35 Н
					Усилие фиксации и расфиксации съемного оборудования	0 – 147 Н
					Усилие открывания/закрывания дверей и люков	0 – 118 Н
					Классификация	-
					Номинальная нагрузка на панель ТСРП	Не менее 150 кг
					Устойчивость к дезинфекционной обработке	Устойчивы/не устойчивы
					Внешний вид поверхности ТСРП	Соответствует/не соответствует
					Усилие, необходимое для приведения рукояток в рабочее положение	0 – 150 Н
					Отсутствие перемещения рукояток	Соответствует/не соответствует
					Усилие, прилагаемое к механизмам трансформации складных панелей	0 – 300 Н
					Изменение углов наклона секций панели	0 – 70°
					Усилие, необходимое для фиксации положений секций на ручках управления и рукоятках	0 – 80 Н

707.	ГОСТ Р EN 13718-1	Медицинские транспортные средства и их оборудование. Авиационные транспортные	32.50.50 29.10.30 29.10.2	8703 23 8705 90 9018 90			зажимов механических приводов подъема секций	Соответствует/не соответствует	
							Внешний вид строчки машинных швов	соответствует	
							Шаг строчки	3 – 4 мм	
							Усилие, необходимое для развертывания носилок	0 – 300 Н	
							Длина каркасных носилок	Не более 2200 мм	
							Масса носилок при номинальной нагрузке 1500 Н	Не более 25 кг	
							Диаметр колёс тележек-каталок	Не менее 150 мм	
							Зазор между одной из опор и горизонтальной плоскостью	0 – 3 мм	
							Усилие, необходимое для перевозки пациентов на тележке-каталке с колесными опорами по твердой поверхности	0 – 150 Н	
							Усилие, необходимое для фиксации съёмных элементов	0 – 80 Н	
							Масса тележки-каталки	Не более 40 кг	
							Усилия управления рабочими элементами устройства приемного	0 – 150 Н	
							Приемное смещение	Не менее 125 мм	
							Высота подъема панели приемного устройства	0 – 350 мм	
							Высота подъема панели с равномерно распределенной на ней полуторакратной номинальной нагрузкой за один полный ход педали привода	Не менее 6 мм	
							Усилие, прикладываемое к педали привода	0 – 300 Н	
							Самостоятельное опускание секций панели	Не более 5 мм/ч	
							Мощность, потребляемая электрическим двигателем устройства приемного от бортовой сети транспортного средства	Не более 500 ВА	
							Работоспособность в диапазоне температур и влажности	Работоспособны/не работоспособны	
							Степень защиты оболочки	IPX3	

		средства медицинского назначения. Медицинские изделия, используемые в авиационных транспортных средствах медицинского назначения	29.10.59		Работоспособность для напряжения питания 13,8 В/ 27,5 В/230 В Напряжение встроенных батарей Информация, предоставляемая производителем Работоспособность при свободном падении Общая освещенность медицинского салона Освещенность рабочей зоны медицинского салона Напряжение розетки Суммарный ток потребления Габаритные размеры рабочей зоны	Работоспособны/не работоспособны 12,4 – 15,1 В 24,8 – 30,3 В Соответствует/не соответствует 300 лк 400 лк 12,4 – 15,1 В Не менее 25 А Не менее 970 мм
708.	ГОСТ Р EN 13718-2	Медицинские транспортные средства и их оборудование. Авиационные транспортные средства медицинского назначения. Авиационные транспортные средства медицинского назначения	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8703 23 8705 90 9018 90		
709.	ГОСТ Р ИСО 11199-1	Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками.. Ходунки	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Усталостная и статическая прочность Устойчивость Максимальная ширина ходунка Ширина рукоятки Диаметр части наконечника, которая контактирует с поверхностью ходьбы Маркировка и надписи	Отсутствие трещин и сколов Не менее 10° Не более 650 мм 20 – 50 мм Не менее 35 мм Соответствует/не соответствует
710.	ГОСТ Р ИСО 11199-2	Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Ходунки на колесах	32.50.22	9021 10 9021 29 9021 31	Диаметр переднего колеса Ширина колеса Устойчивость Максимальное расстояние до рычага Скорость ходунков Максимальное усилие для приведения в действие и отключения стояночных тормозов Ширина рукоятки Минимальный диаметр части наконечника, контактирующей с поверхностью перемещения Статическая прочность: - остаточная деформация	Не менее 75 мм Не менее 22 мм Не менее 3,5° Не более 75 мм Не более 10 мм/мин Не более 60 Н 20 – 50 мм 35 мм Отсутствие трещин или сколов

						Регулируемые элементы		Соответствует/не соответствует
						Механизм складывания	Не более 1%	
711.	ГОСТ Р ИСО/ТО 13570-1	Кресла-коляски	32.50.50			Регулировка ручек	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Информация, поставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует	
						Информация, наносимая на изделие и/или вспомогательное оборудование	Соответствует/не соответствует	
						Документация	Соответствует/не соответствует	
						Рекомендации по применению стандартов ИСО серии 7176 на кресла-коляски	-	
712.	ГОСТ Р ИСО 7176-1	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Передняя статическая устойчивость	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Задняя статическая устойчивость	Соответствует/не соответствует	
						Боковая статическая устойчивость	Соответствует/не соответствует	
713.	ГОСТ Р ИСО 7176-2	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Продольная задняя динамическая устойчивость кресла-коляски	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Продольная передняя динамическая устойчивость кресла-коляски	Соответствует/не соответствует	
						Боковая динамическая устойчивость кресла-коляски	Соответствует/не соответствует	
714.	ГОСТ Р ИСО 7176-3	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Работа тормозов	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
715.	ГОСТ Р ИСО 7176-4	Кресла-коляски с электроприводом и скутеры	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Испытание при непрерывном вождении	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Испытание при маневрировании	Соответствует/не соответствует	
							Соответствует/не соответствует	
716.	ГОСТ Р ИСО 7176-5	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Классификация	Соответствует/не соответствует	Соответствует/не соответствует
						Полная габаритная длина	Соответствует/не соответствует	
						Габаритная ширина	Соответствует/не соответствует	
						Высота рукоятки	Соответствует/не соответствует	
						Длина в сложенном состоянии	Соответствует/не соответствует	
						Ширина в сложенном состоянии	Соответствует/не соответствует	
						Высота в сложенном состоянии	Соответствует/не соответствует	

					Высота подъема Общая масса Масса самой тяжелой части Ширина вращения Ширина разворота Диаметр вращения Клиренс Необходимая ширина углового коридора Необходимая глубина дверного проема Необходимая ширина коридора для бокового прохода Представление информации					
717.	ГОСТ Р ИСО 7176-6	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20		Максимальная скорость Ускорение Замедление	Соответствует/не соответствует			
718.	ГОСТ Р ИСО 7176-7	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20		Эффективная глубина сиденья Ширина сиденья Эффективная ширина сиденья Высота сиденья Угол наклона спинки Высота спинки Ширина спинки Расстояние между подголовником и спинкой Высота расположения подголовника над сиденьем Длина подножки Клиренс опоры стопы Длина опоры стопы Угол наклона опоры стопы Угол наклона подножки к поверхности сиденья Высота подлокотника Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья Длина подлокотника	Соответствует/не соответствует			

						Ширина подлокотника	
						Угол наклона подлокотника	
719.	ГОСТ Р ИСО 7176-8	Кресла-коляски	32.50.50			Расстояние между подлокотниками	
						Расположение фронтального узла подлокотника	
						Диаметр обода ручного привода	
						Диаметр ведущего колеса	
						Горизонтальное положение оси ведущего колеса	
						Вертикальное положение оси ведущего колеса	
						Диаметр поворотного колеса	
720.	ГОСТ Р ИСО 7176-9	Кресла-коляски	32.50.50			Статистическая прочность	8713 10 8713 90 8714 20
						Ударная прочность	
						Усталостная прочность	
721.	ГОСТ Р ИСО 7176-10	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Нагружаемая сила	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 15 Н – 2000 Н
						Воздействие температур	Выдержано/не выдержано
						Защита от проникновения жидкостей	Выдержано/не выдержано
722.	ГОСТ Р ИСО 7176-11	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30			Способность кресел-колясок с электроприводом преодолевать препятствия при подъеме и спуске	5 – 200 мм
						Переднее положение шарниров лодыжки относительно задней стороны нагрузочных пластин ступни	(70±15) мм
						Относительная высота шарниров лодыжки над низом нагрузочных пластин ступни	(60±15) мм
						Ненагруженная толщина пенопластовой проставки нагрузочной прокладки бедра	(30±5) мм
						Размер нагрузочной пластин бедра	80 – 680 мм

					Размер нагрузочной пластины туловища	180 – 650 мм
					Размер нагрузочной пластины ступни	80 – 300 мм
723.	ГОСТ Р ИСО 7176-13	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Коэффициент трения гладких или полированных испытательных поверхностей	0,75 – 1,0
724.	ГОСТ Р ИСО 7176-14	Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом	32.50.50	8713 90 8714 20	Максимальная скорость кресла-коляски на горизонтальной поверхности Максимальный тормозной путь L, при скорости (0,5±0,05) V кресла-коляски, движущаяся вниз по наклонной плоскости Устойчивость к единичному отказу Конструктивные особенности Защита от удара электрическим током, ожогов, возгорания и взрыва Эргономика Надежность Электрические разъемы Требования к экологии Обратная поляриность комплекта аккумуляторных батарей Целостность защитных экранов Информация, предоставляемая с креслом-коляской, относящаяся к системам управления Информация, предоставляемая изготовителем	Соответствует/не соответствует
725.	ГОСТ Р ИСО 7176-15	Кресла-коляски.	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Обеспечение доступности информации по испытаниям, предоставляемой изготовителем в паспорте изделия	Соответствует/не соответствует
					Документация	-
					Маркировка	-

726.	ГОСТ Р ИСО 7176-16	Кресла-коляски.	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Отсутствие признаков прогрессивного тления или воспламенения внутри и/или в течение 120 с после удаления источника возгорания	Отсутствие/наличие
					Отсутствие площади, поврежденной горением, более 600 мм ² на любом слое при испытании в горизонтальной позиции	Отсутствие/наличие
					Отсутствие площади, поврежденной горением, более 4500 мм ² на любом слое при испытании в вертикальной позиции	Отсутствие/наличие
727.	ГОСТ Р ИСО 7176-21	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость к электростатическим разрядам	±2; ±4; ±6; ±8 кВ
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	12 В/м 26 МГц – 1 ГГц
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	1 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	1 – 2 кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями	150 кГц – 80 МГц 3 В
					Устойчивость к провалам напряжения электропитания	0,6 Вн; 0,7 Вн
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	Не более 0,05 Вн 250 периодов
728.	ГОСТ Р ИСО 7176-22	Кресла-коляски	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Регулировка параметров кресла-коляски	Соответствует/не соответствует
729.	ГОСТ Р ИСО 7176-25	Кресла-коляски. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Степень защиты Маркировка	Не менее IPX4 Соответствует/не соответствует
					Руководство пользователя	Соответствует/не соответствует

730.	ГОСТ Р ИСО 7176-26	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Термины и определения	-
731.	ГОСТ Р ИСО 7176-28	Кресла-коляски. Устройства для преодоления лестниц	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Эффективность тормозов	Соответствует/не соответствует
					Статическая устойчивость на поверхности перемещения, режим преодоления	Не менее 5°
					Статическая устойчивость на поверхности перемещения, режим перемещения	Не менее 5°
					Статическая устойчивость на лестнице	Не менее 7°
732.	ГОСТ 30471/ГОСТ Р 50602	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Прямые рабочие усилия	Не более 400 Н
					Габаритная длина L	До 1750 мм
					Габаритная ширина B	До 1000 мм
733.	ГОСТ 30472/ГОСТ Р 50603	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Габаритная высота H	До 1090 мм
					Идентификация классификация	-
734.	ГОСТ 30473	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Передняя статическая устойчивость:	Соответствует/не соответствует
					- предельный угол наклона	20°
					Боковая статическая устойчивость:	
					- предельный угол наклона	25°
735.	ГОСТ 30474	Кресла-коляски	32.50.50	8713 10 8713 90 8714 20	Полная габаритная длина	200 – 650 мм
					Габаритная ширина	200 – 300 мм
					Высота рукоятки	100 – 200 мм
					Общая масса	10 – 50 кг
736.	ГОСТ 30476	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.50	8713 90 8714 20	Продольная задняя динамическая устойчивость:	
					- угол наклона плоскости	20°
					- высота ступени	100 -200 мм
737.	ГОСТ 30477	Кресла-коляски с электроприводом	32.50.50	8713 90 8714 20	Максимальная скорость	10 – 15 м/с
738.	ГОСТ Р 51083	Кресла-коляски.	32.50.22 30.92.20 30.92.30	8713 10 8713 90 8714 20	Габаритные размеры в рабочем состоянии:	
					- полная длина	Не более 1200 мм
					- ширина	Не более 700 мм
					- высота	Не более 1200 мм

	Габаритные размеры в отложенном состоянии:		
	- длина	Не более 900 мм	
	- ширина	Не более 350 мм	
	- высота	Не более 1200 мм	
	Клиренс	Не менее 30 мм	
	Высота рукоятки	900 – 1200 мм	
	Диаметр вращения кресла-коляски	Не более 1200 мм	
	Ширина разворота кресла-коляски	Не более 1300 мм	
	Масса полностью оснащенного для нормального использования кресла-коляски	Не более 35 кг	
	Стойкость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы	
	Статическая устойчивость в продольном направлении движения при включении тормозной системы	10°	
	Максимальный зазор между поверхностью и одним из колес	Не более 3 мм	
	Устойчивость после падения с высоты 1 м в сложенном виде	Устойчиво/не устойчиво	
	Грузоподъемность	50 кг, 100 кг	
	Усилия, приложенные к ручкам кресла-коляски и каждому ободу ручного привода кресла-коляски для совершения маневра загруженного манекеном кресла-коляски	Не более 100 Н	
	Усилия, необходимое для перемещения движущегося со скоростью, равной 1 м/с, в заданном направлении по ровной поверхности	Не более 45 Н	
	Усилия, необходимое для фиксации в определенных положениях кресла-коляски и его элементов	Не более 100 Н	
	Отклонение от "нулевой" линии (боковой увод)	Не более 500 мм	

					Удержание нагруженного манекеном кресла-коляски в заторможенном состоянии	10°	
					Максимальное усилие для торможения ведущих колес кресла-коляски, прилагаемое:	Не более 60 Н	
					- к рукоятке стояночного тормоза	Не более 100 Н	
					- к рукоятке рабочего тормоза	Не более 110 Н	
					Максимальные усилия на рычаг тормоза	Не более 0,35 Н	
					Усилие вращения ведущих колес	Соответствует/ не соответствует	
					Ведущие колёса:		
					- развал	Не более 2°	
					- схождение	Не более 1°	
					- концентричность и биение	Не более 1% радиуса колеса	
					Требования к соединениям	Соответствует/не соответствует	
					Угол расположения ручек	85°	
					Расстояние между ручками	Не менее 350 мм	
					Длина рукоятки	Не менее 75 мм	
					Диаметр рукоятки	20 – 50 мм	
					Ширина захвата элементов рукоятки	Не более 75 мм	
					Высота подножки	Не более 25 мм	
					Просвет между раздельными опорами ступней	Не более 35 мм	
					Комплектность	-	
					Документы изготовителя	-	
					Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	-	
					Идентификация: классификация и обозначение	-	
739.	ГОСТ Р 57887	Сиденья кресел-колясок	32.50.50	8714 20		Не более 15 Н	
740.	ГОСТ Р ИСО 16840-2	Полушки сиденья	32.50.50	9021 10		10 – 150 мм	
741.	ГОСТ Р ИСО 16840-3	Устройства, поддерживающие положение тела	32.50.50	9021 10		320 МПа	
742.	ГОСТ Р ИСО 10535	Подъемники для инвалидов.	32.50.22 30.92.30	9021 10 8714 10		145 Н	
					Расстояние между любой ручкой и любой частью конструкции	Не менее 35 мм	

					Расстояние между любой верхней поверхностью педали и любой другой частью подъемника Не менее 75 мм	
					Диаметр любой функциональной ручки 19 – 43 мм	
					Расстояние от пола до педалей Не более 300 мм	
					Расстояние от пола до ручной системы управления 800 – 1200 мм	
					Высота расположения ручек Не менее 900 мм	
					Грузоподъемность Не менее 120 кг	
					Скорость подъема или опускания ЦТП в нагруженном состоянии Не более 0,15 м/с	
					Скорость подъема или опускания ЦТП при отсутствии нагрузки Не более 0,25 м/с	
					Требования к прикладываемым силам/моментам Не более 300 Н и 1,9 Нм	
					Информация, поставляемая изготовителем -	
					Безопасность Соответствует/не соответствует	
					Уровень звукового давления 30 – 70 дБ	
					Допустимое напряжение в деталях 92 – 240 Н/мм²	
					Допустимое напряжение в сварочных швах 113 – 240 Н/мм²	
					Предохранительное устройство от падения Наличие/отсутствие	
					Предохранительное устройство от скатывания Высота 15 см, нагрузка F=500 Н	
					Угол установки не более 110° Угол установки не более 110°	
					Руководство по эксплуатации Соответствует/не соответствует	
					Предостерегающие обозначения Соответствует/не соответствует	
					Угол наклона грузонесущего устройства от горизонтальной плоскости Не более 10°	
					Усилие, прилагаемое к устройству при подъеме Не более 235 Н	
743.	ГОСТ Р 55137	Подъемники, встроенные в дорожный транспорт, для людей, пользующихся креслами-колясками, и других людей с ограничениями жизнедеятельности	30.92.30	8714 10		
744.	ГОСТ Р 55556	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Платформы подъемные с наклонным перемещением	30.92.30	8714 10		

					грузонесущего устройства с грузом	
					Уровень освещения посадочных площадок	Не менее 50 лк
					Напряжение питания розеток	Не более 254 В
					Напряжение питания розеток для подключения переносных ламп	Не более 42 В
					Сопротивление изоляции между проводниками и между проводниками и землей	Не менее 250 кОм
					Площадь поперечного сечения жил токоподводящего кабеля	Не менее 0,75 мм ²
					Техническая документация	Соответствует/не соответствует
745.	ГОСТ Р 54406	Пандусы, установленные на транспортных средствах, для пользователей кресел-колясок и людей с ограниченной подвижностью	32.50.22 30.92.30	9021 10 8714 10	Безопасность	Соответствует/не соответствует
					Ширина рукоятки	Не менее 95 мм
					Рабочая скорость	Не более 0,6 м/с
					Номинальная грузоподъемность	Не менее 300 кг в выдвинутом положении, без перемещения
					Уровень звукового давления	30 – 70 дБ
					Допустимые напряжения в деталях	92 – 240 Н/мм ²
					Допустимые напряжения в сварочных швах	113 – 240 Н/мм ²
					Грузоподъемность и приводные усилия пандусов, управляемых вручную и с ручным приводом	Не более 150 Н
					Сила удара:	
					- сила удара пандуса о препятствие	Не более 150 Н
					Максимальная сила	Не более 250 Н
					Руководство по эксплуатации	-
					Маркировка	-
746.	ГОСТ Р 51084	Тележки для транспортирования пациентов и грузов	32.50.50 30.99.10	9402 90	Идентификация: классификация	-
					Основные параметры и размеры:	
					- угловые размеры	Не менее 15°
					- длина панели	1510 – 2175 мм
					- ширина панели	535 – 675 мм

					- высота панели (нижний уровень) - высота панели (верхний уровень) - масса Технические требования: - зазоры - усилия - номинальная нагрузка - средняя скорость самопроизвольного опускания панели - углы наклона Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Диаметр колеса Общая высота Смещение Маркировка	Не более 550 – 805 мм Не менее 900 – 945 мм 40 – 80 кг Не более 3 – 5 мм Не более 50 – 300 Н (5 – 30 кгс) 9,8 – 81 кг Не более 5 мм/ч 15° – 45° - 100 – 250 мм 150 – 300 мм 46 – 80 мм -
747.	ГОСТ Р ИСО 22882	Самоориентирующиеся колесики для больничных кроватей	32.50.50	9402 10 9402 90 9403 90	Классификация Рабочее расстояние светильников Освещенность в центре рабочего поля Размер рабочего поля и диапазон его изменения Удельная облученность рабочего поля Устойчивость к статической нагрузке Устойчивость к климатическим факторам Устойчивость к транспортированию Восстановление работоспособного состояния за счет ЗИП Устойчивость к дезинфекции и стерилизации Устойчивость при опрокидывании	Соответствует/не соответствует 0,7 – 1,5 м 1000 – 200000 лк 40 – 300 мм Не более 5,0 (Вт·м²)/клк Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы Не более 25 мин Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы при 10°
748.	ГОСТ 26368	Светильники медицинские.	32.50.50 27.40.39	9405 40		

749.	ГОСТ 30324.2.41	Смотровые (диагностические) и хирургические светильники	32.50.50 27.40.39	9405 40	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Максимальное усилие крепления и демонтажа ручки	10 Н
					Максимальный момент кручения крепления и демонтажа ручки	1 Н·м
					Усилие преднамеренного демонтажа ручки	Не менее 100 Н
					Крутящий момент преднамеренного демонтажа	Не менее 5 Нм или три или более вращений на 360°
					Устойчивость:	
					- максимальное усилие вертикального позиционирования	Не более 55 Н
					- максимальное усилие горизонтального	Не более 25 Н
					Ультрафиолетовое излучение для длин волн ниже 400 нм	Не более 10 Вт/м ²
					Уровень центральной освещенности	40000 – 160000 лк
					Диаметр светового поля d ₅₀	50% диаметра светового поля d10
					Глубина освещения	60 % световой освещенности
					Индекс цветопередачи Ra	85 – 100
					Цветовая температура излучаемой радиации	3000 – 6700 К
					Полная облученность	Не более 1000 Вт/м ²
750.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-41	Хирургические и смотровые (диагностические) светильники	32.50.50 27.40.39	9405 40	Значение облученности к центральной освещенности	Не более 6 мВт/(м ² ·лк)
					Устойчивость при опрокидывании	10 Н
					Идентификация, маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
					Усилие преднамеренного демонтажа съемной ручки	Не более 10 Н
					Усилие крепления съемной ручки	Не более 1 Нм
					Усилие преднамеренного демонтажа съемной ручки	Не менее 100 Н

Наклон панели по анти-Тренделенбургу	Не менее 30°
Боковой наклон панели	Не менее 20°
Наклон ножной секции панели вниз	Не менее 90°
Высота подъема почечного валика	Не менее 120 мм
Угол наклона спинной секции вверх	Не менее 75°
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений)	Не более 300 кг
Номинальное напряжение однофазного переменного тока для столов с моторным приводом, применяемых в операционной:	
- предельное отклонение напряжения	±10 %
- частота сети внешнего источника питания	49,5 – 50,5 Гц
Скорость подъема и опускания панели стола с моторным приводом и скорость опускания панели стола с ножным или комбинированным приводами под действием собственной массы	$2 \cdot 10^{-3} - 35 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}$
Скорость наклонов панели стола с моторным приводом	1,0 – 4,0 град./с
Высота подъема панели стола с ножным или комбинированным приводом	Не менее 8 мм
Самопроизвольное опускание панели столов	Не более 5 мм за 1 ч
Самопроизвольное изменение наклона панели стола	Не более 3° за 1 ч
Допустимые люфты	Не более 4 мм
Усилие, необходимое для равномерного передвижения столов	Не более 200 Н
Усилия, необходимые для приведения в действие	Не более 300 Н

				исполнительных механизмов привода	
				Корректированный уровень звуковой мощности	30 – 65 дБА
				Максимальная рабочая температура верхних и боковых частей панели стола	Не более 85°C
				Электрическое сопротивление, характеризующее наличие электростатического заряда, между поверхностью матрасов и зажимом защитного заземления столов	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \text{ Ом}$
				Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчивы/не устойчивы
				Устойчивость к механическим воздействиям	Устойчивы/не устойчивы
				Маркировка	Соответствует/не соответствует
				Упаковка	Соответствует/не соответствует
752.	ГОСТ 28131	Кресла стоматологические.	9402 10 32.50.50 32.50.30	Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сиденья	не более 450 мм - в крайнем нижнем положении кресла; не менее 800 мм - в крайнем верхнем положении кресла 5 – 90°
				Минимальный диапазон углов поворота спинки от вертикали	
				Номинальное напряжение питания	220 В или 110 В
				Частота сети	49,5 – 50,5 Гц или 59,4 – 60,6 Гц
				Скорость перемещения верхней части кресел из одного крайнего положения в другое	$10 \cdot 10^{-3} - 35 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$
				Угловая скорость перемещения спинки с моторным приводом из одного положения в другое	$(0,090 \pm 0,045) \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$
				Сохранение заданного положения подголовника	При воздействии на него усилия 200 Н
				Сохранение заданного положения спинки	При воздействии на нее момента силы, относительно оси вращения, равного 240 Н·м
				Самопроизвольное опускание верхней части кресел	Не более 3 мм за 1 ч

					Потребляемая мощность Не более 1000 ВА	на 408 листах, лист 229
					Корректированный уровень звуковой мощности 30 – 70 дБА	
					Устойчивость при воздействии климатических факторов Устойчивы/не устойчивы	
					Устойчивость к механическим воздействиям Устойчивы/не устойчивы	
					Маркировка Соответствует/не соответствует	
753.	ГОСТ 16371	Мебель.	32.50.30 32.50.30 31.09.13 31.01.11 31.01.12	9402 10 9402 90 9401 30 9401 40	Зазоры в проемах на сторону Не более 2 мм Покоробленность щитовых деталей в изделеии Не более 3,5 мм Внешний вид фурнитуры и замков Соответствует/не соответствует Толщина полок из стекла Не менее 6 мм Толщина раздвижных дверей из стекла Не менее 4 мм Внешний вид лицевой поверхности Соответствует/не соответствует Устойчивость изделий корпусной мебели под нагрузкой Не менее 10 даН Маркировка Соответствует/не соответствует Упаковка Соответствует/не соответствует	
754.	ГОСТ 19917	Мебель для сидения и лежаия.	32.50.30 31.01.11	9402 90 9401 30 9401 40	Внешний вид Соответствует/не соответствует Размер заделок Не более 5 см ² Деформация мягкого элемента под нагрузкой 70 даН Не менее 120 мм Податливость 0,2 – 4,2 мм/даН Внешний вид фурнитуры Соответствует/не соответствует Радиус закругления ребер Не менее 3 мм Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения Не менее 25 мм Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати Не менее 260 мм	

Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца	Не менее 160 мм				
Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения	60 – 100 мм				
Величина разъема ограждения для приставной лестницы	300 – 400 мм				
Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за другом ступеней лестницы	200 – 300 мм				
Расстояние между двумя последовательно расположенными ступенями	Не менее 200 мм				
Полезная длина ступени	Не менее 300 мм				
Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и элементами ограждения	Не более 25 мм				
Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы:					
- устойчивость	2 – 15 даН				
- статическая прочность сиденья	100 – 160 даН				
- статическая прочность спинки	40 – 75 даН				
- статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении	30 – 60 даН				
- статическая прочность подголовника в боковом направлении	20 – 40 даН				
- статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки	70 – 90 даН				
- статическая прочность ножек	35 – 120 даН				
- прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали	25 – 50 даН				
- ударная прочность сиденья	Высота падения груза 140 мм				
- ударная прочность спинки и подлокотника	Высота падения груза 120 – 330 мм, угол падения груза 28 – 48 град.				

					- прочность изделия при падении на пол	Высота падения изделия 75 – 600 мм, угол падения изделия 10 град.
					Стулья, кресла, табуреты складные:	
					- остаточная деформация между опорами (ножками) Кровати:	Не более 20 мм
					- деформация	Не более 30 мм
					- ударная прочность оснований	Высота падения груза 140 – 180 мм
					- усилие трансформации встроенных кроватей	Не более 10 даН
					Стулья детские:	
					- устойчивость	Не менее 20 град., не менее 3 даН
					- прочность при падении на пол стульев ростовых номеров 00, 0	Высота падения 150 – 450 мм
					- статическая прочность сиденья для ростовых номеров: 1, 2, 3	80 даН
					- расстояние между основанием ложа кровати и стенками ограждения	Не более 25 мм
					- диаметр ячеек сетчатого бокового ограждения кровати	Не более 7 мм
					- расстояние между смежными планками основания ложа	Не более 60 мм
					- размер (диаметр) ячеек основания ложа из металлической сетки	Не более 85 мм
					- расстояние (зазор) между матрацем и ограждением кровати (боковые стенки и спинки)	Не более 30 мм
					- устойчивость	Не менее 4,5 даН
					- деформируемость стоек ограждения под нагрузкой	Не более 10 мм
					- остаточная деформация стоек ограждения	Не более 2,0 мм

755.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-46	Операционные столы	32.50.50 32.50.30	9018 90 9402 90	- прочность стоек при испытании на изгиб по ГОСТ 28777	25 даН
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Инструкция по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
756.	ГОСТ Р 51265	Приборы, аппараты и оборудование бытовые реабилитационные	32.50.22 32.50.30	9021 90 9402 90	Сопротивление между клеммой выравнивания потенциалов и доступной частью	Не более 200 МОм
					Отсутствие поломок или остаточных деформаций	Соответствует/не соответствует
					Проникание воды или твердых частей	Не менее IPX4
					Классификация	-
					Устойчивость к климатическим факторам	Устойчивы/не устойчивы
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Отклонение в симметрии деталей арматуры	Не более 3 мм
					Масса, приходящая на ручку для переноса РБП	Не более 6 кг
					Крепление ручек, предназначенных для удержания или перенесения РБП	Нагрузка, втрое превышающая массу полностью загруженного (заполненного) РБП
					Усилие, необходимое для перемещения приводного элемента поворотных выключателей и переключателей РБП	Не более 5 Н
					Размер L приводного элемента	20 – 35 мм
					Диаметр приводного элемента	50 – 75 мм
					Свободный ход кнопочного пускового устройства	Не менее 4 мм
					Длина свободной части рычага управления	Не менее 150 мм
					Усилие перемещения рычагов управления	Не более 10 Н

					Диаметр рукояток рычагов управления	20 – 40 мм
					Усилия, необходимые для приведения в действие органов управления механических (с ручным приводом) РБП	Не более 20 Н
					Интервалы между рукоятками рычагов управления	Не менее 150 мм
					Высота букв, цифр или знаков, высвечивающихся на световом индикаторе	Не менее 13 мм
					Уровень звукового давления звукового сигнализатора	Не более 20 дБ при частоте 1500 Гц
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					Информация для пользователя РБП	Соответствует/не соответствует
757.	ГОСТ 30324.35	Одеяла, подушки и матрацы медицинские электрические	32.50.50 32.50.30 27.51.14	9018 90 9402 10	Маркировка на наружной стороне изделий	Соответствует/не соответствует
					Эксплуатационные документы	Соответствует/не соответствует
					Температуры контактных поверхностей рабочих частей изделия	Не более 41 °С
					Проникание жидкостей	IPX7
					Звуковые сигнализации	65 – 130 дБА
758.	ГОСТ 30324.2.38 п.6	Кровати медицинские электрические	32.50.50 32.50.30	9018 90 9402 10	Маркировка на наружной стороне изделий Сопротивление (импеданс) до места соединения с устройством для выравнивания потенциалов Открытые точки сжатия и раздвигания Шум при перемещении кровати	Соответствует/не соответствует Менее 0,2 Ом
					Длина шнура сетевого питания	Не менее 200 мм
759.	ГОСТ 25148 п. 2.28	Установки стоматологические стационарные.	32.50.11	9018 41 9018 49	Превышение температуры наружных частей установки	Не более 65 дБА на расстоянии 1 м Не менее 2,5 м Не более 60 °С

				9022 13	Устойчивость к воздействию климатических факторов	Устойчива/не устойчива
760.	СН 3057	Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений	-	-	Работоспособность после транспортной тряски	Работоспособна/не работоспособна
761.	ГОСТ Р ИСО 8374	Фотография	26.60.1	9022 19	Санитарные нормы распространяются на шум, создаваемые изделиями медицинской техники и воздействующие на персонал и пациентов	-
762.	ГОСТ Р ИСО 14644-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды	32.50.50	9018 90 9402 90	Условие неактивного освещения	Соответствует/не соответствует
763.	ГОСТ Р ИСО 14644-3	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды	32.50.50	9018 90 9402 90	Требования к периодическому контролю чистого помещения или чистой зоны с целью подтверждения их постоянного соответствия заданному классу чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1	-
764.	ГОСТ Р 52539	Чистота воздуха в лечебных учреждениях	32.50.50	9018 90 9402 90	Метрологические характеристики и методы испытаний чистых помещений и чистых зон для определения класса чистоты	-
765.	ГОСТ 28385	Комплексы медицинского назначения передвижные (подвижные) на автомобильных шасси	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8705 20 8703 23 8705 90 9018 90	Требования к чистоте воздуха в помещениях лечебных учреждений	Соответствует/не соответствует
766.	ГОСТ 30331.1	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Цвет наружных поверхностей кузовов	Не менее 147 мм 90 – 120 мм
767.	ГОСТ Р 50571.2	Электроустановки зданий	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок	-
					Характеристики электроустановок зданий, которые необходимы для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок	-

768.	ГОСТ Р 50571.3	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Требования к защите от поражения электрическим током людей и животных	-
769.	ГОСТ Р 50571.4.42	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Низковольтные электроустановки в части мер для защиты людей, домашнего скота и материалов от: - тепловых воздействий, сгорания или повреждения материалов и риска возникновения пожара, связанных с использованием электрооборудования, - распространения пожара, вызванного воздействием электрических установок, в другие притягивающие пожарные отсеки, - ухудшения безопасного функционирования электрооборудования, включая системы обеспечения безопасности	-
770.	ГОСТ Р 50571.4.43	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки и в случае короткого замыкания	-
771.	ГОСТ Р 50571.6	Электроустановки зданий	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Общие требования по выполнению защиты от понижения напряжения с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок зданий	-
772.	ГОСТ Р 50571.5.53	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Требования к функциям отделения, коммутации и управления низковольтных установок	-
773.	ГОСТ Р 50571.5.54	Электроустановки низковольтные. Заземляющие	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Требования к заземляющим устройствам, защитным	-

		устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов				проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках	
774.	ГОСТ Р 50571.7.701	Электроустановки низковольтные. Специальные установки или места расположения. Помещения для ванных и душевых комнат	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Требования к электрическим установкам в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам	-
775.	ГОСТ Р 50571.12	Электроустановки зданий. Помещения, содержащие нагреватели для саун	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Специальные требования к электроустановкам помещений, содержащих нагреватели для саун, с целью обеспечения защиты людей от поражения электрическим током и безопасной эксплуатации электроустановок	-
776.	ГОСТ Р 50571.7.706	Электроустановки низковольтные. Проводящие помещения со стесненными условиями	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Выбор и монтаж стационарного оборудования в проводящих помещениях со стесненными условиями	-
777.	ГОСТ Р 50571.5.52	Электроустановки низковольтные. Электропроводки	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Требования по выбору и монтажу электропроводок	-
778.	ГОСТ Р 50571.16	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	Не менее 0,25 МОм	Сопровождение изоляции электроустановки	
779.	ГОСТ Р 50571.17	Электроустановки зданий	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Требования по обеспечению мер защиты от пожара в электроустановках зданий и сооружений в зависимости от условий экстренной эвакуации людей в аварийных ситуациях, характеристик и свойств обрабатываемых или складываемых материалов, применяемых строительных конструкций и материалов	-
780.	ГОСТ Р 50571-4-44	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90	-	Требования по обеспечению безопасности низковольтных электроустановок при возникновении отклонений	-

							напряжения и электромагнитных помех	
781.	ГОСТ Р 50571.22	Электроустановки зданий	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Требования к специальным электроустановкам, содержащих оборудование обработки информации	-
782.	ГОСТ Р 50571.5.51	Электроустановки низковольтные	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Правила по выбору и монтажу электрооборудования в целях принятия мер защиты, требуемых для обеспечения безопасности, надлежащего функционационирования низковольтных электроустановок	-
783.	ГОСТ Р 50571.25	Электроустановки зданий. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Требования по обеспечению электробезопасности к электроустановкам зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями	-
784.	ГОСТ Р 50571.28	Электроустановки зданий. Электроустановки медицинских помещений	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Требования к устройству электроустановок в медицинских помещениях	-
785.	ГОСТ Р 50571.29	Электрические установки зданий. Прочее оборудование	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Требования по выбору и монтажу низковольтных генераторных агрегатов	-
786.	ГОСТ Р 50571.7.713	Электроустановки низковольтные. Специальные установки или местах расположения. Мебель	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Соединение между электрической сетью здания и электропроводкой мебели	Соответствует/не соответствует
							Электропроводка для соединения мебели с электрической сетью	Соответствует/не соответствует
							Площадь поперечного сечения проводников	Не менее 1,5 мм ²
							Максимальная температура корпуса светильника и другого оборудования	Не более 115°C
787.	ГОСТ Р 50571.7.717	Электроустановки низковольтные. Специальные установки или местах расположения. Мобильные или транспортируемые модули	32.50.50 27.11.4	9018 90 9402 90			Виды электропроводок	Соответствует/не соответствует
							Степень защиты входных отверстий устройств ввода соединителей	Не менее IP55

на 408 листах, лист 238

						Степень защиты вилок и розеток соединителей	Не менее IP44
788.	ГОСТ Р 50574	Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы	32.50.50 29.10.30 29.10.2 29.10.59	8705 20 8703 23 8705 90 9018 90	Информационные надписи и опознавательные знаки: - высота букв	Не менее 200 мм	
789.	ГОСТ ИЕС 61140	Установки и оборудование	32.50.50 28.94.22 26.51.66 27.11.4	8450 20 8451 10 8451 29 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9018 90 9402 90	Меры предосторожности для основной защиты Меры предосторожности для защиты при повреждении Усиленные защитные меры предосторожности Меры защиты	- - - -	
790.	ГОСТ 12.2.007.0	Изделия электротехнические	32.50.50 28.94.22 26.51.66 27.11.4	8450 20 8451 10 8451 29 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9018 90 9402 90	Классы электротехнических изделий Наличие защитных элементов	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует	
791.	ГОСТ 12.1.030	Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление	32.50.50 28.94.22 26.51.66 27.11.4	8450 20 8451 10 8451 29 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29	Сопротивление заземляющего устройства Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на "землю"	Не более 0,5 Ом Не более 10 кВ	

792.	ГОСТ Р 12.1.019	Электробезопасность	32.50.50 28.94.22 26.51.66 27.11.4	9022 30 9022 90 9018 90 9402 90	8450 20 8451 10 8451 29 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9018 90 9402 90	Мероприятия, технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность электроустановок и электрооборудования	-	
793.	ГОСТ ISO 6710	Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые.	17.21.1 26.60.11 21.20.24 32.50.13	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90	Объем добавленной воды Минимальное свободное пространство Плотность закупоривания контейнера пробкой Стойкость маркировки и этикетки Маркировка	±10 % номинальной вместимости До +25% номинальной вместимости Соответствует/не соответствует Стойкая/не стойкая		
794.	ГОСТ 10782	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.	23.13.11 26.60.11 21.20.24 32.50.13	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90	Типы и основные размеры Номинальная вместимость Полная вместимость Масса pH воды после обработки Качество поверхности Отклонение от параллельности Отклонение центра горловины от оси корпуса Стойкость к перепаду температур Устойчивость при транспортировании	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 57,5 – 2100 см ³ 68,4 – 2310 см ³ Не более 1020 г 0,7 – 1,4 Соответствует/не соответствует Не более 1,2 мм Не более 1,5 % Стойкие/не стойкие Устойчивы/не устойчивы		

795.	ГОСТ 31597	Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения.	17.21.1 26.60.11 21.20.24 32.50.13	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90	Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Упаковка	Соответствует/не соответствует
					- масса брутто	Не более 800 кг
					Типы и размеры	Соответствует/не соответствует
					Количество воздуха	Не более 5 см ³
					Время опорожнения	2 мин
					Заполнение ёмкости кровью	Не более 8 мин
					Размер соединительной трубки	Не менее 200 мм
					Внешний вид трубки	Соответствует/не соответствует
					Герметичность	Соответствует/не соответствует
796.	ГОСТ 19809	Стекло медицинское.	23.13.11 23.19.23 23.19.11	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90	Прочность головки донорской иглы с трубкой узла взятия крови после стерилизации	Не менее 20 Н в течение 15 с
					Размер штуцера	4,9 – 5,2 мм
					Прочность устройства для подвешивания	20 Н в течение 60 мин
					Прозрачность	Соответствует/не соответствует
					Теплостойкость	Выдержана/не выдержана
					Прочность маркировки и этикетки	Соответствует/не соответствует
					Потеря воды	Не более 2,5 %
					Водостойкость стекла:	Щелочной эквивалентна 1 г стекла:
					- класс 1/121	До 0,062 мг Na ₂ O
					- класс 2/121	0,062 – 0,527 мг Na ₂ O
797.	ГОСТ 19810	Стекло медицинское.	23.13.11 23.19.23 23.19.11	7017 10 7017 20 7017 90	- класс 3/121	0,527 – 0,930 мг Na ₂ O
					Щелочестойкость стекла:	
					- класс 1	До 75 мг/дм ²
					- класс 2	75 – 175 мг/дм ²
					- класс 3	Свыше 175 мг/дм ²
					Размеры колб:	
					- вместимость	49 – 1006 см ³
					- высота	145 – 335 мм
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость	Устойчива/не устойчива
798.	ГОСТ 12738	Колбы стеклянные с градуированной горловиной.	23.19.23 23.19.23	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90 7010 20	Размеры колб:	
					- вместимость	49 – 1006 см ³
					- высота	145 – 335 мм
					Внешний вид	Соответствует/не соответствует
					Устойчивость	Устойчива/не устойчива

						Некруглость Ширина отметок Расстояние между осями смежных отметок Маркировка	Не менее 1 мм Не более 0,4 мм Не менее 7 мм
						Соответствует/не соответствует	
						Упаковка: - масса брутто	Соответствует/не соответствует
799.	ГОСТ 19908	Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла.	23.19.23 23.19.23 23.13.11	7017 10 7017 20 7017 90 7010 90 7010 20		Размеры тиглей: - номинальная вместимость - диаметр D - диаметр d - высота H - толщина стенки S - радиус R - размер b - размер C Масса тиглей Размеры стаканов и колоб: - номинальная вместимость - диаметр D - диаметр D _i - высота H - высота h - толщина стенки S - диаметр d - диаметр d _i Масса стаканов и колоб Размеры воронок: - диаметр D - диаметр d - высота H - толщина стенки S Масса воронок Размеры пробирки: - номинальная вместимость - диаметр D - диаметр D _i - высота H - толщина стенки S Масса пробирки	10 – 200 см³ 29,2 – 109 мм 15 – 36 мм 20,2 – 69 мм 0,9 – 1,5 мм 27,0 – 163,4 мм 3 – 5 мм 6 – 10 мм (6,1 – 46,3) · 10⁻³ кг 50 – 1600 см³ 34 – 166 мм 25 – 80 мм 60 – 424 мм 25 – 204 мм 0,6 – 1,7 мм 18 – 127 мм 23 – 64 мм (19,4 – 314,8) · 10⁻³ кг 36 – 110 мм 5 – 11 мм 59 – 204 мм 1,0 – 2,0 мм (8,7 – 75,9) · 10⁻³ кг 6 – 370 см³ 7,3 – 42,7 мм 10 – 42 мм 110 – 310 мм 0,7 – 3,3 мм (6,8 – 199,9) · 10⁻³ кг

					Масса приборов для поглощения газов и паров воды Устойчивость к транспортной тряске Комплектность Маркировка Упаковка Масса ящика с упакованными изделиями Классификация Поверхность упаковки Герметичность Прочность при свободном падении Усилие сжатия в осевом направлении Прочность крепления ручек Стойкость к горячей воде Теплостойкость Морозостойкость Маркировка Упаковка Классификация укупорочных средств Маркировка Типы Основные размеры: - диаметр D - диаметр D1 - высота H - высота H1 - размер L	Не более 60 г Устойчива/не устойчива Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Не более 50 кг - Соответствует/не соответствует Выдержана/не выдержана Выдержано/не выдержано, высота падения не менее 1,0 м 49 – 1030 Н Соответствует/не соответствует Стойкая/не стойкая Стойкая/не стойкая Стойкая/не стойкая Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - Соответствует/не соответствует - 13,0 – 40,2 мм 8,0 – 40,0 мм 5,8 – 26,3 мм 9,5 – 15,0 мм 5,0 – 41,0 мм
801.	ГОСТ 33756	Упаковка потребительская полимерная.	17.21.1 17.21.13 22.22.13 22.22.14 22.22.19	3923 10 3923 29 4821 10 4821 90		
802.	ГОСТ 32179	Средства укупорочные.	22.22.13 22.22.14 22.22.19 23.13.11	8309 10 8309 90 3923 40 3923 50 3923 90 7010 20		
803.	ГОСТ Р 51314	Колпачки алюминиевые и комбинированные для укупорки лекарственных средств.	25.92.13	8309 10 8309 90		

804.	ГОСТ 32626	Средства укупорочные полимерные.	22.22.19	3923 40 3923 50 3923 90		- толщина стенки	0,18 – 0,27 мм
						- размер Р	0,8 – 1,2 мм
						- число перемычек	6 – 9
						Масса 1000 шт.	Не более 3,80 кг
						Качество поверхности	Соответствует/не соответствует
						Устойчивость к предстерилизационной очистке	Устойчиво/не устойчиво
						Устойчивость к стерилизации	Устойчиво/не устойчиво
						Требования герметичности	Соответствует/не соответствует
						Усилие разрыва перемычек и отгиба лепестков колпачка	20 – 70 Н
						Усилие до полного удаления колпачка с флакона или бутылки	3 – 60 Н
						Максимальное усилие вскрытия пластмассовой крышки	Не более 60 Н
						Устойчивость к условиям транспортирования	Устойчивы/не устойчивы
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Классификация	-
805.	ГОСТ ISO 8106	Упаковка стеклянная	23.19.23 23.19.23 23.13.11	7010 90 7010 20		Внешний вид	Соответствует/не соответствует
						Герметичность	Соответствует/не соответствует
						Сопротивление внутреннему избыточному давлению	До 9 кгс/см ² и/или условия пастеризации (60±5)°С, 1-2 ч
						Коробление	0,5 – 1,0 %
						Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	Соответствует/не соответствует
806.	ГОСТ ISO 9008	Бутылки стеклянные.	23.13.11	3923 30		Маркировка	Соответствует/не соответствует
						Упаковка	Соответствует/не соответствует
						Расчет фактической вместимости	1,00102 - 1,00378 VCF, мл/г
						Отклонение от вертикальности	-

				7017 10 7017 20 7017 90 7010 90					
807.	ГОСТ 30288	Тара стеклянная	23.13.11	3923 30 7017 10 7010 20 7010 90			Классификационные группировки	-	
							Показатели, определяющие требования безопасности	Соответствует/не соответствует	
							Маркировка	Соответствует/не соответствует	
							Условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует	
808.	ГОСТ 34036	Упаковка стеклянная из стекломассы для лекарственных средств	23.13.11	3923 30 7017 10 7017 20 7017 90 7010 20 7010 90			Классификация, основные параметры и размеры	Соответствует/не соответствует	
							Технические требования:		
							- характеристики	Соответствует/не соответствует	
							- маркировка	Соответствует/не соответствует	
							- упаковка	Соответствует/не соответствует	
							- транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует	
							- условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует	
809.	ГОСТ 33781	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов	17.21.1 17.21.13	4819 10			Классификация	-	
							Технические требования:		
							- линии сгиба	Отклонение от перпендикулярности линий не должно превышать 1,0 мм на каждые 100 мм длины	
							- загиб отделочного материала	Не более 25 мм	
							- безопасность	-	
							- транспортирование и хранение	-	
							Классификация	-	
							Размеры щитков:		
							- размер Н	180 – 230 мм	
							- размер В	180 – 200 мм	
							- размер А	80 – 120 мм	
							Масса	Не более 0,700 кг	
							Возможность регулировки длины ленты	300 – 700 мм	
							Ширина ленты	Не менее 18 мм	
							Качество поверхности	Соответствует/не соответствует	
810.	ГОСТ 12.4.023	Щитки защитные лицевые.	32.99.11	6506 10			Светофильтры	Наличие/отсутствие	

811.	ГОСТ Р 12.4.254	Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах.	32.50.42 32.50.43	9004 90		Устойчивость к механическим повреждениям	Устойчивы/не устойчивы
						Устойчивость к климатическим условиям	Устойчивы/не устойчивы
						Размеры смотрового окна	Не менее 40х90 мм
						Размеры светофильтров	36 – 131 мм
						Расстояние между корпусом и лобной частью наголовного крепления	Не менее 30 мм
812.	ГОСТ Р 12.4.188	Очки защитные фильтрующие от воздействия парогазовой фазы токсичных веществ	32.50.42	9004 90		Классификация	Соответствует/не соответствует
						Внешний вид	Соответствует/не соответствует
						Ширина наголовной ленты	Не менее 10 мм
						Высота ручных щитков	Не менее 350 мм
						Ширина ручных щитков	Не менее 210 мм
						Глубина от центра светофильтра	Не менее 75 мм
						Устойчивости сварочных щитков при падении	Устойчивы/не устойчивы
						Светонепроницаемость	Соответствует/не соответствует
						Электрическая изоляция	Не более 1,2 мА
						Маркировка	Соответствует/не соответствует
813.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119	Информационная технология. Пакеты программ	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80		Коэффициент защиты очков	Не менее 10
						Время защитного действия очков	Не менее четырех часов
						Моноккулярное поле зрения очков	35 - вверх; 45 - вниз; 40 - к носу; 45, 75 - к виску
						Масса очков	Не более 180 г
						Описание продукта	Соответствует/не соответствует
						Документация пользователя	Соответствует/не соответствует
						Программы и данные:	Соответствует/не соответствует
						- функциональные возможности	Соответствует/не соответствует
						- надежность	Соответствует/не соответствует
						- практичность	Соответствует/не соответствует

						- эффективность - сопровождаемость - мобильность (переносимость)	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
814.	ГОСТ Р ИСО 9127	Системы обработки информации.	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Документация пользователя: - назначение - справочная документация - учебная документация - быстрая справочная документация Информация на упаковке Содержание	Документация пользователя: - назначение - справочная документация - учебная документация - быстрая справочная документация Информация на упаковке Содержание	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
815.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126	Информационная технология. Программная продукция	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Характеристики качества программного обеспечения Представление пользователя	Характеристики качества программного обеспечения Представление пользователя	Соответствует/не соответствует Документация изготовителя
816.	ГОСТ 28195	Программные средства	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Номенклатура показателей качества программных средств	Номенклатура показателей качества программных средств	-
817.	ГОСТ Р 51188	Программные средства	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Проверка программного средства на наличие компьютерных вирусов	Проверка программного средства на наличие компьютерных вирусов	Пройдена/не пройдена
818.	ГОСТ Р 55544	Программное обеспечение медицинских изделий.	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42	8471 80	Руководство по применению требований, содержащихся в ИСО 14971	Руководство по применению требований, содержащихся в ИСО 14971	-

819.	ГОСТ Р 56849	Программное обеспечение медицинских изделий	32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Жизненный цикл медицинского программного обеспечения Менеджмент рисков	-	
820.	ГОСТ Р 56850	Информатизация здоровья. Информационно-вычислительные сети с медицинскими приборами.	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51 8523 51 8523 59 8523 59 8523 80	Возможности защиты	-	
821.	ГОСТ Р ИСО 12052	Информатизация здоровья. Цифровые изображения и связь в медицине (DICOM), включая управление документооборотом и данными	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 58.29.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51 8523 51 8523 59 8523 59 8523 80 8523 80	Определения информационных объектов	-	
822.	ГОСТ Р ИСО/ТС 25238	Медицинское программное обеспечение	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51	Классы риска	-	

			32.50.21 58.29.29	8523 51 8523 59 8523 59 8523 59 8523 80 8523 80			
823.	ГОСТ Р ИСО/ТО 27809	Медицинское программное обеспечение	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 58.29.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51 8523 51 8523 59 8523 59 8523 59 8523 80 8523 80	Возможные мероприятия по контролю за программными продуктами для сферы здравоохранения	-	
824.	ГОСТ Р МЭК 80001-1	Информатизация здоровья. Информационно-вычислительные сети с медицинскими приборами	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 58.29.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51 8523 51 8523 59 8523 59 8523 59 8523 80 8523 80	Роли и ответственности Менеджмент рисков в жизненном цикле медицинских ИТ-сетей Управление документацией	Экспертиза файла менеджмента рисков медицинской ИТ-сети	
825.	ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 58.29.29	8471 80 8523 29 8523 29 8523 29 8523 49 8523 49 8523 51 8523 51 8523 59 8523 59 8523 59 8523 80 8523 80	Общие требования к менеджменту риска Анализ риска Оценивание риска Управление риском Отчет по менеджменту риска	Соответствует/не соответствует	

				8523 80 8523 80				
826.	ГОСТ 19.402	Программы		26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Требования к содержанию программного документа "Описание программы"	-	
827.	ГОСТ Р МЭК 62304	Изделия медицинские. Программное обеспечение.		26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Классификация программного обеспечения в отношении безопасности План разработки программного обеспечения Документирование требований к программному обеспечению Меры управления риском Проверка требований к программному обеспечению Стратегии, методы и процедуры для верификации программного модуля	Соответствует/не соответствует	
						Критерии приемки программных модулей	-	
						План технической поддержки программного обеспечения	-	
						Меры по управлению риском	-	
						Процесс менеджмента конфигурации программного обеспечения	-	
						Программный процесс решения проблем	-	
828.	ГОСТ 19.301	Программа		26.60 26.60.11 26.60.12 26.60.13 32.50.42 32.50.43 32.50.21 62.01.29	8471 80	Требования к содержанию и оформлению программного документа "Программа и методика испытаний"	-	
829.	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294	Программное обеспечение		26.60	8471 80	Идентификация:	-	

		для измерения мощности радиопомех				мощности промышленных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 30 МГц до 1 ГГц	
833.	ГОСТ CISPR 16-1-4	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Характеристики и качество функционирования устройств для измерения излучаемых промышленных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц, а также технические требования к антеннам и испытательным площадкам	Соответствует/не соответствует
834.	ГОСТ CISPR 16-2-1	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Классификация различных типов помех и детекторы, применяемые при их измерении	Соответствует/не соответствует
835.	ГОСТ 30805.16.2.1	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Основные положения по измерению промышленных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц и методы измерений кондуктивных ИРП в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц	Соответствует/не соответствует
836.	ГОСТ 30805.16.2.2	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Методы измерения мощности промышленных радиопомех (ИРП) с помощью поглощающих клещей в полосе частот от 30 до 1000 МГц	Соответствует/не соответствует
837.	ГОСТ CISPR 16-2-3	Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Методы измерения излучаемых электромагнитных явлений, относящихся к помехам, в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц	Соответствует/не соответствует
838.	ГОСТ 30805.16.2.3	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Методы измерений параметров излучаемых промышленных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц	Соответствует/не соответствует
839.	ГОСТ CISPR 16-4-2	Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	-	-	-	Расширенная неопределенность	Не менее 3,6 дБ
840.	ГОСТ 30805.16.4.2	Совместимость технических средств электромагнитная	-	-	-	Расширенная неопределенность	Не менее 3,6 дБ
841.	ГОСТ IEC/TR 61000-1-6	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	-	-	-	Информация для оценки неопределенности измерений	Соответствует/не соответствует

842.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00	Маркировка на наружных поверхностях изделия Эксплуатационные документы Устойчивость к электростатическому разряду: - контактный разряд - воздушный разряд Устойчивость к наносекундным импульсным помехам - амплитуда Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: - амплитуда импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - амплитуда импульсов Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: - амплитуда Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: - испытательные напряжения, % U_n - амплитуда провалов и прерываний напряжения, % U_n - длительность провалов и прерываний напряжения, периоды Устойчивость к электромагнитному полю: - напряженность Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Маркировка на наружных поверхностях изделия	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 2 – 8 кВ 2 – 8 кВ 0,25 – 4 кВ 0,25 – 4 кВ 0,25 – 4 кВ 0,15 – 80 МГц 0,1 – 20 В 0 – 70% ($\pm 5\%$) 3 – 100 %, 1 – 240 В 0,5 – 50 с 80 – 2500 МГц 0,1 – 30 А/м 50 Гц, 1 – 16 А/м Соответствует/не соответствует
			26.60.11 26.60.12 26.60.13	9022 14 9022 12 9022 19		
843.	ГОСТ 30324.1.2	Изделия медицинские электрические	26.60.11 26.60.12 26.60.13	9022 14 9022 12 9022 19	Маркировка на наружных поверхностях изделия	Соответствует/не соответствует

				на 408 листах, лист 254		
844.	ГОСТ Р МЭК 61326-1	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения	26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00	Эксплуатационные документы Устойчивость к электростатическому разряду: - контактный разряд - воздушный разряд Устойчивость к наносекундным импульсным помехам - амплитуда Устойчивость к микросекундным импульсным помехам: - амплитуда импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - амплитуда импульсов Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: - амплитуда Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: - испытательные напряжения, % U _н - амплитуда провалов и прерываний напряжения, % U _н - длительность провалов и прерываний напряжения, периоды Устойчивость к электромагнитному полю: - напряженность Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты Идентификация, маркировка и документация Устойчивость к электростатическому разряду:	Соответствует/не соответствует 2 – 8 кВ 2 – 8 кВ 0,25 – 4 кВ 0,25 – 4 кВ 0,25 – 4 кВ 0,15 – 80 МГц 0,1 – 20 В 0 – 70% (±5%) 3 – 100 %, 1 – 240 В 0,5 – 50 с 80 – 2500 МГц 0,1 – 30 А/м 50 Гц, 1 – 16 А/м Соответствует/не соответствует
			26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания: - испытательные напряжения, % U_n 0 – 70% ($\pm 5\%$)			
					- амплитуда провалов и прерываний напряжения, % U_n 0 – 100 %, 1 – 240 В			
					- длительность провалов и прерываний напряжения, периоды 0,5 – 50 с			
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам - амплитуда 0,25 – 1 кВ			
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - амплитуда импульсов 0,25 – 2 кВ			
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным электромагнитными полями: - амплитуда 0,1 – 3 В			
					Инструкции по эксплуатации -			
					Условия проведения испытаний -			
					Эксплуатационные документы -			

					8540 9018 9027		
847.	ГОСТ ИЕС 61000-6-3	Жилые, коммерческие и легкие промышленные обстановки	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00	Условия проведения испытаний Эксплуатационные документы	- -	

на 400 листах, лист 239									
						8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
848.	ГОСТ 30804.6.4	Технические средства, применяемые в промышленных зонах				26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22		Условия проведения испытаний	-
								Эксплуатационные документы	-

				27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419		
--	--	--	--	---	--	--	--

				28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
850.	ГОСТ Р 51318.11	Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства.	26.60.11	9022 14	Классификация	-		
			26.60.12	9022 12	Напряженность электромагнитного поля	150 кГц – 18 ГГц		
			26.60.13	9022 19	Напряжение электромагнитных помех	0 – 145 дБ (мкВ/м)		
			26.60.14	9022 13	Ток электромагнитных помех	150 кГц – 30 МГц		
			32.50.21	9022 30		0 – 100 дБ (мкВ)		
			32.50.22	9022 90		150 кГц – 30 МГц		
			32.50.3	9027 10		0 – 100 дБ (мкА)		
			32.50.50	9027 20				
			27.51	9027 30				
			27.90.11	9018 20				
			28.49.12	9018 41				

					8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027					
851.	СТБ ЕН 55011	Промышленные, научные и медицинские (ПНМ) высокочастотные устройства.	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12		9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21	Классификация	Соответствует/не соответствует			
								Напряженность электромагнитного поля		
								Напряжение электромагнитных помех		
								Ток электромагнитных помех		

			28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
852.	ГОСТ 30805.22	Оборудование информационных технологий.	26.60.11	9022 14	Классификация	Соответствует/не соответствует	
			26.60.12	9022 12			
			26.60.13	9022 19			
			26.60.14	9022 13			
			32.50.21	9022 30	Напряжение электромагнитных помех	150 кГц – 30 МГц	
			32.50.22	9022 90		0 97 дБ (мкВ)	

150 кГц – 30 МГц
0 – 53 дБ (мкА)

Ток электромагнитных помех

32.50.3	9027 10
32.50.50	9027 20
27.51	9027 30
27.90.11	9018 20
28.49.12	9018 41
27.51.11	9018 90
27.51.21	9018 20
28.94.22	9019 00
32.50.21	9019 10
27.51.22	9019 20
27.51.30	8419 20
27.11.41	8419 40
26.30.40	8419 00
27.90.40	9020 00
28.24.11	9021 00
22.29.24	9018 00
26.20.11	9018 31
28.23.12	9018 32
26.30	9018 49
26.40.20	9021 10
26.20	9021 39
28.11.13	9021 40
28.13	9022 00
28.21.12	9022 21
28.25.13	9022 29
28.25.30	9402 10
28.29.42	9402 90
25.73.50	9402 00
28.12	9019 00
28.21.13	8516 00
27.90.31	8543 00
26.11.11	8479 00
26.60	8418 00
26.51.53	8509 00
	8450 00
	9019 00
	8510 00
	8509 00
	8504 00
	8529 00
	8505 00
	8467 00
	9405 00

				8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				на ч.ч. 6 и 7, лист 207
853.	ГОСТ CISPR 32	Оборудование мультимедиа.		26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30	Классификация	Соответствует/не соответствует		
					Документация к оборудованию	Соответствует/не соответствует		
					Излучаемая электромагнитная эмиссия	30 МГц – 6 ГГц 0 – 80 дБ (мкВ/м)		
					Кондуктивная электромагнитная эмиссия	150 кГц – 30 МГц 0 – 97 дБ (мкВ)		
					Ток электромагнитной эмиссии	150 кГц – 30 МГц 0 – 53 дБ (мкА)		

				8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
855.	ГОСТ CISPR 14-1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00	Напряжение электромагнитных помех	150 кГц – 30 МГц 0 – 80 дБ (мкВ)		
					Мощность электромагнитных помех	30 – 1000 МГц 0 – 65 дБ (пВт)		

27.90.40	9020 00
28.24.11	9021 00
22.29.24	9018 00
26.20.11	9018 31
28.23.12	9018 32
26.30	9018 49
26.40.20	9021 10
26.20	9021 39
28.11.13	9021 40
28.13	9022 00
28.21.12	9022 21
28.25.13	9022 29
28.25.30	9402 10
28.29.42	9402 90
25.73.50	9402 00
28.12	9019 00
28.21.13	8516 00
27.90.31	8543 00
26.11.11	8479 00
26.60	8418 00
26.51.53	8509 00
	8450 00
	9019 00
	8510 00
	8509 00
	8504 00
	8529 00
	8505 00
	8467 00
	9405 00
	8471 00
	8470 00
	8525 00
	8528 00
	8471 00
	8413
	8414
	8417
	8418
	8419
	8420
	8480
	8481

856.	ГОСТ CISPR 15	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование			8514 8515 8540 9018 9027		Напряжение помех Ток электромагнитной эмиссии	9 кГц – 300 МГц 0 – 110 дБ (мкВ) 9 кГц – 300 МГц 0 – 88 дБ (мкА)	
			26.60.11	9022 14					
			26.60.12	9022 12					
			26.60.13	9022 19					
			26.60.14	9022 13					
			32.50.21	9022 30					
			32.50.22	9022 90					
			32.50.3	9027 10					
			32.50.50	9027 20					
			27.51	9027 30					
			27.90.11	9018 20					
			28.49.12	9018 41					
			27.51.11	9018 90					
			27.51.21	9018 20					
			28.94.22	9019 00					
			32.50.21	9019 10					
			27.51.22	9019 20					
			27.51.30	8419 20					
			27.11.41	8419 40					
			26.30.40	8419 00					
			27.90.40	9020 00					
			28.24.11	9021 00					
			22.29.24	9018 00					
			26.20.11	9018 31					
			28.23.12	9018 32					
			26.30	9018 49					
			26.40.20	9021 10					
			26.20	9021 39					
			28.11.13	9021 40					
			28.13	9022 00					
			28.21.12	9022 21					
			28.25.13	9022 29					
			28.25.30	9402 10					
			28.29.42	9402 90					
			25.73.50	9402 00					
			28.12	9019 00					
			28.21.13	8516 00					
			27.90.31	8543 00					
			26.11.11	8479 00					

			26.60 26.51.53	8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
857.	ГОСТ 30804.3.2	Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00	Классификация Гармонические составляющие токов	Соответствует/не соответствует 1 мкА – 16 А Количество гармоник: 40	

				8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
858.	ГОСТ 30804.3.3	Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера: - установившееся относительное изменение напряжения - характеристика относительного изменения напряжения для интервала времени изменения напряжения, большего 500мс - максимальное относительное изменение напряжения - кратковременная доза фликера - длительная доза фликера	Не более 3,3% Не более 3,3% Не более 7% Не более 1,0 Не более 0,65		

				28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
859.	ГОСТ IEC 61000-3-3	Общественные низковольтные системы электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера: - установившееся относительное изменение напряжения - характеристика относительного изменения напряжения для интервала	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20	Не более 3,3% Не более 3,3%		

			27.51	9027 30	времени изменения напряжения, большего 500 мс	
			27.90.11	9018 20	- максимальное относительное изменение напряжения	Не более 7%
			28.49.12	9018 41		
			27.51.11	9018 90		
			27.51.21	9018 20	- кратковременная доза фликера	Не более 1,0
			28.94.22	9019 00		
			32.50.21	9019 10		
			27.51.22	9019 20		
			27.51.30	8419 20		
			27.11.41	8419 40		
			26.30.40	8419 00		
			27.90.40	9020 00,		
			28.24.11	9021 00		
			22.29.24	9018 00		
			26.20.11	9018 31		
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		
			28.25.30	9402 10		
			28.29.42	9402 90		
			25.73.50	9402 00		
			28.12	9019 00		
			28.21.13	8516 00		
			27.90.31	8543 00		
			26.11.11	8479 00		
			26.60	8418 00		
			26.51.53	8509 00		
				8450 00		
				9019 00		
				8510 00		
				8509 00		
				8504 00		
				8529 00		
				8505 00		
				8467 00		
				9405 00		
				8471 00		
				8470 00		

					8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
860.	ГОСТ 30804.6.1	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39	Требования к устойчивости к электромагнитным помехам технических средств с малым энергопотреблением	-		
						Эксплуатационные документы	-	

				26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
861.	ГОСТ 30804.6.2	Технические средства, применяемые в промышленных зонах.	26.60.11 26.60.11 26.60.11	9022 14 9022 12 9022 19	Требования к устойчивости к электромагнитным помехам технических средств для	-		

[illegible]

				8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
862.	ГОСТ CISPR 24	Оборудование информационных технологий.	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00	Документация на продукцию Требования к испытаниям на устойчивость Условия проведения испытаний Критерии качества функциональности	- - - -	

863.	ГОСТ 30804.4.2	Устойчивость к электростатическим разрядам.	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 9027 9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00	Устойчивость к электростатическим разрядам: - диапазон воздействующих факторов (напряжение на накопительном конденсаторе испытательного генератора)	Соответствует/не соответствует
------	----------------	---	---	---	--	--------------------------------

					9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
864.	ГОСТ 30804.4.3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20	Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует			

				27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420		
--	--	--	--	---	---	--	--

				8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
865.	ГОСТ ИЕС 61000-4-3	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00	Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - диапазон воздействующих факторов		Соответствует/не соответствует

			27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
866.	ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-11:2006) ГОСТ Р 52459.7-2009 (EN 301 489-7:2005) ГОСТ Р 52459.3-2009 (EN 301 489-3:2002) ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17-2008)	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует	

27.51.21	9018 20
28.94.22	9019 00
32.50.21	9019 10
27.51.22	9019 20
27.51.30	8419 20
27.11.41	8419 40
26.30.40	8419 00
27.90.40	9020 00
28.24.11	9021 00
22.29.24	9018 00
26.20.11	9018 31
28.23.12	9018 32
26.30	9018 49
26.40.20	9021 10
26.20	9021 39
28.11.13	9021 40
28.13	9022 00
28.21.12	9022 21
28.25.13	9022 29
28.25.30	9402 10
28.29.42	9402 90
25.73.50	9402 00
28.12	9019 00
28.21.13	8516 00
27.90.31	8543 00
26.11.11	8479 00
26.60	8418 00
26.51.53	8509 00
	8450 00
	9019 00
	8510 00
	8509 00
	8504 00
	8529 00
	8505 00
	8467 00
	9405 00
	8471 00
	8470 00
	8525 00
	8528 00
	8471 00
	8413

				8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027		
867.	ГОСТ ИЕС 61000-4-4	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует

			28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
868.	ГОСТ Р 51317.4.5	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует	

					8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
869:	ГОСТ IEC 61000-4-5	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует			

				26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
870.	ГОСТ Р 51317.4.6	Технические средства	26.60.11 26.60.12	9022 14 9022 12	Устойчивость к напряжениям радиочастотных помех,	Соответствует/не соответствует		

					наведенным в кабельных связях и линиях электропитания: - диапазон воздействующих факторов	
26.60.13	9022 19					
26.60.14	9022 13					
32.50.21	9022 30					
32.50.22	9022 90					
32.50.3	9027 10					
32.50.50	9027 20					
27.51	9027 30					
27.90.11	9018 20					
28.49.12	9018 41					
27.51.11	9018 90					
27.51.21	9018 20					
28.94.22	9019 00					
32.50.21	9019 10					
27.51.22	9019 20					
27.51.30	8419 20					
27.11.41	8419 40					
26.30.40	8419 00					
27.90.40	9020 00					
28.24.11	9021 00					
22.29.24	9018 00					
26.20.11	9018 31					
28.23.12	9018 32					
26.30	9018 49					
26.40.20	9021 10					
26.20	9021 39					
28.11.13	9021 40					
28.13	9022 00					
28.21.12	9022 21					
28.25.13	9022 29					
28.25.30	9402 10					
28.29.42	9402 90					
25.73.50	9402 00					
28.12	9019 00					
28.21.13	8516 00					
27.90.31	8543 00					
26.11.11	8479 00					
26.60	8418 00					
26.51.53	8509 00					
	8450 00					
	9019 00					
	8510 00					
	8509 00					
	8504 00					

				8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
871.	СТБ ІЕС 61000-4-6	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00	Устойчивость к напряжениям радиочастотных помех, наведенным в кабельных связях и линиях электропитания: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует		

				22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515		
--	--	--	--	---	---	--	--

					8540 9018 9027				на ч. 100 листов, лист 227
872.	ГОСТ 30804.4.11	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00	Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания: - диапазон воздействующих факторов (номинальное напряжение электропитания переменного тока до 220 В)	Соответствует/не соответствует			

				8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			873.	ГОСТ Р 50648	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20	Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты: - диапазон воздействующих факторов	Соответствует/не соответствует
--	--	--	--	--	--	--	------	--------------	----------------------	--	--	--	--------------------------------

				8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				
874.	ГОСТ ИЕС 61000-4-8	Технические средства	26.60.11 26.60.12 26.60.13 26.60.14 32.50.21 32.50.22 32.50.3 32.50.50 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 32.50.21 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12	9022 14 9022 12 9022 19 9022 13 9022 30 9022 90 9027 10 9027 20 9027 30 9018 20 9018 41 9018 90 9018 20 9019 00 9019 10 9019 20 8419 20 8419 40 8419 00 9020 00 9021 00 9018 00 9018 31 9018 32 9018 49 9021 10 9021 39 9021 40 9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00	Устойчивость к медленной затухающей колебательной волне: - диапазон воздействующих факторов Устойчивость к быстрой затухающей колебательной волне: - диапазон воздействующих факторов		Соответствует/не соответствует	

				28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027				Соответствует/не соответствует
875.	ГОСТ Р 52459.31	Радиооборудование для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства, работающие в полосе частот от 9 до 315 кГц	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Условия испытаний Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС				

876.	ГОСТ Р 52459.27	Активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства	32.50.22 26.60.14	9021 40 9021 50 9021 90	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС	Соответствует/не соответствует
877.	ГОСТ 30880	Слуховые аппараты.	32.50.22 26.60.14	9021 40	Уровень акустической помехи Напряженность испытательного поля электромагнитного поля	Соответствует/не соответствует
878.	ГОСТ 32132.3	Низковольтные источники питания постоянного тока	26.60.11	9022 14	Применимость требований ЭМС к различным источникам питания Требования устойчивости к электромагнитным помехам	Соответствует/не соответствует
			26.60.12	9022 12		
			26.60.13	9022 19		
			26.60.14	9022 13		
			32.50.21	9022 30		
			32.50.22	9022 90		
			32.50.3	9027 10		
			32.50.50	9027 20		
			27.51	9027 30		
			27.90.11	9018 20		
			28.49.12	9018 41		
			27.51.11	9018 90		
			27.51.21	9018 20		
			28.94.22	9019 00		
			32.50.21	9019 10		
			27.51.22	9019 20		
			27.51.30	8419 20		
			27.11.41	8419 40		
			26.30.40	8419 00		
			27.90.40	9020 00		
			28.24.11	9021 00		
			22.29.24	9018 00		
			26.20.11	9018 31		
			28.23.12	9018 32		
			26.30	9018 49		
			26.40.20	9021 10		
			26.20	9021 39		
			28.11.13	9021 40		
			28.13	9022 00		
			28.21.12	9022 21		
			28.25.13	9022 29		

Высокочастотное электромагнитное поле	9027 20	32.50.50		
	9027 30	27.51		
	9018 20	27.90.11		
	9018 41	28.49.12		
	9018 90	27.51.11		
Наносекундные импульсные помехи	9018 20	27.51.21		
	9019 00	28.94.22		
Микросекундные импульсные помехи	9019 10	32.50.21		
	9019 20	27.51.22		
Кондуктивные помехи	8419 20	27.51.30		
	8419 40	27.11.41		
	8419 00	26.30.40		
	9020 00	27.90.40		
	9021 00	28.24.11		
	9018 00	22.29.24		
	9018 31	26.20.11		
	9018 32	28.23.12		
	9018 49	26.30		
	9021 10	26.40.20		
	9021 39	26.20		
	9021 40	28.11.13		
	9022 00	28.13		
	9022 21	28.21.12		
	9022 29	28.25.13		
	9402 10	28.25.30		
	9402 90	28.29.42		
	9402 00	25.73.50		
	9019 00	28.12		
	8516 00	28.21.13		
	8543 00	27.90.31		
	8479 00	26.11.11		
	8418 00	26.60		
	8509 00	26.51.53		
	8450 00			
	9019 00			
	8510 00			
	8509 00			
	8504 00			
	8529 00			
	8505 00			
	8467 00			
	9405 00			
	8471 00			

на 400 листов, лист 503

				8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027					Соответствует/не соответствует
880.	ГОСТ 30805.14.2	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналоговые устройства.		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42		Классификация ТС	Соответствует/не соответствует		
						Устойчивость к электростатическим разрядам:			
						- амплитуда импульсов напряжения			
						Устойчивость к наносекундным импульсным помехам:			
						- амплитуда импульсов напряжения			
						- длительность фронта импульса/длительность импульса			
						- частота повторения импульсов в пачке			
						Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями:			
						- полоса частот			
						- выходное сопротивление источника			
						- среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал			
						8416			
						8417			
						8418			
						8419			
						8420			

				28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11 26.60 26.51.53	9022 00 9022 21 9022 29 9402 10 9402 90 9402 00 9019 00 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 9019 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540 9018 9027			
882.	ГОСТ 30805.13	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00	Напряжение ИРП на сетевых зажимах Напряжение ИРП на антенных входах	Соответствует/не соответствует		

				27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Напряжение полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе с встроенным или подключаемым ВЧ-видеомодулятором Мощность в сетевом шнуре ИТС и других подключаемых проводах Напряженность электромагнитного поля излучаемых ИРП Мощность излучаемых ИРП		
883.	ГОСТ Р 51318.20	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00	Критерии качества функционирования Помехоустойчивость по входу - частота полезного сигнала - частота испытательного воздействия - уровень испытательного воздействия Устойчивость к наведенным радиочастотным токам Эффективность экранирования Устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям Устойчивость к ВЧ-напряжениям на входных и выходных звуковых зажимах	Соответствует/не соответствует		

на 700 листов, лист 502

				28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
884.	ГОСТ 32134.1	Технические средства радиосвязи.		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость Применимость требований ЭМС Измерения напряженности поля ИРП, излучаемых корпусом вспомогательного оборудования Измерение напряжения ИРП на портах электропитания Измерение общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на портах связи Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Устойчивость к электростатическим разрядам Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания	Соответствует/не соответствует

				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии			Соответствует/не соответствует
885.	ГОСТ Р 50009	Технические средства охранной сигнализации.	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Соответствует	
				8543 00	Микросекундные импульсные помехи большой энергии		
				8479 00	Наносекундные импульсные помехи		
				8418 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8509 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8450 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8510 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8509 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8504 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8529 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8505 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8467 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				9405 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8471 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8470 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8525 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8528 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8471 00	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8413	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8414	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8417	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8418	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8419	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8420	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8480	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8481	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
				8514	Кратковременные прерывания напряжения электропитания		
8515	Кратковременные прерывания напряжения электропитания						
8540	Кратковременные прерывания напряжения электропитания						
886.	ГОСТ EN 55103-2	Группа однородной продукции для профессиональной аудио-, видео-, аудио аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий.	8516 00	Электростатические разряды	Соответствует/не соответствует		
			8543 00	Радиочастотное электромагнитное поле			
			8479 00	Электростатический разряд			
			8418 00	Однородное и неоднородное магнитное поле			
			8509 00	Однородное и неоднородное магнитное поле			
			8450 00	Быстрые переходные процессы			
			8510 00	Помехи звуковой частоты			
			8509 00	Радиочастотные помехи			

на 400 листах, лист 511

						Выбросы напряжения Провалы напряжения		

888.	СТБ EN 300 440-1	Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD). Радиооборудование в полосе частот от 1 до 40 ГГц.	28.25.30	8419	Безопасность	Соответствует/не соответствует
			28.29.42	8420		
889.	ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2	Технические средства радиосвязи	25.73.50	8480	Оценка качества функционирования Критерии качества функционирования	Соответствует/не соответствует
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
889.	ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2	Технические средства радиосвязи	27.51	8516 00	Оценка качества функционирования Критерии качества функционирования	Соответствует/не соответствует
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
889.	ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2	Технические средства радиосвязи	28.94.22	8450 00	Оценка качества функционирования Критерии качества функционирования	Соответствует/не соответствует
			27.51.22	8510 00		
			27.51	8516 00		
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		

			27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540			
890.	ГОСТ Р 52459.2	Технические средства радиосвязи. Оборудование пейджинговых систем связи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	

на 408 листах, лист 214

			28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540			
891.	ГОСТ Р 52459.3	Устройства малого радиуса действия, работающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	
892.	ГОСТ Р 52459.4	Технические средства радиосвязи. Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательное оборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования	Соответствует/не соответствует	

на 400 листов, лист 210

				28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540			
894.	ГОСТ Р 52459.6	Технические средства радиосвязи. Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	
895.	ГОСТ Р 52459.7	Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательному оборудованию		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях	Соответствует/не соответствует	

		систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)	27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	
896.	ГОСТ Р 52459.8	Базовые станции системы цифровой сотовой связи GSM	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

на 400 листов, лист 210

			28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
897.	ГОСТ Р 52459.9	Беспроводные микрофоны, аналоговое радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
898.	ГОСТ Р 52459.10		27.51 27.90.11	8516 00 8543 00	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует

		Оборудование беспроводных телефонов первого и второго поколений	28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость		
899.	ГОСТ 32134.11	Радиовещательные передатчики	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	

			26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
900.	ГОСТ 32134.12	Земные станции с малой апертурой фиксированной спутниковой службы, работающие в полосах частот от 4 до 30 ГГц	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционального оборудования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

901.	ГОСТ 32134.13	Средства радиосвязи личного пользования, работающие в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательное оборудование	27.51	8516 00	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует
			27.90.11	8543 00		
902.	ГОСТ 32134.14	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики	28.49.12	8479 00	Ограничения полос частот при испытаниях	Соответствует/не соответствует
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
			27.90.40	8505 00		
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			28.23.12	8470 00		
			26.30	8525 00		
			26.40.20	8528 00		
			26.20	8471 00		
			28.11.13	8413		
			28.13	8414		
			28.21.12	8417		
			28.25.13	8418		
			28.25.30	8419		
			28.29.42	8420		
			25.73.50	8480		
			28.12	8481		
			28.21.13	8514		
			27.90.31	8515		
			26.11.11	8540		
903.	ГОСТ 32134.15	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики	27.51	8516 00	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует
			27.90.11	8543 00		
			28.49.12	8479 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		
			26.30.40	8529 00		
904.	ГОСТ 32134.16	Аналоговые и цифровые наземные телевизионные радиопередатчики	27.90.40	8505 00	Ограничения полос частот при испытаниях	Соответствует/не соответствует
			28.24.11	8467 00		
			22.29.24	9405 00		
			26.20.11	8471 00		
			27.51.11	8418 00		
			27.51.21	8509 00		
			28.94.22	8450 00		
			27.51.22	8510 00		
			27.51.30	8509 00		
			27.11.41	8504 00		

на 700 листов, лист 322

				28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
903.	ГОСТ Р 52459.15	Коммерческое оборудование для радиолокаторов		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

		на 408 листах, лист 323					
904.	ГОСТ Р 52459.16	Подвижное и портативное радиооборудование аналоговой сотовой связи	26.11.11	8540	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
905.	ГОСТ Р 52459.17	Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	

				26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540			на члб листах, лист 524
906.	ГОСТ Р 52459.18	Оборудование наземной системы транкинговой радиосвязи (TETRA)		27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	

на 408 листах, лист 223

907.	ГОСТ Р 52459.19	Подвижные земные приемные станциям спутниковой службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц	27.90.31 26.11.11 27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8515 8540 8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
908.	ГОСТ Р 52459.20	Земные станции подвижной спутниковой службы	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00	Поддача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует

909.	ГОСТ Р 52459.22	Наземное подвижное и стационарное радиооборудование диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы	22.29.24	9405 00	9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		Соответствует/не соответствует
			26.20.11	8471 00			
			28.23.12	8470 00			
			26.30	8525 00			
			26.40.20	8528 00			
			26.20	8471 00			
			28.11.13	8413			
			28.13	8414			
			28.21.12	8417			
			28.25.13	8418			
			28.25.30	8419			
			28.29.42	8420			
			25.73.50	8480			
			28.12	8481			
			28.21.13	8514			
			27.90.31	8515			
			26.11.11	8540			
			27.51	8516 00			
			27.90.11	8543 00			
			28.49.12	8479 00			
			27.51.11	8418 00			
			27.51.21	8509 00			
			28.94.22	8450 00			
			27.51.22	8510 00			
			27.51.30	8509 00			
			27.11.41	8504 00			
			26.30.40	8529 00			
			27.90.40	8505 00			
			28.24.11	8467 00			
			22.29.24	9405 00			
			26.20.11	8471 00			
			28.23.12	8470 00			
			26.30	8525 00			
			26.40.20	8528 00			
			26.20	8471 00			
			28.11.13	8413			
			28.13	8414			
			28.21.12	8417			
			28.25.13	8418			
			28.25.30	8419			
			28.29.42	8420			
			25.73.50	8480			
			28.12	8481			
						</	

910.	ГОСТ Р 52459.23	Базовые станции и ретрансляторы IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательное оборудование	28.21.13 27.90.31 26.11.11	8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует
			27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540		
911.	ГОСТ Р 52459.24	Подвижное и портативное радиооборудование. IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательное оборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при	Соответствует/не соответствует

912.	ГОСТ Р 52459.25	Подвижные станции CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательное оборудование	28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	испытаниях на помехоустойчивость		
912.	ГОСТ Р 52459.25	Подвижные станции CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательное оборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480	Подача сигналов при испытаниях	Соответствует/не соответствует	
					Ограничения полос частот при испытаниях		
					Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость		
					Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость		

			28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8481 8514 8515 8540			на ч. 400 листов, лист 329
913.	ГОСТ Р 52459.26	Базовые станции и ретрансляторы CDMA 1x с расширенным спектром и вспомогательное оборудование	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	
914.	ГОСТ Р 52459.28	Цифровое оборудование беспроводных линий видеосвязи	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционирования при	Соответствует/не соответствует	

			27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42 25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420 8480 8481 8514 8515 8540	испытаниях на помехоустойчивость		
915.	ГОСТ Р 52459.32	Радиолокационное оборудование, используемое для зондирования земли и стен	27.51 27.90.11 28.49.12 27.51.11 27.51.21 28.94.22 27.51.22 27.51.30 27.11.41 26.30.40 27.90.40 28.24.11 22.29.24 26.20.11 28.23.12 26.30 26.40.20 26.20 28.11.13 28.13 28.21.12 28.25.13 28.25.30 28.29.42	8516 00 8543 00 8479 00 8418 00 8509 00 8450 00 8510 00 8509 00 8504 00 8529 00 8505 00 8467 00 9405 00 8471 00 8470 00 8525 00 8528 00 8471 00 8413 8414 8417 8418 8419 8420	Подача сигналов при испытаниях Ограничения полос частот при испытаниях Оценка качества функционационирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость Критерии качества функционационирования при испытаниях на помехоустойчивость	Соответствует/не соответствует	

на 400 листов, лист 251

			25.73.50 28.12 28.21.13 27.90.31 26.11.11	8480 8481 8514 8515 8540			
916.	ГОСТ Р 51514	Световое оборудование общего назначения	27.40 23.19	9405		Критерии качества функционирования Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам: - испытательное напряжение Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - напряженность испытательного поля - полоса частот - глубина модуляции Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность поля - частота Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - испытательное напряжение - время нарастания/длительность импульса - частота повторения импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - испытательное напряжение - время нарастания/длительность импульса Устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения электропитания: - уровень испытательного напряжения - число периодов	Соответствует/не соответствует
917.	СТБ ІЕС 61547	Световое оборудование общего назначения.	27.40 23.19	9405		Критерии качества функционирования	Соответствует/не соответствует

						Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам: - испытательное напряжение Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям: - напряженность испытательного поля - полоса частот - глубина модуляции Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность поля - частота Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: - испытательное напряжение - время нарастания/длительность импульса - частота повторения импульсов Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: - испытательное напряжение - время нарастания/длительность импульса Устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания: - уровень испытательного напряжения - число периодов Устойчивость к кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными электромагнитными полями: - полоса частот - испытательный уровень - модуляция					Требования	Соответствует/не соответствует
918.	ГОСТ Р 50839	Средства вычислительной техники и информатики	27.40 23.19	9405								

919.	ГОСТ Р 51326.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.	26.20.11 26.20.13 26.20.14 26.20.15 26.20.16 26.20.21	8471 00 8470 00	Классификация Стойкость маркировки Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений Надежность выводов для внешних соединений Защита от поражения электрическим током Влагостойкость Электрическая прочность изоляции главной цепи Сопrotивление изоляции и электрическая прочность изоляции вспомогательных цепей Проверка превышения температуры Проверка поведения ВДТ в условиях короткого замыкания Проверка теплостойкости	Соответствует/не соответствует Выдержано/не выдержано Соответствует/не соответствует Выдержано/не выдержано Соответствует/не соответствует Выдержано/не выдержано Отсутствие перекрытия и пробоев Не менее 2 МОм, отсутствие перекрытия и пробоев Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
920.	ГОСТ 30850.2.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Безопасность	Соответствует/не соответствует
921.	ГОСТ 30850.2.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Классификация Маркировка Сопrotивление и электрическая прочность изоляции: - минимальное значение сопротивления изоляции - испытательное напряжение Максимальное превышение температуры катушек	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует 5 МОм 2000 – 4000 В Не более 160 °С
922.	ГОСТ 30850.2.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Предпочтительный ряд номинальных напряжений и токов	Соответствует/не соответствует

					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции:	
					- минимальное значение сопротивления изоляции	5 МОм
					- испытательное напряжение	Соответствует/не соответствует
923.	ГОСТ Р 51324.2.3	Выключатели для бытовых и аналоговых стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Предпочтительный ряд номинальных напряжений и токов	Соответствует/не соответствует
					Классификация	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Сопротивление и электрическая прочность изоляции:	
					- минимальное значение сопротивления изоляции	5 МОм
					- испытательное напряжение	2000 – 4000 В
924.	ГОСТ Р 50030.4.1	Электромеханические контакторы и пускатели	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Информация об аппарате. Характер информации	Соответствует/не соответствует
					Маркировка	Соответствует/не соответствует
					Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
925.	ГОСТ 30011.3	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с предохранителями	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Классификация	Соответствует/не соответствует
					Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует
926.	ГОСТ IEC 60947-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Безопасность	Соответствует/ не соответствует

927.	ГОСТ IEC 60947-3	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	26.30 27.12 27.33	8525 00 8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Безопасность	Соответствует/ не соответствует
928.	ГОСТ 16962.2	Изделия электротехнические	27.33.13	8536 00 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
929.	ГОСТ МЭК 730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C
930.	ГОСТ МЭК 730-2-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

			27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	ТС ИРП		
931.	ГОСТ ИЕС 60155	Стартеры глеющего разряда для люминесцентных ламп	27.12 27.33	8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
932.	СТБ ИЕС 61058-1	Выключатели для электроприборов	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
933.	ГОСТ ИЕС 61058-2-1	Выключатели для электрических приборов. Шнуровые выключатели	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C	

					ТУ МП ИП ТС ИРП	750°C	
934.	ГОСТ ИЕС 61058-2-4	Выключатели для электрических приборов	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
935.	ГОСТ ИЕС 61058-2-5	Выключатели для электрических приборов. Переключатели полюсов	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
936.	ГОСТ 30850.1 (ИЕС 60669-1)	Выключатели для бытовых и аналоговых стационарных электрических установок	27.12 27.33	8535 00 8536 00 8537 00 8538 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
937.	СТБ МЭК 60730-1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогового назначения. Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25	8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

			27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8537 10 8537 20	ТС ИРП		
938.	СТБ EN 50366	Бытовые и аналоговые электрические приборы	27.11.4 27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.11 27.90.31 28.21.13 32.99.41	8501 00 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8537 10 8516 10 8516 29 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90 9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

9405 91
9405 92
9405 99
9613 10
9613 20
9613 80
9613 90
8537 10
8537 20
8413 11
8413 19
8413 20
8413 30
8413 40
8413 50
8413 60
8413 70
8413 81
8413 82
8413 91
8413 92
8414 10
8414 20
8414 30
8414 40
8414 51
8414 59
8414 60
8414 80
8414 90
8418 10
8418 21
8418 29
8418 30
8418 40
8418 50
8418 61
8418 69
8418 91
8418 99
8421 11
8421 12
8421 19

8421 21
8421 22
8421 23
8421 29
8421 31
8421 39
8421 91
8421 99
8422 11
8422 19
8422 20
8422 90
8432 10
8432 21
8432 29
8432 31
8432 39
8432 41
8432 42
8432 80
8432 90
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 51
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90
8467 11
8467 19
8467 21
8467 22
8467 29
8467 81
8467 89
8467 91
8467 92
8467 99
8470 10

8470 21
8470 29
8470 30
8470 50
8470 50
8470 90
8471 30
8471 41
8471 49
8471 50
8471 60
8471 70
8471 80
8471 90
8504 10
8504 21
8504 22
8504 23
8504 31
8504 32
8504 33
8504 34
8504 40
8504 50
8504 90
8509 80
8509 90
8516 10
8516 21
8516 29
8516 80
8516 90
8544 11
8544 19
8544 20
8544 30
8544 42
8544 49
8544 60
8544 70
8516 10
8516 10
8516 29

				8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 9613 10 9613 20 9613 80 9613 90			
939.	ГОСТ ИЕС 60730-2-4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей мотор- компрессоров герметичного и полугерметичного типов	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
940.	ГОСТ ИЕС 60730-2-2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Устройства тепловой защиты двигателей	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

			27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	ТС ИРП		
941.	ГОСТ ИЕС 60730-2-5 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические устройства управления горелками	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
942.	ГОСТ ИЕС 60730-2-7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Таймеры и временные переключатели	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

943.	ГОСТ ИЕС 60730-2-8 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электроприводные водяные клапаны	27.11.4	8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °С 750 °С	
944.	ГОСТ ИЕС 60730-2-9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Термочувствительные управляющие устройства	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °С 750 °С	

945.	ГОСТ IEC 60730-2-10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Пусковые реле электродвигателей	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8536 90 8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °С 750°С
946.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Электрически управляемые дверные замки	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С
947.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Стандарт РБ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м

		назначения. Электрические силовые приводы	27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	105°C 750°C	
948.	СТБ МЭК 60730-2-18	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха	27.12 27.33 27.40.21 27.51.14 27.51.21 27.51.23 27.51.24 27.51.25 27.51.26 27.51.27 27.51.28 27.90.31 27.90.11 27.11.4	8537 10 8537 20 8533 10 8533 21 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
949.	ГОСТ 27570.0	Бытовые и аналогичные электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13 28.24.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

[illegible]

8433 59					
8433 60					
8433 90					
8509 40					
8509 80					
8509 90					
8504 10					
8504 21					
8504 22					
8504 23					
8504 31					
8504 32					
8504 33					
8504 34					
8504 40					
8504 50					
8504 90					
8544 11					
8544 19					
8544 20					
8544 30					
8544 42					
8544 49					
8544 60					
8544 70					
8536 10					
8536 20					
8536 30					
8536 41					
8536 49					
8536 50					
8536 61					
8536 69					
8536 70					
8536 90					
8516 10					
8516 10					
8516 29					
8516 60					
8516 71					
8516 72					
8516 79					
9613 10					

950.	ГОСТ 30345.0	Бытовые и аналогичные электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13 28.24.11 28.30.86 28.93.15 32.99.41	9613 20 9613 80 9613 90 8432 10 8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 – 4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
------	--------------	---	--	---	---	---	--

8414 10
8414 20
8414 30
8414 40
8414 51
8414 59
8414 60
8414 80
8414 90
8419 11
8419 19
8419 20
8419 31
8419 32
8419 39
8419 40
8419 50
8419 60
8419 81
8419 89
8419 90
8421 11
8421 12
8421 19
8421 21
8421 22
8421 23
8421 29
8421 31
8421 39
8421 91
8421 99
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 51
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90

8509 40
8509 80
8509 90
8504 10
8504 21
8504 22
8504 23
8504 31
8504 32
8504 33
8504 34
8504 40
8504 50
8504 90
8544 11
8544 19
8544 20
8544 30
8544 42
8544 49
8544 60
8544 70
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 70
8536 90
8516 10
8516 29
8516 60
8516 71
8516 72
8516 79
9613 10
9613 20
9613 80
9613 90
8432 10

951.	ГОСТ МЭК 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	25.73.10 27.12.22 27.33.11 27.33.13 27.51.21 27.51.23 27.51.24 28.21.13 28.24.11 28.30.86 28.93.15 32.99.41	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40	8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
------	------------------	---	--	--	---	---	---	--

8414 51
8414 59
8414 60
8414 80
8414 90
8419 11
8419 19
8419 20
8419 31
8419 32
8419 39
8419 40
8419 50
8419 60
8419 81
8419 89
8419 90
8421 11
8421 12
8421 19
8421 21
8421 22
8421 23
8421 29
8421 31
8421 39
8421 91
8421 99
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 51
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8433 90
8509 40
8509 80
8509 90
8504 10

8504 21					
8504 22					
8504 23					
8504 31					
8504 32					
8504 33					
8504 34					
8504 40					
8504 50					
8504 90					
8544 11					
8544 19					
8544 20					
8544 30					
8544 42					
8544 49					
8544 60					
8544 70					
8536 10					
8536 20					
8536 30					
8536 41					
8536 49					
8536 50					
8536 61					
8536 69					
8536 70					
8536 90					
8516 10					
8516 10					
8516 29					
8516 29					
8516 29					
8516 29					
8516 60					
8516 71					
8516 72					
8516 79					
9613 10					
9613 20					
9613 80					
9613 90					
8432 10					

				8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8517 11 8517 12 8517 18 8517 61 8517 62 8517 69 8517 70 8543 10 8543 20 8543 30 8543 70 8543 90			
952.	ГОСТ ИЕС 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стационарные кухонные плиты,	28.21.13 27.51.30	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м	

953.	ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналоговые приборы	конфорочные панели, жарочные шкафы и аналоговые приборы	8516 80 8516 90	ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	105°C 750°C
954.	ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Стандарт РБ	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Фритюрницы, сковороды и аналоговые приборы	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналоговые приборы	28.21.13 27.51.30	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП 0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
955.	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Стандарт РБ	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Грили, тостеры и аналоговые переносные приборы для приготовления пищи	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Грили, тостеры и аналоговые переносные приборы для приготовления пищи	27.51.24 27.51.27 27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП 0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
956.	ГОСТ ИЕС 60335-2-12 Стандарт РБ	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Мармиты и аналоговые приборы	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Мармиты и аналоговые приборы	27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП 0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

						ИП ТС ИРП	
957.	ГОСТ ИЕС 60335-2-78 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Уличные барбекю	27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
958.	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи	27.51.24 27.51.27 27.51.28	8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
959.	ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборам для нагрева жидкостей	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8516 90 8516 21	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
960.	СТБ МЭК 60335-2-21	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Аккумуляционные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C	

961.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Аккумуляционные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 М 105°C 750°C
962.	ГОСТ IEC 60335-2-35	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Проточные водонагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 М 105°C 750°C
963.	ГОСТ Р 52161.2.73 (МЭК 60335-2-73:2009)	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Закрепляемые погружные нагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 М 105°C 750°C
964.	ГОСТ IEC 60335-2-74	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Переносные погружные нагреватели	27.51.24 27.51.25	8516 10 8516 29 8516 71 8516 72 8516 79	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 М 105°C 750°C
965.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Кухонные машины	27.51.21	8516 60 8516 71 8516 72	Требования Безопасности Статья 4, ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж

				8516 79 8509 40 8509 80 8509 90	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C	
966.	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Насосы	27.51.21 28.13.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
967.	ГОСТ ИЕС 60335-2-65	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы для очистки воздуха	27.51.21 28.29.13	8421 11 8421 12 8421 19 8421 21 8421 22 8421 23 8421 29 8421 31 8421 39 8421 91 8421 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
968.	ГОСТ ИЕС 60335-2-56	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Проекторы и аналогичные приборы	27.51.21 26.20.17	8528 62	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м	

на 100 листов, лист 200

						ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	105°C 750°C	
969.	ГОСТ МЭК 60335-2-31	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	27.51.21 28.29.13	8421 31 8421 39 8421 91 8421 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C		
970.	ГОСТ ИЕС 60335-2-31	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	27.51.21 28.29.13	8421 31 8421 39 8421 91 8421 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C		
971.	ГОСТ ИЕС 60335-2-51	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	27.51.21 28.13.11	8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C		

972.	СТБ МЭК 60335-2-77	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Управляемые вручную газонокосилки	27.51.21	8414 59 8414 60 8414 80 8414 90 8418 61 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
973.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Управляемые вручную газонокосилки	27.51.21	8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52 8433 53 8433 59 8433 60 8433 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
974.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Вентиляторы	27.51.21 28.25.20	8414 10 8414 20 8414 30 8414 40 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 8414 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
975.	ГОСТ МЭК 60335-2-6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	27.51.30	8516 80 8516 80 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

					МП ИП ТС ИРП	
976.	СТБ МЭК 60335-2-6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы	27.51.30	8516 80 8516 80 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
977.	СТБ ИЕС 60335-2-24	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Холодильные приборы, морозильники и устройства для приготовления льда	27.51.11 27.51.21	8418 10 8418 21 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
978.	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	27.51.11 27.51.21	8418 10 8418 21 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
979.	ГОСТ ИЕС 62552 Стандарт РБ	Приборы холодильные бытовые	27.51.11	8418 10 8418 21 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 91	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

980.	ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Посудомоечные машины	27.51.12	8418 99 8422 11 8422 19 8422 20 8422 90	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
981.	ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические утюги	27.51.23	8516 40 8451 30 8420 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
982.	ГОСТ ИЕС 60335-2-44 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Гладильные машины	27.51.24	8516 40 8451 30	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
983.	ГОСТ ИЕС 60335-2-4 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Отжимные центрифуги	27.51.21	8509 40 8509 80 8509 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

984.	ГОСТ IЕС 60335-2-7 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стиральные машины	27.51.13	8450 11 8450 11 8450 11 8450 12 8450 19 8450 20 8450 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
985.	ГОСТ IЕС 60335-2-7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Стиральные машины	27.51.13	8450 11 8450 11 8450 11 8450 12 8450 19 8450 20 8450 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
986.	ГОСТ IЕС 60335-2-30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Комнатные обогреватели	27.51.26	8516 10 8516 21 8516 29 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
987.	ГОСТ IЕС 60335-2-71	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных	27.51.26	8516 10 8516 21 8516 29 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
988.	ГОСТ IЕС 60335-2-96	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Гибкие листовые нагревательные	27.51.26	8516 10 8516 21 8516 29	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж

		элементы для обогрева жилых помещений			8516 80 8516 90	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C	
989.	ГОСТ IEC 60335-2-98	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Увлажнители воздуха	27.51.21		8415 81 8415 90 8479 89 8509 40 8509 80 8509 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
990.	ГОСТ IEC 60335-2-40	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	28.25.12 27.51.21		8415 81 8415 82 8415 83 8415 90 8479 89 8509 80 8509 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
991.	ГОСТ IEC 60335-2-88	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Увлажнители, используемые с системами отопления, вентиляции или кондиционирования	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41		8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
992.	ГОСТ IEC 60335-2-52	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы для гигиены полости рта	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41		8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

993.	ГОСТ IEC 60335-2-27	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 60 8516 80 8516 90	МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
994.	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы по уходу за кожей и волосами	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
995.	ГОСТ IEC 60335-2-11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Баранные сушилки	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
996.	ГОСТ IEC 60335-2-43	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Сушилки для одежды и перекладинам для полотенец	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

997.	ГОСТ IЕС 60335-2-17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Одежда, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	27.51.23 27.51.24 27.90.31 32.99.41	8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 60 8516 80 8516 90	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
998.	ГОСТ Р 52161.2.60	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	27.51.21	9019 10	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
999.	СТБ МЭК 60335-2-8 ГОСТ IЕС 60335-2-8 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22	8510 10 8510 20 8510 30 8510 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1000.	ГОСТ IЕС 60335-2-8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22	8510 10 8510 20 8510 30 8510 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1001.	ГОСТ IЕС 60065	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40.11 26.40.43	8520 00 8527 00	Требования Безопасности	0,5-4 кВ 0,5 мА

				Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
	26.40.51 26.30.23 26.40.20	8527 12 8527 13 8527 19 8527 21 8527 29 8527 91 8527 92 8527 99 8528 42 8528 49 8528 52 8528 59 8528 62 8528 69 8528 71 8528 72 8528 73 8518 10 8518 21 8518 22 8518 29 8518 30 8518 40 8518 50 8518 90 8505 11 8505 19 8505 20 8505 90 8524 00 8517 11 8517 12 8517 18 8517 61 8517 62 8517 69 8517 70 8529 10 8529 90 8504 10 8504 21 8504 22 8504 23				

1002.	ГОСТ Р МЭК 60065	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40.11 26.40.43 26.40.51 26.30.23 26.40.20	8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8520 00 8527 00 8527 12 8527 13 8527 19 8527 21 8527 29 8527 91 8527 92 8527 99 8528 42 8528 49 8528 52 8528 59 8528 62 8528 69 8528 71 8528 72 8528 73 8518 10 8518 21 8518 22 8518 29 8518 30 8518 40 8518 50 8518 90 8505 11 8505 19 8505 20 8505 90 8524 00 8517 11 8517 12 8517 18 8517 61	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
-------	------------------	--	--	---	---	---	--

				8517 62 8517 69 8517 70 8529 10 8529 90 8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90			
1003.	СТБ МЭК 60065	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.52.28 26.52.25 26.30.40 26.40.31 26.40.32	8519 20 8519 30 8519 81 8519 89 9103 10 9103 90 9105 11 9105 19 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99	Маркировка и инструкция Допустимое превышение температуры частей аппарата Толщина изоляции Части, находящиеся под опасным напряжением Механическая прочность Пути утечки	Соответствует/не соответствует 30 – 300 К Не менее 0,4 мм Не более 35 В переменного тока или 60 В постоянного тока - 0,6 – 16,0 мм	
1004.	ГОСТ ИЕС 60950-1	Оборудование информационных технологий	26.40.51 26.20.1 26.20.13 26.20.14 26.20.16 26.20.17 26.20.21 26.51.32 28.23.11 28.23.21 28.23.23 26.30.23 26.20.40 26.70.14 26.30.40	8505 11 8505 19 8505 20 8505 90 8524 00 8443 11 8443 12 8443 13 8443 14 8443 15 8443 16 8443 17 8443 19 8443 31 8443 32	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

				26.40.31 26.40.32	8443 39 8443 91 8443 99 8469 00 8470 10 8470 21 8470 29 8470 30 8470 50 8470 90 8471 30 8471 41 8471 49 8471 50 8471 60 8471 70 8471 80 8471 90 8472 10 8472 30 8472 90 8528 42 8528 49 8528 52 8528 59 8528 62 8528 69 8528 71 8528 72 8528 73 9017 10 8517 11 8517 12 8517 18 8517 61 8517 62 8517 69 8517 70 8543 10 8543 20 8543 30 8543 70 8543 90			
--	--	--	--	----------------------	---	--	--	--

				9006 30 9006 40 9006 51 9006 52 9006 53 9006 59 9006 61 9006 69 9006 91 9006 99 8519 20 8519 30 8519 81 8519 89			
1005.	ГОСТ IEC 60335-2-29	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40		Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1006.	ГОСТ IEC 61204 Стандарт РБ	Источники питания постоянного тока низковольтные	26.20.40	8471 30 8471 41 8471 49 8471 50 8471 60 8471 70 8471 80 8471 90		Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1007.	ГОСТ IEC 60598-1 Стандарт РБ	Светильники	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99		Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1008.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1	Светильники стационарные общего назначения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1009.	СТБ МЭК 60598-2-2	Светильники встраиваемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1010.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2	Светильники встраиваемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C
1011.	ГОСТ ИЕС 60598-2-18	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1012.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4	Светильники переносные общего назначения	27.90.11	9405 10 9405 20	Требования Безопасности	0,5-4 кВ 0,5 мА

				9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1013.	СТБ МЭК 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C	
1014.	ГОСТ ИЕС 60598-2-6	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1015.	ГОСТ ИЕС 60598-2-7	Светильники переносные для использования в саду	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1016.	СТБ МЭК 60598-2-8	Светильники ручные	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C	

1017.	ГОСТ ИЕС 60598-2-9	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных)	27.90.11	9405 91 9405 92 9405 99	ТУ МП ИП ТС ИРП	750°C
				9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1018.	ГОСТ ИЕС 60598-2-10	Светильники переносные детские игровые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1019.	ГОСТ МЭК 598-2-17	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1020.	ГОСТ ИЕС 60598-2-17	Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

						ТС ИРП	
1021.	СТБ МЭК 60598-2-19	Светильники вентилируемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1022.	ГОСТ ИЕС 60598-2-19	Светильники вентилируемые	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1023.	СТБ МЭК 60598-2-23	Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1024.	СТБ МЭК 60598-2-24	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1025.	ГОСТ ИЕС 60598-2-24	Светильники с ограничением температуры поверхности	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1026.	ГОСТ ИЕС 60598-2-25	Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1027.	СТБ ИЕС 60598-2-3	Светильники для освещения улиц и дорог	27.90.11	9405 10 9405 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1028.	ГОСТ ИЕС 60598-2-22	Светильники для аварийного освещения	27.90.11	9405 10 9405 20 9405 40 9405 50 9405 60 9405 91 9405 92 9405 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1029.	ГОСТ ИЕС 60598-2-20 Стандарт РБ	Световые гирлянды	27.90.11	9405 30	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж

						абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C	
1030.	СТБ МЭК 60598-2-5	Пржекторы заливающего света		27.90.11		9405 40	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1031.	ГОСТ IEC 60598-2-5	Светильники. Пржекторы заливающего света		27.90.11		9405 40	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1032.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов		27.33.13		8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 69	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1033.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов		27.33.13		8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1034.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Стандарт РБ	Выключатели для электрических приборов	27.33.13	8536 69	МП ИП ТС ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1035.	ГОСТ 30851.1 (IEC 60320-1)	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1036.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2)	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1037.	ГОСТ IEC 60884-1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1038.	ГОСТ 30988.2.5 (IEC 60884-2-5)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения		8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	МП ИП ТС ИРП		
			27.33.13	8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1039.	СТБ ГОСТ Р 51322.2.5 (IEC 60884-2-5)	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1040.	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

					8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70			
1041.	ГОСТ IEC 60998-2-1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13		8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1042.	ГОСТ 30988.2.2 (IEC 60884-2-2) Стандарт РБ	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13		8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C	

1043.	ГОСТ 30988.2.6 (ИЕС 60884-2-6) Стандарт РБ	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8544 49 8544 60 8544 70 8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	ТУ МП ИП ТС ИРП	750°C	
1044.	СТБ ГОСТ Р 50030.7.1 (МЭК 60947-7-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Клеммные колодки для медных проводников	27.33.13	8436 10 8536 20 8436 21 8436 29 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8436 80 8436 91 8436 99 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1045.	ГОСТ ИЕС 60947-7-2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	27.33.13	8436 10 8536 20 8436 21 8436 29 8536 30 8536 41 8536 49	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1046.	ГОСТ IEC 60998-2-2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения		8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8436 80 8436 91 8436 99 8536 90	ИП ТС ИРП		
			27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1047.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1)	Соединительные устройства	27.33.13	8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1048.	ГОСТ 31602.2 (IEC 60999-2)	Соединительные устройства	27.33.13	8436 10 8436 21	Требования Безопасности	0,5-4 кВ 0,5 мА	

					8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1049.	ГОСТ ИЕС 61210	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	27.33.13		8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1050.	ГОСТ 31195.2.3 (ИЕС 60998-2-3)	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13		8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1051.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13		8436 10 8436 21 8436 29	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

				8436 80 8436 91 8436 99 8536 69 8536 90	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105 °C 750°C
1052.	ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Стандарт РБ	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Зарядные устройства батарей	27.90.11 27.11.4	8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1053.	ГОСТ ИЕС 60799-2011	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	27.90.11 27.11.4	8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 31 8504 32 8504 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

				8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	ИП ТС ИРП		
1054.	ГОСТ 7396.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20 8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1055.	ГОСТ 31223 (ИЕС 61242)	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13	8536 41 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90 8544 11 8544 19 8544 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1056.	ГОСТ ИЕС 61293	Оборудование электрическое		8544 30 8544 42 8544 49 8544 60 8544 70	ТС ИРП		0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1057.	ГОСТ ИЕС 61140 Стандарт РБ	Бытовые и аналоговые электрические приборы	26.51.66 28.94.22	9022 12 9022 13 9022 14 9022 19 9022 21 9022 29 9022 30 9022 90 8450 20 8451 10 8451 29	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП		0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1058.	ГОСТ ИЕС 60335-2-77 Стандарт РБ	Бытовые и аналоговые электрические приборы. Управляемые вручную газонокосилки	25.73.10 28.30.86	8432 10 8432 21 8432 29 8432 31 8432 39 8432 41 8432 42 8432 80 8432 90 8433 11 8433 19 8433 20 8433 30 8433 40 8433 51 8433 52	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП		0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1059.	СТБ ИЕС 60745-1 (ИЕС 60745-1)	Инструмент ручной электромеханический	28.24.11	8433 53 8433 59 8433 60 8433 90 8435 10 8435 90 8436 10 8436 21 8436 29 8436 80 8436 91 8436 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1060.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Стандарт РБ	Машины ручные электрические. Сверильные и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1061.	ГОСТ ИЕС 60745-2 Стандарт РБ	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1062.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1063.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Стандарт РБ	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1064.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Стандарт РБ	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1065.	ГОСТ IEC 60745-2-6	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1066.	ГОСТ 30700 (IEC 745-2-7)	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 0,5 мА

1067.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	28.24.11	8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C
1068.	ГОСТ ИЕС 60745-2-9	Машины ручные электрические. Машины для нарезания внутренней резьбы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1069.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11	Машины ручные электрические. Пилы с возвратно- поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1070.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-12	Машины ручные электрические. Вибраторы для уплотнения бетона	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1071.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1	Машины переносные электрические. Дисковые пилы	28.24.11	8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	МП ИП ТС ИРП		
1072.	ГОСТ ИЕС 61029-2-2	Машины переносные электрические. Радиально-рычажные пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1073.	ГОСТ ИЕС 61029-2-3	Машины переносные электрические. Строгальные и рейсмусовые машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1074.	ГОСТ ИЕС 62841-3-4	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Переносные шлифовально-заточные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1075.	ГОСТ ИЕС 61029-2-5	Машины переносные электрические. Ленточные пилы	28.24.11	8467 99 8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С
1076.	ГОСТ ИЕС 61029-2-6	Машины переносные электрические. Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С
1077.	ГОСТ ИЕС 61029-2-7	Машины переносные электрические. Алмазные пилы с подачей воды	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С
1078.	ГОСТ ИЕС 61029-2-8	Машины переносные электрические. Одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С

1079.	ГОСТ Р МЭК 1029-2-9	Машины переносные электрические. Торцовочные пилы	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1080.	ГОСТ 27917 (IEC 34-11-2-84)	Машины электрические вращающиеся. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1081.	ГОСТ 27888 (IEC 34-11-1-78)	Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1082.	ГОСТ 27895 (IEC 34-11-3-84)	Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1083.	ГОСТ IEC 60034-14	Машины электрические вращающиеся	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж

1084.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15	Машины ручные электрические. Машины для подрезки живой изгороди	28.24.11	8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C
1085.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1086.	ГОСТ IEC 60745-2-17	Машины ручные электрические. Ручные фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок	28.24.11	8467 11 8467 19 8467 21 8467 22 8467 29 8467 81 8467 89 8467 91 8467 92 8467 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1087.	ГОСТ 27570.52	Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1088.	ГОСТ 27570.36	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1089.	ГОСТ ИЕС 60335-2-48	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрическим грили и тостеры для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1090.	ГОСТ 27570.42	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C	

1091.	ГОСТ IEC 60335-2-50	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические мармиты для предприятий общественного питания	28.93.15	8419 11 8419 19 8419 20 8419 31 8419 32 8419 39 8419 40 8419 50 8419 60 8419 81 8419 89 8419 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1092.	ГОСТ Р 50345	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Автоматические выключатели для переменного тока	27.12.22	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1093.	ГОСТ IEC 60898-2	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока	27.12.22	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1094.	ГОСТ Р 50030.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	27.12.22	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1095.	ГОСТ IEC 60934	Выключатели автоматические для оборудования (СВЕ)	27.12.22	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1096.	ГОСТ IEC 60947-5-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электромеханические устройства цепей управления	27.33.11	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1097.	ГОСТ IEC 61008 Стандарт РБ	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	27.12.22	8536 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1098.	ГОСТ 31601.2.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	27.12.22	8536 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж 1 м 105 °C 750°C
1099.	ГОСТ 31601.2.2	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного	27.12.22	8536 20	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 МА 0,5 Дж

1100.	ГОСТ IEC 61009-1	назначения без встроенной защиты от сверхтоков	27.12.22	8536 20	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C
1101.	ГОСТ 31225.2.1	Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения	27.12.22	8536 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1102.	ГОСТ 31225.2.2	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков	27.12.22	8536 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1103.	ГОСТ 2933	Аппараты электрические низковольтные	27.33.11	8536 50	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1104.	ГОСТ IЕС 60309-1	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	27.33.13	8536 69 8536 90	МП ИП ТС ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1105.	ГОСТ IЕС 60309-2	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	27.33.13	8536 69 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1106.	ГОСТ 30849.3 (IЕС 60309-3)	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Соединители и вводы электроприборов, используемых во взрывоопасных газовых средах	27.33.13	8536 69 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	
1107.	ГОСТ IЕС 61095	Контакты электромеханические бытового и аналогичного назначения	27.33.13	8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C	

1108.	ГОСТ 30011.4.1 (ИЕС 947-4-1)	Низковольтная аппаратура распределения и управления. Электромеханические контакторы и пускатели	27.33.13	8536 69 8536 70 8536 90	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1109.	ГОСТ Р 51321.1	Устройства комплекты низковольтные распределения и управления. Устройства, испытанные полностью или частично	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1110.	СТБ МЭК 60439-3	Низковольтные комплекты устройств распределения и управления. Низковольтные переключающие и регулирующие устройства, предназначенные для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1111.	СТБ МЭК 60439-4	Низковольтные комплекты устройств распределения и управления. Устройства для строительных площадок	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C

1112.	ГОСТ Р 51321.5 (МЭК 60439-5:2006)	Устройства комплекты низковольтные распределения и управления	27.12.31	8537 10 8501 00	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1113.	ГОСТ Р 50030.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Бесконтактные датчики	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1114.	ГОСТ 30011.5.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1115.	ГОСТ IEC 60947-6-1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппаратура коммутационная переключения	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1116.	ГОСТ IEC 60947-6-2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Коммутационные устройства	27.33.13 27.33.11	8536 10 8536 20 8536 30	Требования Безопасности Статья 4,	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж

		(или оборудование) управления и защиты			8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	1 м 105°C 750°C
1117.	ГОСТ Р 51992	Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах	27.33.13 27.33.11		8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 70 8536 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1118.	ГОСТ 12.2.007.9 (ИЕС 519-1)	Электротермическое оборудование	-		-	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1119.	ГОСТ 12.2.007.9.1 (ИЕС 519-3)	Электротермические устройства индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционные электропечи	-		-	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°C 750°C
1120.	ГОСТ 30012.9 (МЭК 51-9)	Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных)	26.51.52 26.51.63 26.51.43		9026 10 9026 20 9026 80 9026 90 9027 10 9027 20	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 ПИ ТУ	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°C 750°C

						9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9028 20 9028 90 9030 10 9030 20 9030 31 9030 32 9030 33 9030 39 9030 40 9030 82 9030 84 9030 89 9030 90	МП ИП ТС ИРП		
1121.	ГОСТ МЭК 61010-2-032 (IEC 61010-2-032)	Приборы измерительные и радионизмерительные	26.51.43 26.51.82			9027 10 9027 20 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9030 10 9030 20 9030 31 9030 32 9030 33 9030 39 9030 40 9030 82 9030 84 9030 89 9030 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°C 750°C	
1122.	ГОСТ МЭК 61010-2-051	Приборы измерительные и радионизмерительные	26.51.43 26.51.82			9027 10 9027 20 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9030 10	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 ПИ ТУ МП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°C 750°C	


					9030 20 9030 31 9030 32 9030 33 9030 39 9030 40 9030 82 9030 84 9030 84 9030 89 9030 89 9030 90	ИП ТС ИРП		
1123.	ГОСТ МЭК 61010-2-061	Приборы измерительные и радиоизмерительные	26.51.43 26.51.82		9027 10 9027 20 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9030 10 9030 20 9030 31 9030 32 9030 33 9030 39 9030 40 9030 82 9030 84 9030 84 9030 89 9030 89 9030 90	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°C 750°C	
1124.	ГОСТ Р МЭК 61010-031	Приборы измерительные и радиоизмерительные	26.51.43 26.51.82		9027 10 9027 20 9027 30 9027 50 9027 80 9027 90 9030 10 9030 20 9030 31 9030 32 9030 33 9030 39	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°C 750°C	

1125.	ГОСТ 30012.1	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним	26.51.43	9030 40 9030 82 9030 84 9030 84 9030 89 9030 89 9030 90 9030 33	- Устойчивость к условиям эксплуатации - Устойчивость к механическим воздействиям - Требования к конструкции - Информация, основные обозначения и маркировка	Устойчивы/не устойчивы Устойчивы/не устойчивы - Соответствует/не соответствует	
1126.	ГОСТ 23706	Омметры	26.51.43	9030 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С	
1127.	ГОСТ 8476	Ваттметры и варметры	26.51.43	9030 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С	
1128.	ГОСТ 7590	Частотомеры	26.51.43	9030 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС	0,5-4 кВ 0,5 мА 0,5 Дж 1 м 105°С 750°С	

1129.	ГОСТ 8039	Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроскопы	26.51.43	9030 33	ИРП Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
1130.	ГОСТ 8711	Амперметры, вольтметры	26.51.43	9030 33	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
1131.	ГОСТ МЭК 60335-2-26	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые механизмы: часовые и реле времени	26.52.28 26.52.25	9103 10 9103 90 9105 11 9105 19 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С
1132.	ГОСТ 30345.57	Аппаратура проекционная (кроме диапроекторов, фотоувеличителей и кинопроекторов для 8-мм фильмов)	28.99.39 26.70.16	9007 10 9007 20 9007 91 9007 92	Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 ПИ ТУ МП ИП ТС ИРП	0,5-4кВ 0,5мА 0,5Дж 1м 105°С 750°С

1133.	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, приложения E	Оборудование светотехническое: светильники переносные общего назначения, светильники переносные детские, светильники ручные, светильники переносные для использования в саду, светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, светильники стационарные общего назначения (кроме саветильников для освещения улиц и дорог), светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий, светильники для непрофессиональных фото-киносъемок. Арматура осветительная бытовая для ламп накаливания, Арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп Гирлянды световые, иллюминационные и декоративные, Прожекторы общего назначения света	27.90.11.000	9405	Напряженность электрического поля и показатель F (Плотность наведенного тока)	20 КГц-10 МГц
1134.	ГОСТ IEC 62311 (IEC 62311) разделы 5-7	Вычислительная техника, Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная, бытовая и аналогичная аппаратура, продукция информационных технологий, электротехнические изделия	28.23 26.20 26.40.	8504 8518 8519 8521 8525 8527 8528 9207 8504	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см ² в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м
1135.	ГОСТ EN 62233 (IEC 62233) разделы 4-6 (п. 5.5.4, кроме Приложения С)	Вычислительная техника, Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная, бытовая и аналогичная аппаратура,	28.23 26.20 26.40.	8504 8518 8519 8521 8525	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 10 Гц-400 КГц

1136.	ГОСТ IEC 62479 (EN 62479) раздел 4	продукция информационных технологий, электротехнические изделия		8527 8528 9207 8504		Плотность потока мощности 0,26-100 000 мкВт/см ² в диапазоне частот 0,3-40 ГГц Напряженность электрического поля 2,5-800 В/м Напряженность магнитного поля 0,05-40 А/м
-------	---------------------------------------	---	--	------------------------------	--	--

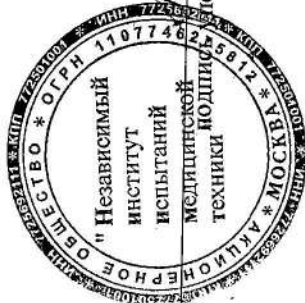


Генеральный директор
АО "НИИМТ"

Должность уполномоченного лица

М.В. Илющихина

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито и пронумеровано
408 (четыреста восемь) листов

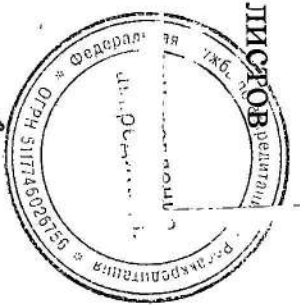

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

А.С. Дерипаска

Б.П. Жезлов

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]