


Э К З Е М П Л Я Р

РОА

РОСАККРЕДИТАЦИИ

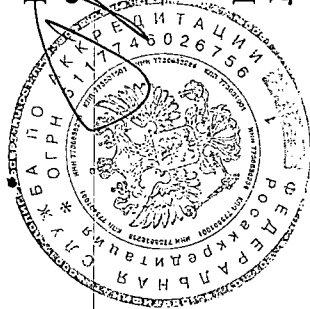

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.

на 5 листах, лист 1

М.П.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах

наименование испытательной лаборатории (центра)

652425, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Мира, д. 24а

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 4.2.2661-10 п 4.2, п 15.1	Почва	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/ не обнаружено
2.	МУК 4.2.2661-10 п 4.5				Личинки гельминтов	обнаружено/ не обнаружено
3.	МУК 4.2.2661-10 п 4.7				Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
4.	МР ФЦ/4022-04 от 24.12.2004 «Методы микробиологического контроля почв. Методические рекомендации» п.7	Почва, песок	-	-	Индекс бактерий группы кишечных палочек (БГКП)	от 0 КОЕ/г до 5000 КОЕ /г
5.	МР ФЦ/4022-04 от 24.12.2004 «Методы микробиологического контроля почв. Методические рекомендации» п.8				Индекс энтерококков	от 0 КОЕ/г до 5000 КОЕ /г
6.	МР ФЦ/4022-04 от 24.12.2004 «Методы микробиологического контроля почв. Методические рекомендации» п.9 (титрационный метод)				Cl. Perfringens	обнаружено / не обнаружено
7.	МР ФЦ/4022-04 от 24.12.2004 «Методы микробиологического контроля почв. Методические рекомендации» п.11				Патогенные энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
8.	Руководство по эксплуатации ВЕ-метр-АТ-003 СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 7.3.7 а), б), в)	Производственная зона, рабочие места	-	-	Электромагнитные поля от ВДТ ПВЭМ - Напряженность электри- ческого поля - Напряженность магнит- ного поля (магнитной ин- дукции) в диапазоне ча- стот 5Гц до 2кГц, мкТл - Напряженность магнит- ного поля в диапазоне ча- стот 2кГц до 400 кГц, нТл;- - Напряженность магнит- ного поля в диапазоне ча- стот от 45 Гц до 55Гц	(5 – 1000) В/м от 62,5 нТл до 5 мкТл от 5 нТл до 500 нТл от 62,5 нТл до 10 мкТл
9.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и со- оружений, рабочие места, производства работ вне зданий, улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Освещенность Коэффициент естествен- ной освещенности	(1-200000) лк (0 -100) %
10.	ГОСТ 33393	Помещения зданий и со- оружений, производ- ственная зона, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
11.	Р 4.2.2643-10 «Методы ла- бораторных исследований и испытаний и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективно- сти и безопасности» п. 4.2.1	Дезинфекционные сред- ства	20.20.14	2801 282810	Массовая доля активного хлора	(0,01 – 65,0) %

1	2	3	4	5	6	7
12.	Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» п. 4.2.4. (метод двухфазного титрования)				Массовая доля ЧАС (чет-вертичные аммониевые соединения)	(0,01 – 20,0) %
13.	ГОСТ 31861	Вода	-	-	Отбор проб	-
14.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	Вода: питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная, подземная), дистиллированная	36.00.11. 36.00.1. --	2201	Запах при 20 °С, Запах при 60°С	(0-5) балл (0-5) балл
15.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2				Вкус и привкус	(0-5) балл
16.	ГОСТ Р 58144 п. 6	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	Отбор проб	-
17.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12				Вещества восстанавливающие KMnO ₄	розовая окраска заметна/розовая окраска не заметна
18.	ГОСТ Р 58144 п. 8.14				pH	(1÷14) ед.рН
19.	ГОСТ Р 58144 п. 8.15				Удельная электрическая проводимость при 20°С, при 25°С	(0,001-100,0) мСм/см

1	2	3	4	5	6	7
20.	Руководство по эксплуатации кондуктометра Анион 4100 п. 2.1.1	Вода: питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная, подземная), горячая, очищенная сточная, сточная, дистиллированная	36.00.11. 11.07.11.121	2201	Минерализация в пересчете на хлористый натрий	(1,0-20000) мг/дм ³
21.	Руководство по эксплуатации кондуктометра Анион 4100 п. 2.1.2				Удельная электрическая проводимость	(0,001-100,0) мСм/см
22.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
23.	РД 52.04.831	Атмосферный воздух			Углеродсодержащий аэрозоль	(0,03-1,8) мг/м ³
24.	РД 52.04.799	Атмосферный воздух			Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
25.	Руководство по эксплуатации Газоанализатора переносного «Геолан-1П»	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух Воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	(0,0-0,10,0) мг/м ³ (0,10-2,0) мг/м ³
					Аммиак	(0,0-0,1) мг/м ³ (0,1-100,0) мг/м ³
					Диоксид серы	(0,0-0,1) мг/м ³ (0,1-20,0) мг/м ³
					Азота оксид	(0,0-0,2) мг/м ³ (0,2-20,0) мг/м ³
					Углерода оксид	(0,1-50) мг/м ³
					Метан	(500-10000) мг/м ³

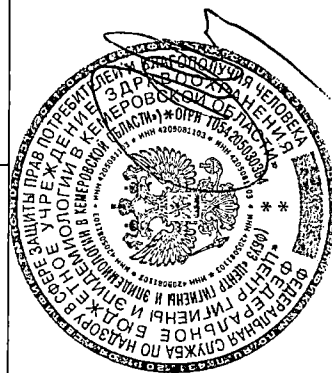

И.о. главного врача ФБУЗ «ЦГиЭ в КО»

А.В.Бачина