

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.510806

от « » 2018г.
на 10 листах, лист 1

11 ИЮЛ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ

наименование испытательной лаборатории (центра)

694420 Российская Федерация Сахалинская область город Александровск-Сахалинский улица Ленина дом 42
694400 Российская Федерация Сахалинская область пгт Тымовское улица Юбилейная дом 8
694450 Российская Федерация Сахалинская область пгт Ноглики улица Советская дом 55А
адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
2.	МУ 2.2.5.2810-10 п. 4.2.	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
3.	ГОСТ Р 54607.2 п. 8.1.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.89.11 10.89.19	-	Средняя масса и выход компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	-

694420 Российская Федерация Сахалинская область город Александровск-Сахалинский улица Ленина дом 42

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1. п. 5.8.2.	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования	11.07.1 36.00.11 36.00.1 36.00.12	из 22	Запах Привкус	(0 - 5) балл (0 - 5) балл
5.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования, сточная	36.00.12	2201 90 000 0	Сульфаты	(10 - 100) мг/дм ³
6.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования, сточная	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 90 000 0	Железо	(0,05 - 10) мг/дм ³
7.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	36.00.11	2201 90 000 0	Мышьяк	(0,01 - 0,1) мг/дм ³
8.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97	Вода питьевая, поверхностных источников централизованного водоснабжения, хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования, сточная	36.00.11 36.00.12	2201 90 000 0	Фосфат-ион	(0,05 - 80) мг/дм ³
9.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12. п. 8.14. п. 8.15.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4 рН Удельная электрическая проводимость	соответствует/ не соответствует (0 - 14) ед. рН (0,1 - 99,9) мксм/см
10.	ГОСТ 33045 п. 5. п. 9.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Массовая концентрация ионов аммония Массовая концентрация нитрат- ионов	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
11.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000	3808 94	Отбор проб Содержание активного хлора	- (0,2 - 8,0) %

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(3,0 - 200,0) г/дм ³
					Углеводороды нефти	(50 - 4000) мг/м ³
					Оксид углерода	(50 - 400) мг/м ³
13.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(5 - 50) мг/м ³
14.	ГОСТ Р 33393	Здания и сооружения	-	-	Коэффициент пульсации	(0,01 - 0,22) мг/м ³
15.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	-	Яркость	(1 - 100) %
16.	ГОСТ Р 52870 п. 5.2.3.	Средства отображения информации	-	-	Яркость	(1 - 200000) кд/м ²
17.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
18.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
19.	ГОСТ Р ИСО 9612 п. 9. п. 10. п. 12.	Промышленные объекты	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
20.	МУ 1844-78	Промышленные объекты	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
21.	Руководство по эксплуатации 4381-18329249-01РЭ	Промышленные объекты, жилые и общественные здания и территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
					Эквивалентный общий уровень инфразвука	(22 - 145) дБА
					Максимальный общий уровень инфразвука	(22 - 145) дБА
694400 Российская Федерация Сахалинская область пгт Тымовское уллица Юбилейная дом 8						
22.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
23.	МУ 2.2.5.2810-10 п. 4.2.	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
24.	ГОСТ 8558.1 п. 8.	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.85.11 10.86.10 10.89.14.110 10.89.19.290	из 02, 1601-1603 2106	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002 - 0,012) % (0,2 - 120) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 5898 п.п. 2., 3.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71-10.72 10.82	из 17, 18, 19	Кислотность	(0,2 - 50) град.
26.	ГОСТ Р 54607.2 п. 8.1.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.89.11 10.89.19	-	Средняя масса и выход компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	-
27.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1. п. 5.8.2.	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	11.07.1 36.00.11 36.00.1 36.00.12	из 22	Запах Привкус	(0 - 5) балл (0 - 5) балл
28.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Вода питьевая, расфасованная в емкости, централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	11.07.1 36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201-2202 2201 90 000 0	Перманганатная окисляемость	(0,25 - 100) мг/дм ³
29.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.12	2201 90 000 0	Сульфаты	(10 - 100) мг/дм ³
30.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 90 000 0	Железо	(0,05 - 10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12. п. 8.14. п. 8.15.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4 рН Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C или 25°C	соответствует/ не соответствует (0-14) ед. рН (0,1 - 99,9) мкСм/см
32.	ГОСТ 33045 п. 5. п. 9.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Массовая концентрация ионов аммония Массовая концентрация нитрат-ионов	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
33.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000	3808 94	Отбор проб Определение содержания активного хлора	- (0,2 - 8,0) % (3,0 - 200,0) г/дм ³
34.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин Углеводороды нефти Оксид углерода	(50 - 4000) мг/м ³ (50 - 400) мг/м ³ (5 - 50) мг/м ³
35.	Руководство по эксплуатации к метеометру МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(0 - 20) мг/м ³ (20 - 120) мг/м ³
36.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4. п. 5.2.6.	Воздух закрытых помещений, атмосферный воздух	-	-	Двуокись азота Взвешенные вещества	(0,02 - 1,4) мг/м ³ (0,025 - 1,0) мг/м ³
37.	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания	-	-	Естественная освещенность	(1 - 200000) лк
38.	МУК 4.2.2812-10	Промышленные объекты	-	-	Естественная освещенность	(1 - 200000) лк
39.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА (22 - 145) дБА
40.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА (22 - 145) дБА (22 - 145) дБА
41.	ГОСТ Р ИСО 9612 п. 9. п. 10. п. 12.	Промышленные объекты	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА (22 - 145) дБА (22 - 145) дБА
42.	МУ 1844-78	Промышленные объекты	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА (22 - 145) дБА (22 - 145) дБА
43.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания	-	-	Уровень звука в октавных полосах частот МЭД гамма-излучения	(22 - 145) дБА (10 - 8000) част.С ⁻¹ *см ² (0,010 - 9,999) мР/ч


1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	01.11-01.27 01.41.2 01.47.2 03.11-03.22 10.11-10.89 11.02-11.07	из 02, 03, 04 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2201-2206	Дрожжи и плесневые грибы	(0,010 - 9,999) Р/ч от 5 КОЕ/г (см ³)
45.	МУК 4.2.3019-12 п. 5.2.	Продукты пищевые	01.11-01.27 01.41.20 01.47.2 10.11-10.13 10.51-10.89	из 02, 04, 07, 08, 12, 17, 18, 19, 21 1601-1603	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/не обнаружены
		Вода из емкостей для хранения	-	-		
		Вода открытых водоемов	-	-		
		Оборудование, инвентарь, пищевые продукты, не подвергающиеся термической обработке	-	-		
46.	Инстр. № 5319-91 п. 13.2. п. 13.3. п. 13.6.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, вспомогательные материалы при производстве рыбной продукции	03.11-03.22 10.20 10.41.2 10.41.5 10.84.30 10.89.14.120 10.89.19.290	0302-0308 1504-1514 1603-1605 2501	Дрожжи и плесневые грибы Бактерии рода <i>Proteus</i> Сульфитредуцирующие клостридии	от 5 КОЕ/г (см ³) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
	п. 13.2.	Объекты производственной среды на рыбоперерабатывающих предприятиях	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
	п. 13.2.	Воздух помещений рыбоперерабатывающих предприятий	-	-	Плесневые грибы	от 4 КОЕ/м ³
47.	МУ 2.1.4.1184-03 прил. 7 прил. 8, (титрацион. метод) прил. 9 прил. 10	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.1	2201-2202	ОМЧ 37°C ОМЧ 22°C Общие колиформные бактерии Глюкозоположительные колиформные бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Коли-фаги	от 1 КОЕ/мл от 1 КОЕ/мл обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
48.	МУ 3182-84 п. 2.12.	Воздух помещений аптек	-	-	Отбор проб	-
49.	СП 4695-88 от 29.09.1988г.	Воздух холодильных камер	-	-	Отбор проб Плесневые грибы	- обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
694450 Российская Федерация Сахалинская область пгт Ноглики улица Советская дом 55А						
50.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
51.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
52.	МУ 2.2.5.2810-10 п. 4.2.	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
53.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71-10.72	1905	Пористость	-
54.	ГОСТ Р 54607.2 п. 8.1.	Продукция общественного питания	10.85.1 10.89.11 10.89.19	-	Средняя масса и выход компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий	-
55.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1. п. 5.8.2.	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, источники централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных), источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	11.07.1 36.00.11 36.00.1 36.00.12	из 22	Запах Привкус	(0 - 5) балл (0 - 5) балл
56.	ГОСТ 18190 п. 2	Вода бассейнов	-	-	Запах	(0 - 5) балл
57.	ГОСТ 4245	Вода бассейнов	-	-	Хлор остаточный свободный	от 0,3 мг/дм ³
58.	ГОСТ 31868 п. 5.		-	-	Хлориды	(10 - 190) мг/дм ³
59.	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05		-	-	Цветность	(5 - 70) град.
60.	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Мутность	(1 - 100) ЕМ/дм ³
			36.00.12	2201 90 000 0	Сульфаты	(10 - 100) мг/дм ³
61.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения (поверхностных и подземных) источников нецентрализованного водоснабжения, поверхностных источников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.11 36.00.1 36.00.12	2201 90 000 0	Железо	(0,05 - 10) мг/дм ³
62.	РД 52.10.735-2010	Морская вода	08.93.10.140	2501 00 100 0	Водородный показатель	(4,1 - 9,2) ед. pH
63.	РД 52.10.736-2010				Растворенный кислород	(0,1 - 12) см ³ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
64.	РД 52.10.740-2010				Нитриты	(0,14 - 17,1) мг/дм ³
65.	ПНД Ф 14.1.2.4.262-10 п. 10.2.				Аммиак и ионы аммония	(0,5 - 100) мг/дм ³
66.	ГОСТ Р 58144 п. 8.12. п. 8.14. п. 8.15.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	(0,05 - 4,0) мг/дм ³
					pH	соответствует/ не соответствует
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C или 25°C	(0 - 14) ед. pH
67.	ГОСТ 33045 п. 5. п. 9.	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 00 100 0	Массовая концентрация ионов аммония	(0,1 - 99,9) мкг/см
					Массовая концентрация нитрат-ионов	соответствует/ не соответствует
68.	ГОСТ Р 57001	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000	3808 94	Отбор проб	-
					Определение содержания активного хлора	(0,2 - 8,0) %
69.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензин	(3,0 - 200,0) г/дм ³
					Углеводороды нефти	(50 - 4000) мг/м ³
					Оксид углерода	(50 - 400) мг/м ³
					Диоксид азота	(5 - 50) мг/м ³
					Бензол	(1 - 50) мг/м ³
70.	Руководство по эксплуатации к газоанализатору Анкат-7664м ИБЯЛ.413411.043-09РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(5 - 1500) мг/м ³
					Диоксид азота	(0 - 50) мг/м ³
					Диоксид серы	(0 - 10) мг/м ³
71.	РД 52.04.186-89 п. 4. п. 5.2.1.4. п. 5.2.6.	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	(0 - 20) мг/м ³
		Воздух закрытых помещений, атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	-
		Жилые и общественные здания	-	-	Двуокись азота	(0,02 - 1,4) мг/м ³
72.	ГОСТ 30494 п. 6.	Промышленные объекты	-	-	Взвешенные вещества	(0,025 - 1,0) мг/м ³
					Температура воздуха	(0 - 50) °C
73.	МУК 43.2756-10	Промышленные объекты	-	-	Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Температура воздуха	(0 - 50) °C
74.	МУ 4425-87	Промышленные объекты	-	-	Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
75.	ГОСТ 24940	Жилые и общественные здания	-	-	Температура воздуха	(0 - 50) °C
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
76.	МУК 4.2.2812-10	Промышленные объекты	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					Естественная освещенность	(1 - 200000) лк
					Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
77.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания,	-	-	Искусственная освещенность	(1 - 200000) лк
					Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		территория жилой застройки			Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
78.	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
79.	ГОСТ Р ИСО 9612 п. 9. п. 10. п. 12.	Промышленные объекты	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
80.	МУ 1844-78	Промышленные объекты	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 145) дБА
					Уровень звука в октавных полосах частот	(22 - 145) дБА
81.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п. 7.3.	Рабочие места в помещениях жилых и общественных зданий	-	-	Напряженность электрического поля	(5 - 1000) В/м (0,5 - 40) В/м (5 - 1000) В/м
					Напряженность магнитного поля	(62,5 - 10000) нТл (5 - 500) нТл (62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(5 - 1000) В/м (62,5 - 10000) нТл
82.	ГОСТ 12.1.002 п. 2.	Рабочие места в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, в т.ч. на границе СЗЗ	-	-	Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	(5 - 1000) В/м (62,5 - 10000) нТл
83.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.41.20 10.51-10.52	0401-0406 0410 00 000 0 2105	Дрожжи и плесневые грибы/плесени	от 10 КОЕ/г (см ³)
84.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые	01.11-01.27 01.41.2 01.47.2 03.11-03.22 10.11-10.89 11.02-11.07	из 02, 03, 04 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2201-2206	Дрожжи и плесневые грибы	от 5 КОЕ/г (см ³)
85.	Инстр. № 5319-91 п. 13.2. п. 13.3. п. 13.6.	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них,	03.11-03.22 10.20 10.41.2	0302-0308 1504-1514 1603-1605	Дрожжи и плесневые грибы Бактерии рода Proteus Сульфитредуцирующие клостридии	от 5 КОЕ/г (см ³) обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательные материалы при производстве рыбной продукции	10.41.5 10.84.30 10.89.14.120 10.89.19.290	2501		
п. 13.2.	п. 13.2.	Объекты производственной среды на рыбоперерабатывающих предприятиях	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	обнаружены/не обнаружены
		Воздух помещений рыбоперерабатывающих предприятий	-	-	Плесневые грибы	от 4 КОЕ/м ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.1	2201-2202	Коли-фаги	обнаружены/не обнаружены
		Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	36.00.11	2201 90 000 0		
		Вода подземных источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201 90 000 0		
п. 8.3.	п. 8.3.	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	36.00.1	2201 90 000 0		
		Вода техническая, горячего водоснабжения	-	-		
		Вода плавательных бассейнов	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл
		Вода плавательных бассейнов	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены от 0,3 КОЕ/100 мл
		Вода поверхностных источников централизованного водоснабжения, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.1	2201 90 000 0	Коли-фаги	обнаружены/не обнаружены
п. 2.9. п. 2.10. прил. 1 прил. 2	п. 2.9. п. 2.10. прил. 1 прил. 2	Морская вода	-	-	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены от 1 КОЕ/см ³
		Вода плавательных бассейнов	08.93.10.140	2501 00 100 0	ОМЧ	обнаружены/не обнаружены
		Сточная вода	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены
		Воздух холодильных камер	-	-	Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
		Воздух холодильных камер	-	-	S. aureus	обнаружены/не обнаружены
п. 6 прил. 7	п. 6 прил. 7	Воздух холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
88.	СП 4695-88 от 29.09.1988г.	Воздух холодильных камер	-	-	Плесневые грибы	от 0,2 колоний на чашке
89.	ГФ XII, ОФС. 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства	-	-	Отбор проб	-
					Стерильность	стерильно/не стерильно

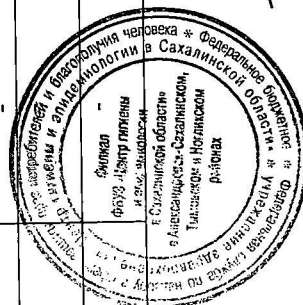

Н.М. Селезнева

Руководитель испытательного лабораторного центра

ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРАВАНО
10 (ДЕСЯТЬ) ЛИСТОВ



С.В. Кияшко

Эксперт по аккредитации

И.В. Новокшова

Технический эксперт

ТАБУНОВ Д.М.