


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

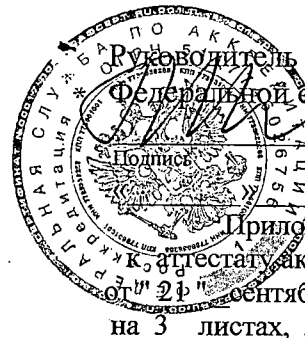

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия
20 г. 14 ДЕК 2019
Приложение
К Статуту аккредитации № RA.RU.21AC53
от 29 сентября 2017 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)


Испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»)

Наименование испытательной лаборатории

416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Чаплыгина, дом №1 «Г»

416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, дом №9, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Пирогова, 28
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Чаплыгина, дом №1 «Г»						
1.1	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские.			Отбор проб	-
1.2	ГОСТ 9793 ,р.9	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	От 1,0 до 35вкл)% (св 35,0до 85,0вкл)%
1.3	33770 П.4.5 п.3	Соль пищевая			Внешний вид Отбор проб	-
1.4	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная			Мутность	(1-100) ЕМ/дм ³
1.5	ГОСТ 10444.11-2013	Молоко Кисломолочные продукты			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
1.6	МУ 3.1.1.2438 -09 приложение № 2, п.3	Пищевые продукты. Смывы с овощей, фруктов, тары, оборудования, приложение 2, п.3			Yersinia pseudotuberculosis	Отсутствие/наличие



Область аккредитации испытательной лаборатории Филиала


Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

на 3 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
1.7	МУК 4.2.2870-11	Вода поверхностных водоемов			Возбудитель холеры (V.cholerae)	Обнаружен/не обнаружен
1.8	МУК 2.1.5.800-99 приложение 6,7,8	Вода сточная очищенная			Общие колиформные бактерии в 100 мл	
					Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл	
					Колифаги в 100мл	Отсутствие/наличие
					Патогенная микрофлора	Отсутствие/наличие
1.9	МУК 4.2.1018-01 п.7; п. 8.1-8.3	Вода плавательных бассейнов			Общие колиформные бактерии	
					Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие/наличие
					Колифаги	Отсутствие/наличие
1.10	МУК 4.2.1884-04 приложение 7.	Вода плавательных бассейнов			S.aureus в 1м ³ (КОЕ/м ³)	Отсутствие/наличие
1.11	МУК 4.2.2661-10,п.4.2	Почва			Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружен/не обнаружен
1.12	МУК 4.2.2314-08 П. 5.1.2.	Вода плавательных бассейнов			Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших	Обнаружен/не обнаружен

416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, дом №9

2.1	МУК 4.2.3016-12 п. 3.	Свежие и свежемороженые, овощи, фрукты, ягоды, зелень, свежеотжатые соки	-	-	Отбор проб	-
2.2	ГОСТ 7636-85 Р.3 п. 3.3.2 п.3.3.1.4 Р.3, п. 3.5.1; п.3.5.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	-	Массовая доля воды	(10,0-60,0)%
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-20) %



Область аккредитации испытательной лаборатории Филиала
 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах
 и ЗАТО города Знаменск»

на 3 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
2.3	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Массовая доля глазури	(0-30,0) %
2.4	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода питьевая, природная			Мутность	(1-100) ЕМ/дм ³

416010, Астраханская область, г. Харабали, ул.Пирогова, 28						
3.1	ГОСТ 10444.11-2013	Молоко Кисломолочные продукты			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
3.2	МУ 3.1.1.2438 -09	Пищевые продукты. Смывы с овощей, фруктов, тары, оборудования.			Yersinia pseudotuberculosis	Отсутствие/наличие

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах
 и ЗАТО города Знаменск»

должность уполномоченного лица
 лица



подпись уполномоченного лица

В.Г.Веденев.

инициалы, фамилия уполномоченного

Прошнуровано,
пронумеровано
3 листа



Руководитель экспертной группы:

Т.В. Калинина

Технические эксперты:

ЛЮ. Бадulina

С.Н. Барзыкина