


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

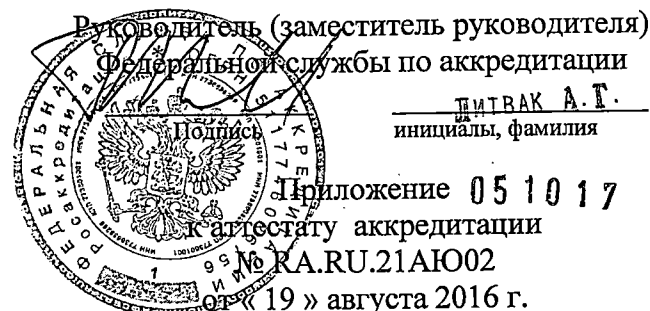


на 2 листах, лист 1

**Дополнение № 1 к Области аккредитации
испытательного центра ФБУ «Забайкальский ЦСМ»
наименование испытательной лаборатории (центра)
РФ, 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул.Кайдаловская, 8
адрес места осуществления деятельности**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Методы испытаний продукции пищевой промышленности						
1	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11.11	100119	Количество сырой клейковины (при отмывании вручную), %	22,8 – 30,8
			01.11.11.121	100111	Качество клейковины (при отмывании вручную), ед. ИДК	41 - 120
			01.11.12.111	100191		
			01.11.12.121	100199		
Раздел II. Методы измерений показателей качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного токов частотой 50 Гц						
2	ГОСТ 33073 ГОСТ 30804.4.30	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	01 1000/ 35.11.10.110	2716 00 000 0	Отклонение частоты, Гц	от минус 7,5 до плюс 25,0
					Отрицательное отклонение напряжения, %	от 0 до 100
					Положительное отклонение напряжения, %	от 0 до 100
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, %	от 0 до 20

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %	от 0 до 20
					Длительность прерывания напряжения, с	от 0,01 с до 60,00 мин
					Длительность провала напряжения, с	от 0,02 до 600,00
					Глубина провала напряжения, %	от 10 до 100
					Показатели временного перенапряжения: - длительность, с.; - коэффициент, отн. ед.	от 0,02 до 600,00 от 1,1 до 2,0
					Кратковременная доза фликера, отн. ед.	от 0,2 до 10,0
					Длительная доза фликера, отн. ед.	от 0,2 до 10,0
3	ГОСТ 30804.4.7	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	01 1000/ 35.11.10.110	2716 00 000 0	Коэффициенты гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 50
					Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 100
					Коэффициенты интергармонических составляющих напряжения, %	от 0 до 15

Директор ФБУ «Забайкальский ЦСМ»

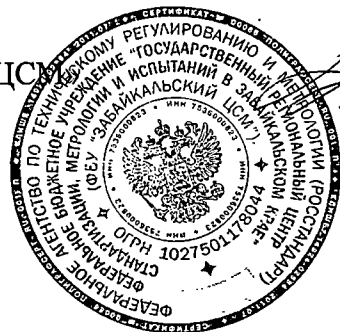

Г.Н. Никифорова

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
2 лист (-а, -ов)



Эксперт по аккредитации:

Р.Н. Селимов

Технический эксперт:

Е.С. Казачек

Дорошенко А.А.

Дорошенко

Баранов В.В.